

DentaMile Desk MC-5

Anleitung zur wöchentlichen Intensitätsprüfung und zur Streulichtmessung	Seite 2
Instructions for weekly intensity testing and stray light measurement	Page 20
Instrukcje dotyczące tygodniowego pomiaru intensywności i pomiaru światła rozproszonego	Strona 38
Instruções para teste de intensidade semanal e medição de luz difusa	Página 58
在这里是每周强度测试和杂散光测量”的说明	第76页。
Instructies voor wekelijkse intensiteitstests en strooilichtmetingen	Pagina 92

Deutsch



**Anleitung zur wöchentlichen Intensitätsprüfung
und zur Streulichtmessung**

Allgemeine Hinweise


- Bitte treffen Sie stets geeignete Arbeitsschutzmaßnahmen
 - UV Schutzbrille
 - Handschuhe
- Vermeiden Sie Sonnenlicht oder andere Lichtquellen, welche das Ergebnis beeinflussen können
- Halten Sie den Sensor sauber und vermeiden Sie es die Sensoroberfläche zu berühren
- Die Ergebnisse können folgende Hinweise liefern:
 - Sauberkeit der Scheibe
 - Verschleiß der Scheibe
 - Degeneration des Projektors
- Bei Unsicherheit wenden Sie sich bitte an Ihr DentaMile Support-Team.




1. Entfernen Sie Tank, Bauplattform und starten Sie den Drucker

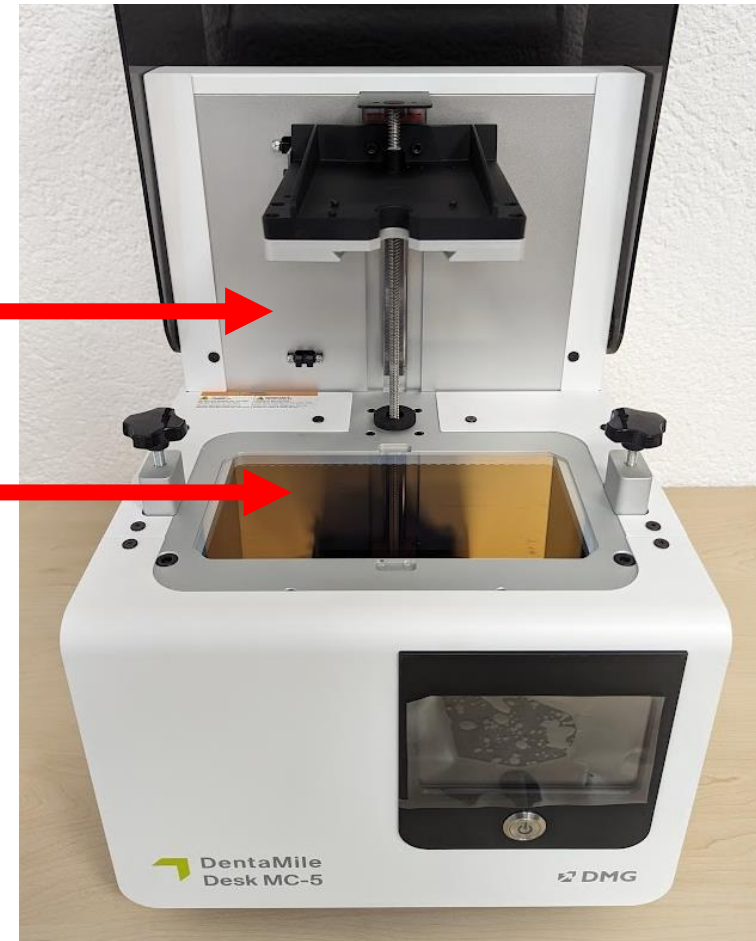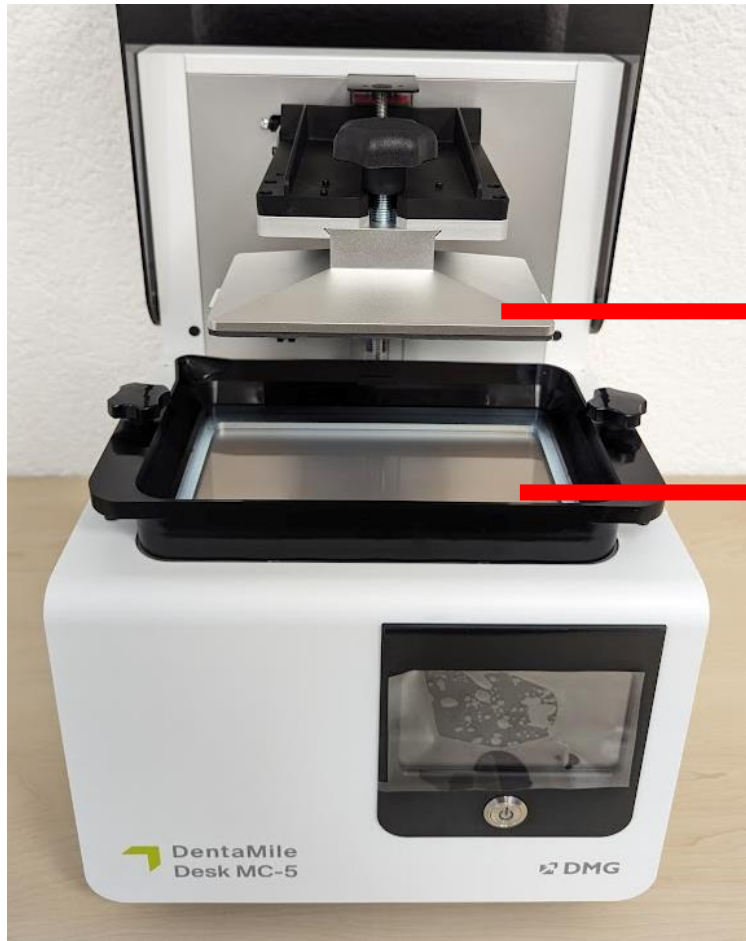


2. Setzen Sie die Sensormaske ein

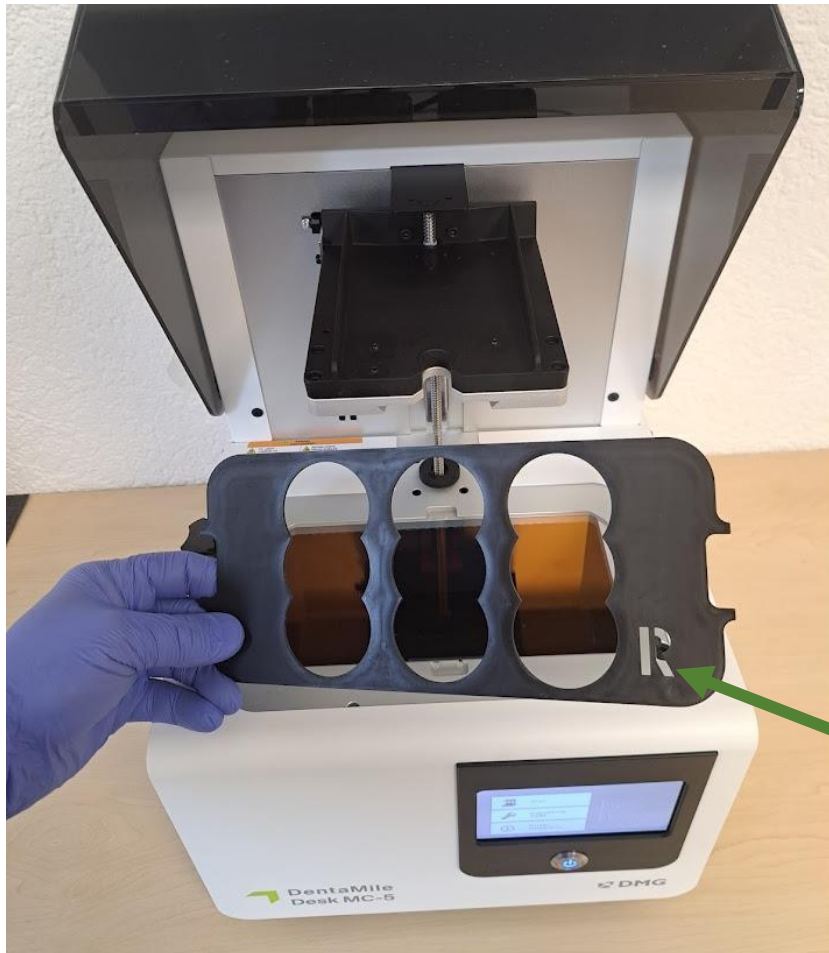



rechts

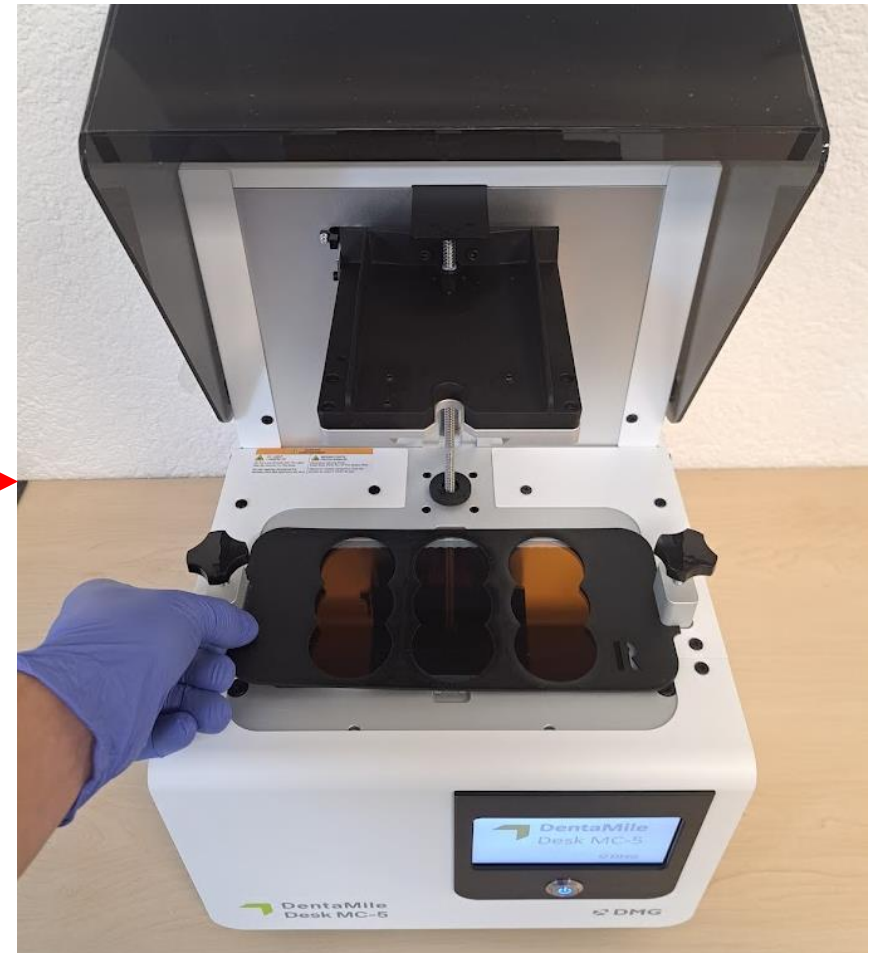


3. Schließen Sie den UV-Sensor an

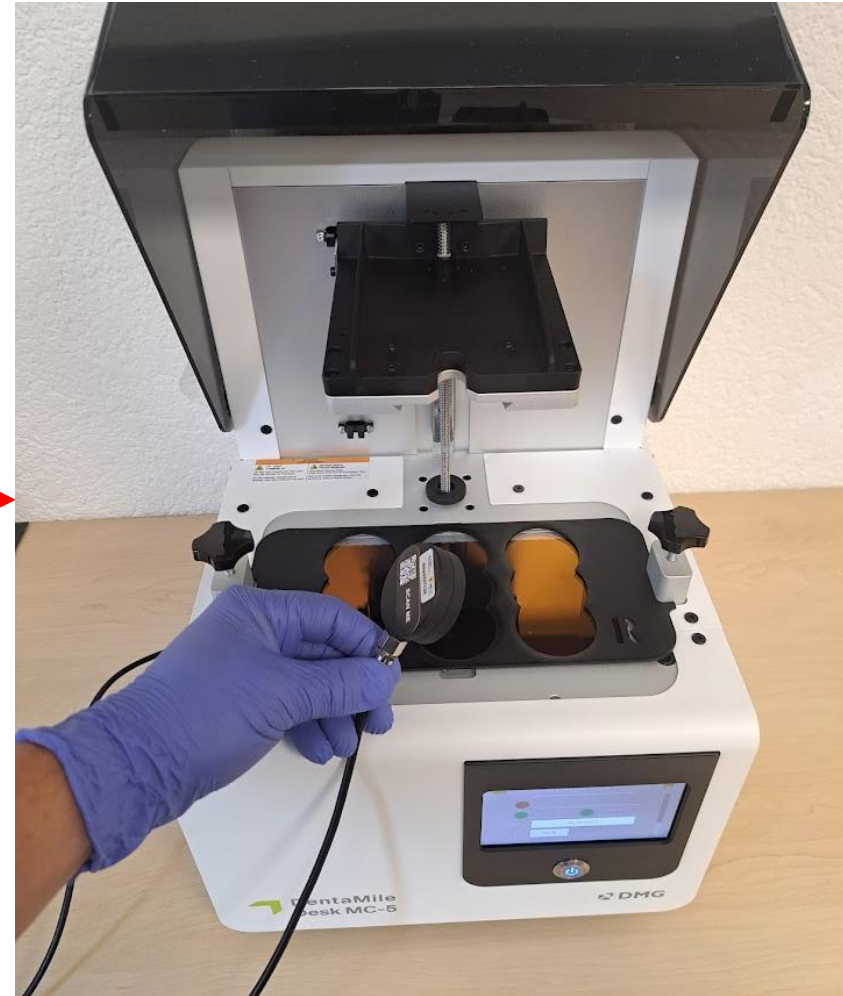




4. Positionieren Sie den Sensor mittig

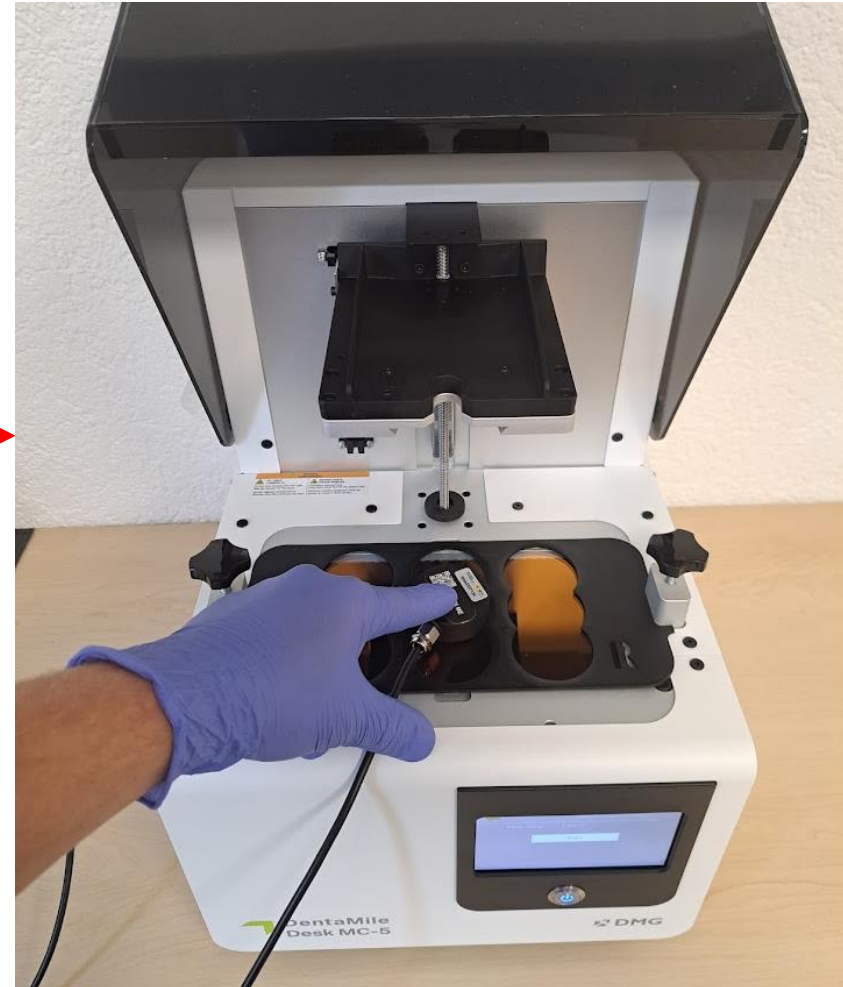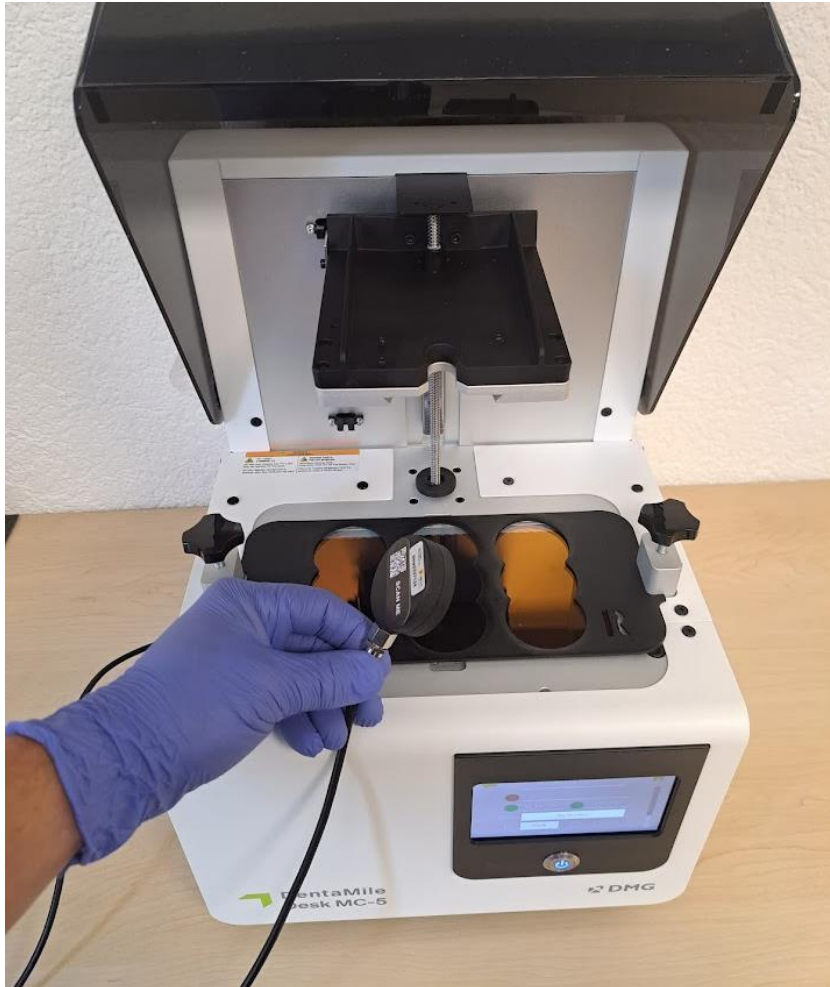

5. Navigieren Sie in das Projektormenü

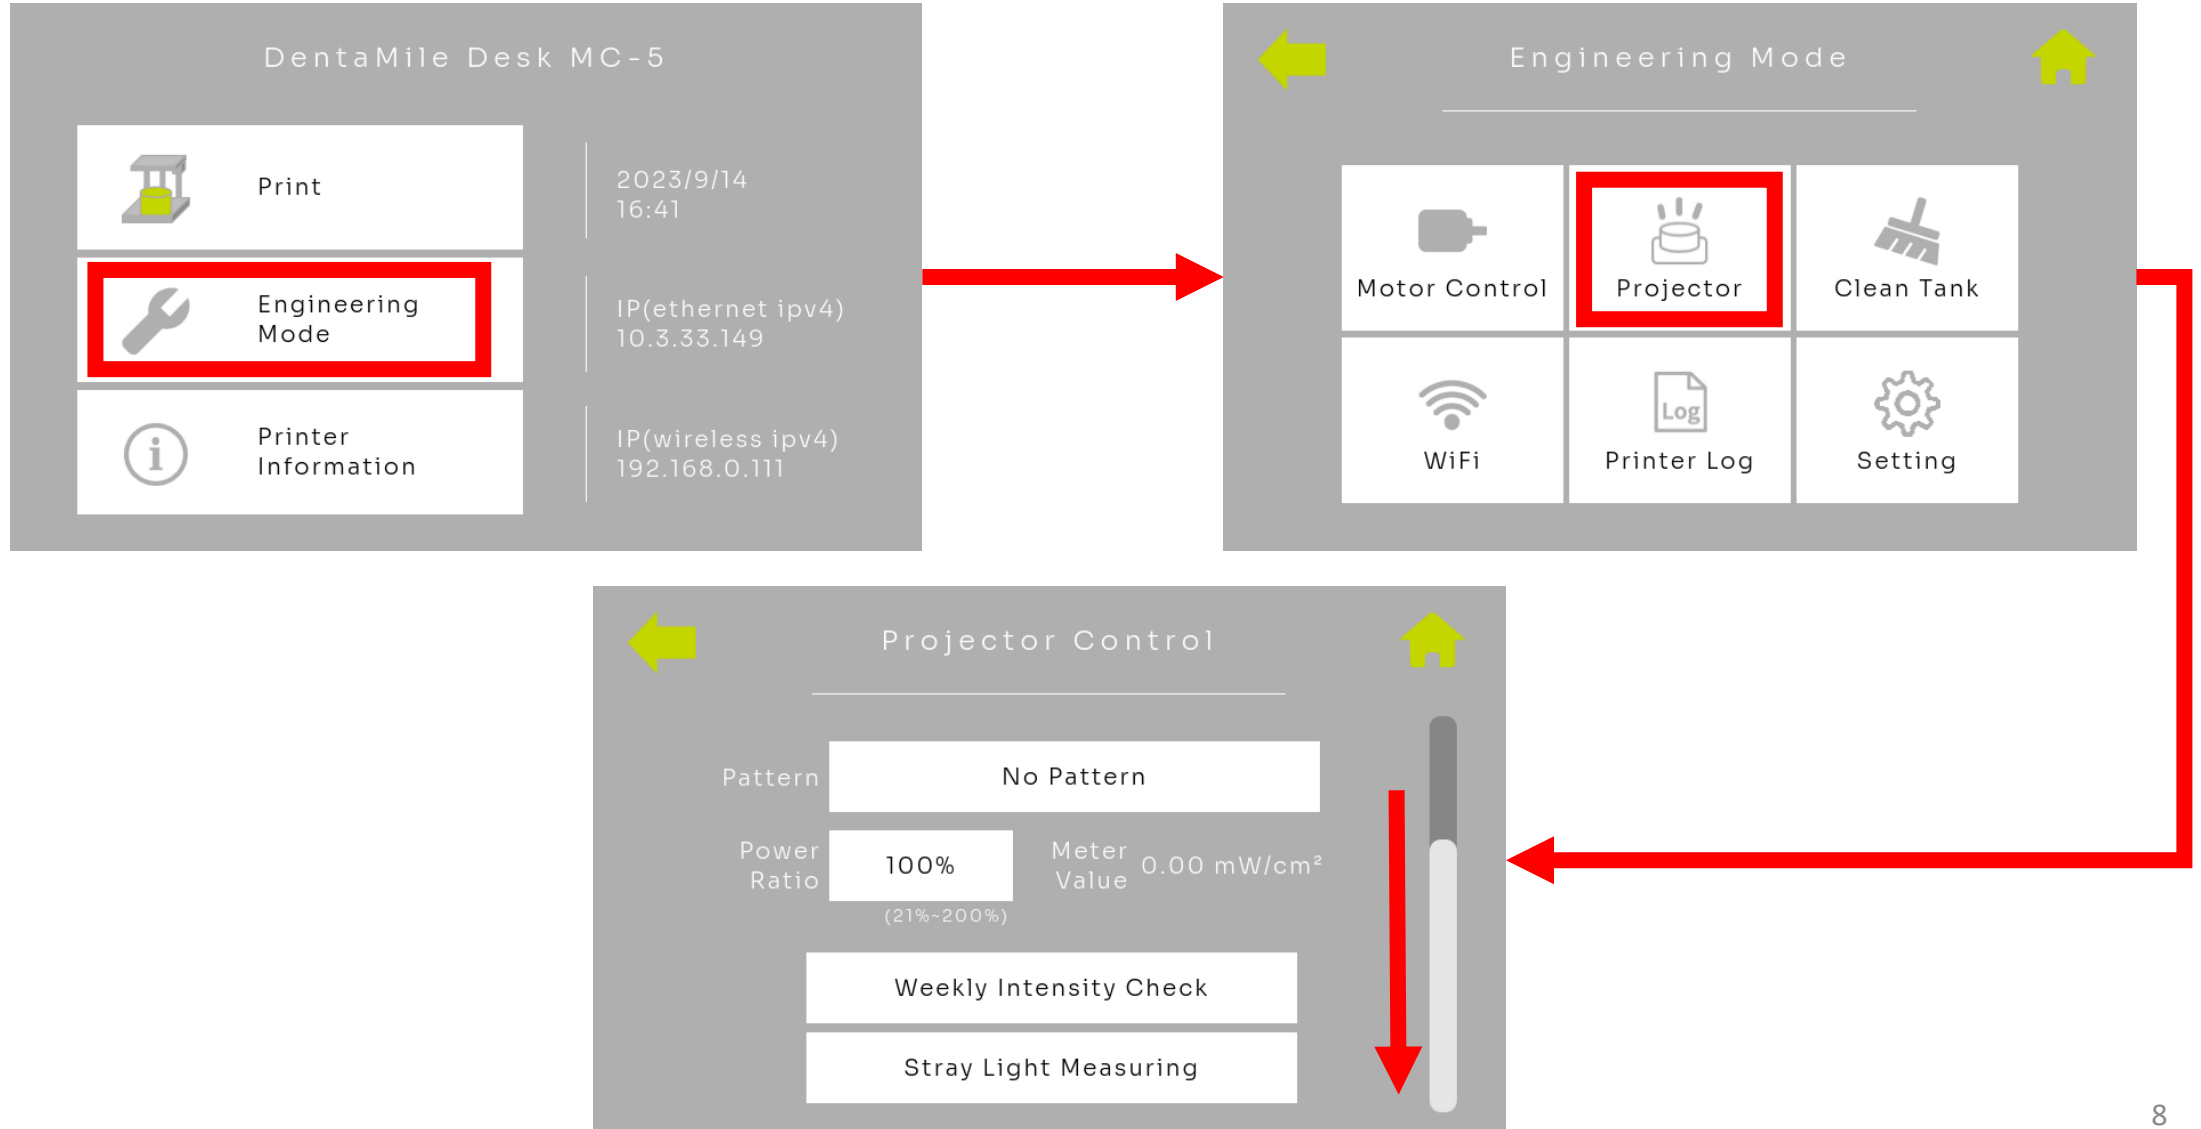

5.1 Wöchentlicher Intensitätstest

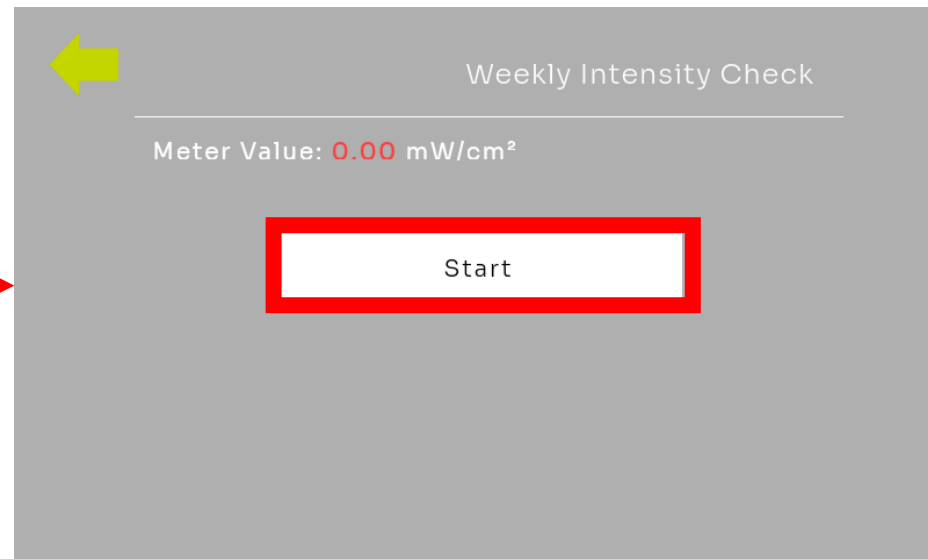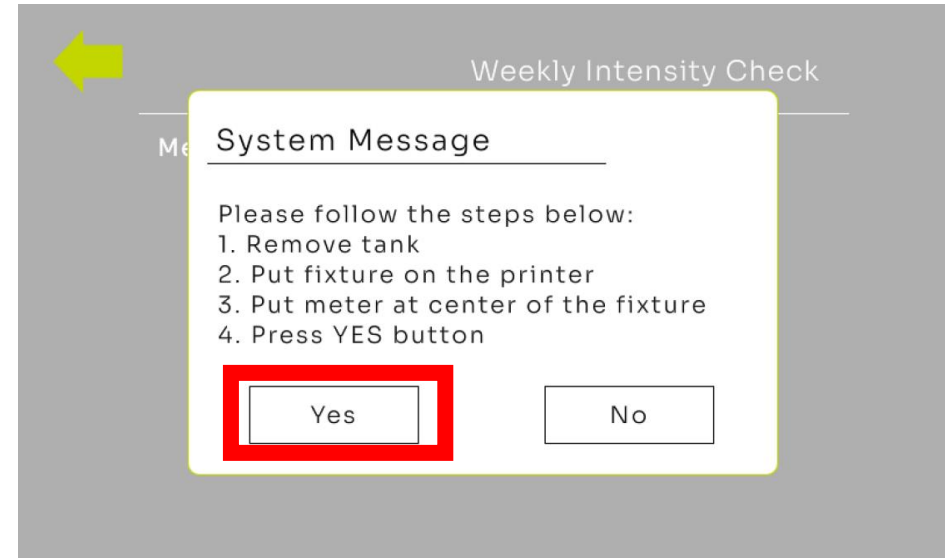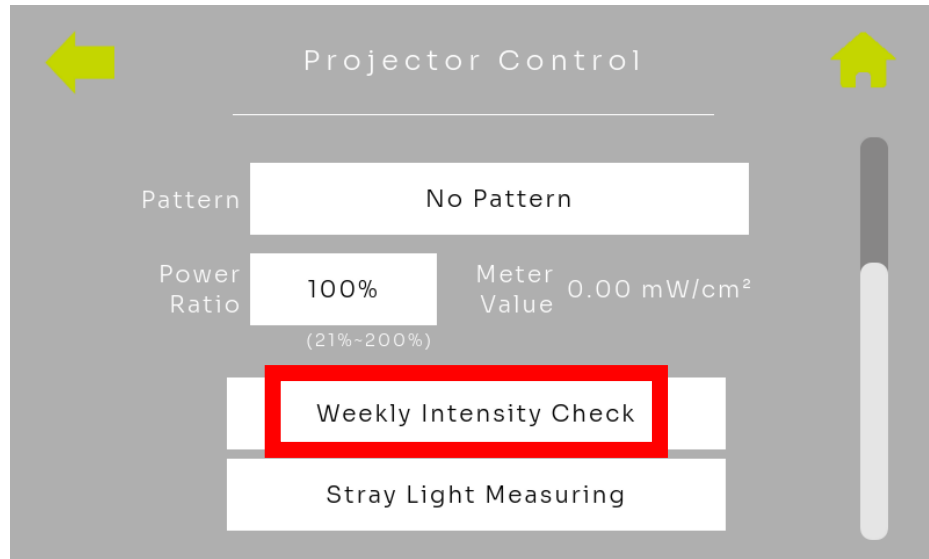



Prüfen Sie:

- Tank und Picker wurden entfernt
- Sensormaske wurde eingelegt
- UV-Sensor liegt mittig auf
- Drücken Sie Yes

5.1 Auswertung - wöchentlicher Intensitätstest

Der Test läuft nun 30 Sekunden. Bitte drücken Sie den Sensor während der Laufzeit leicht auf die Glasscheibe und vermeiden Sie ein verrutschen. Nach Abschluss des Tests zeigt Ihnen die Pop-Up Nachricht, ob der Test bestanden wurde.

Wurde der Test bestanden, können Sie mit dem Drucken fortfahren.

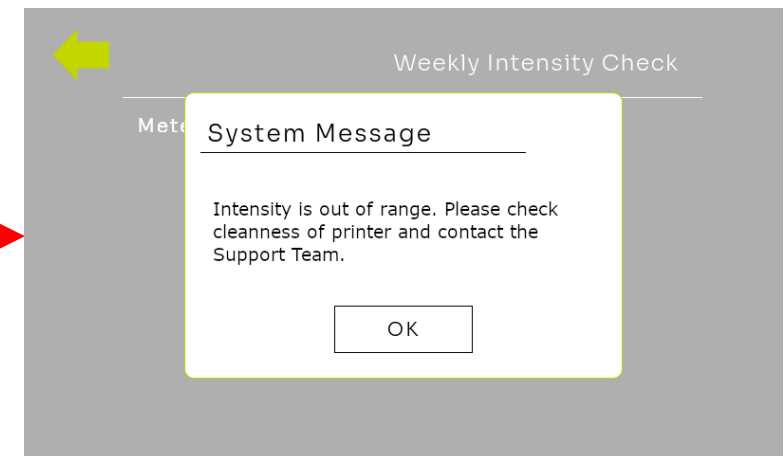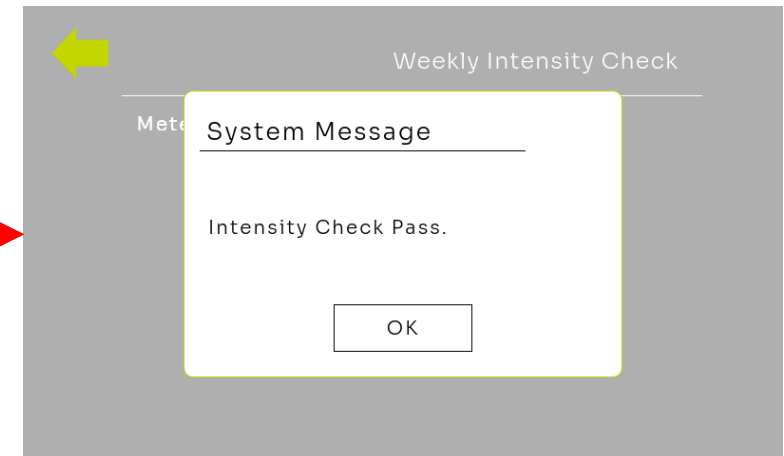



Wurde der Test nicht bestanden, prüfen Sie zunächst die Verbindung zum Sensor, die richtige Position und die Sauberkeit der Anlage. Anschließend wiederholen Sie den Test erneut. Sollte der Test noch immer nicht bestanden werden, führen Sie eine Streulichtmessung durch (siehe 5.2 und 6).

5.2 Streulichtmessung

Sollte der wöchentliche Intensitätstest fehlgeschlagen sein, oder es zu Bauteil- bzw. Druckfehlern kommen, führen Sie die Streulichtmessung durch.

Vorgehensweise:

- Siehe 3.
- Positionieren Sie den UV-Sensor auf der ersten Position vorne links

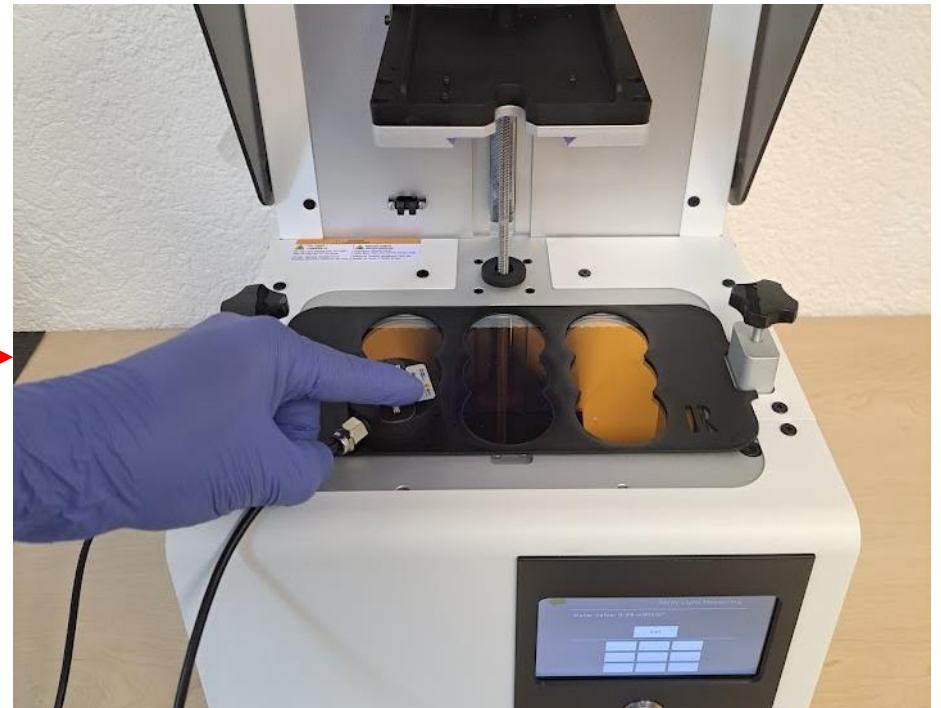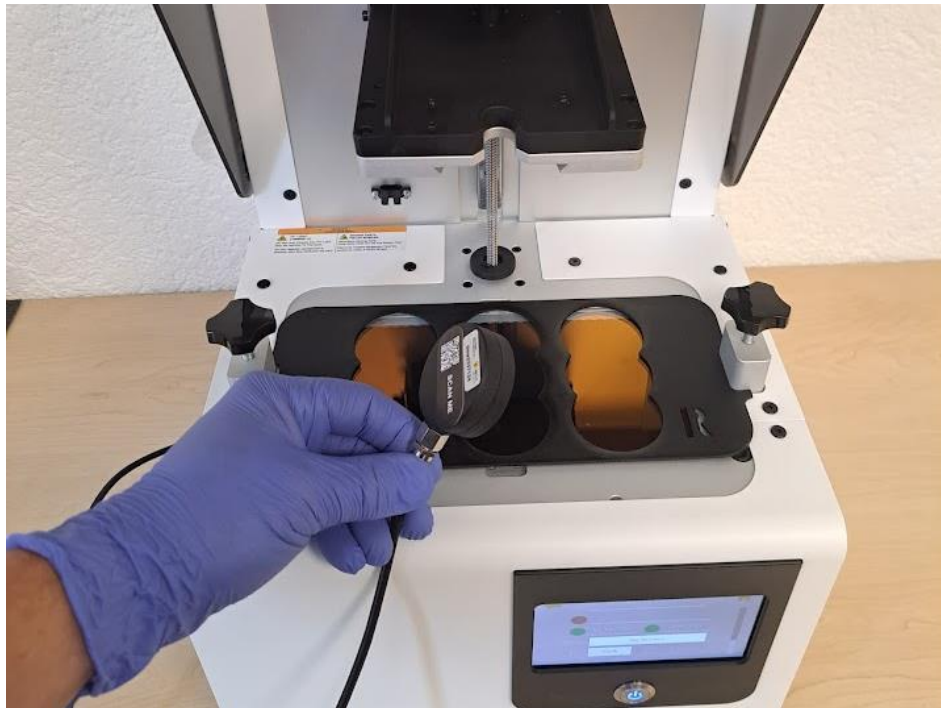


5.2 Streulichtmessung

Navigieren Sie zum Projektormenü (siehe Punkt 5.)

Vorgehensweise:

- Wählen Sie Stray Light Measuring aus


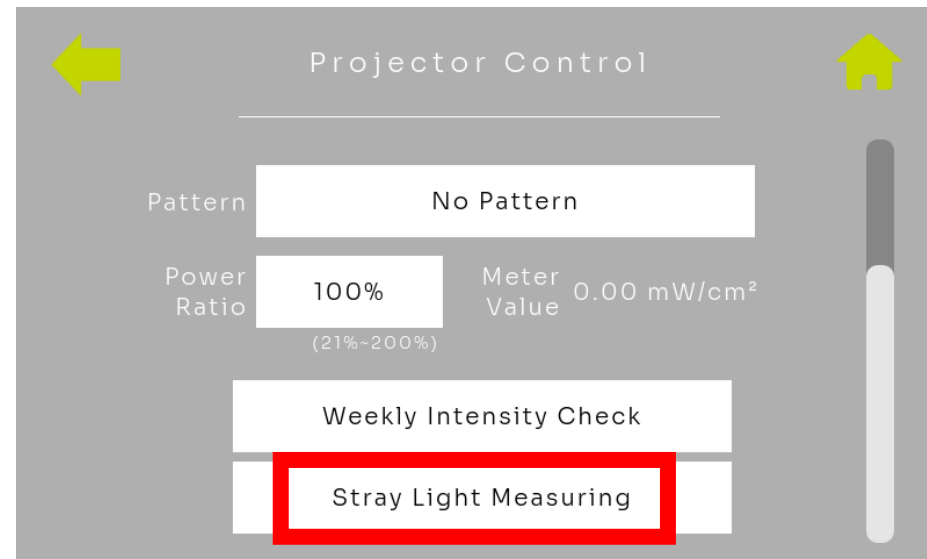


5.2 Streulichtmessung

Der Projektor bildet nun im ersten Feld einen dunklen Bereich ab.

Vorgehensweise:

- Warten Sie ca. 10 Sekunden
- Klicken Sie auf Set

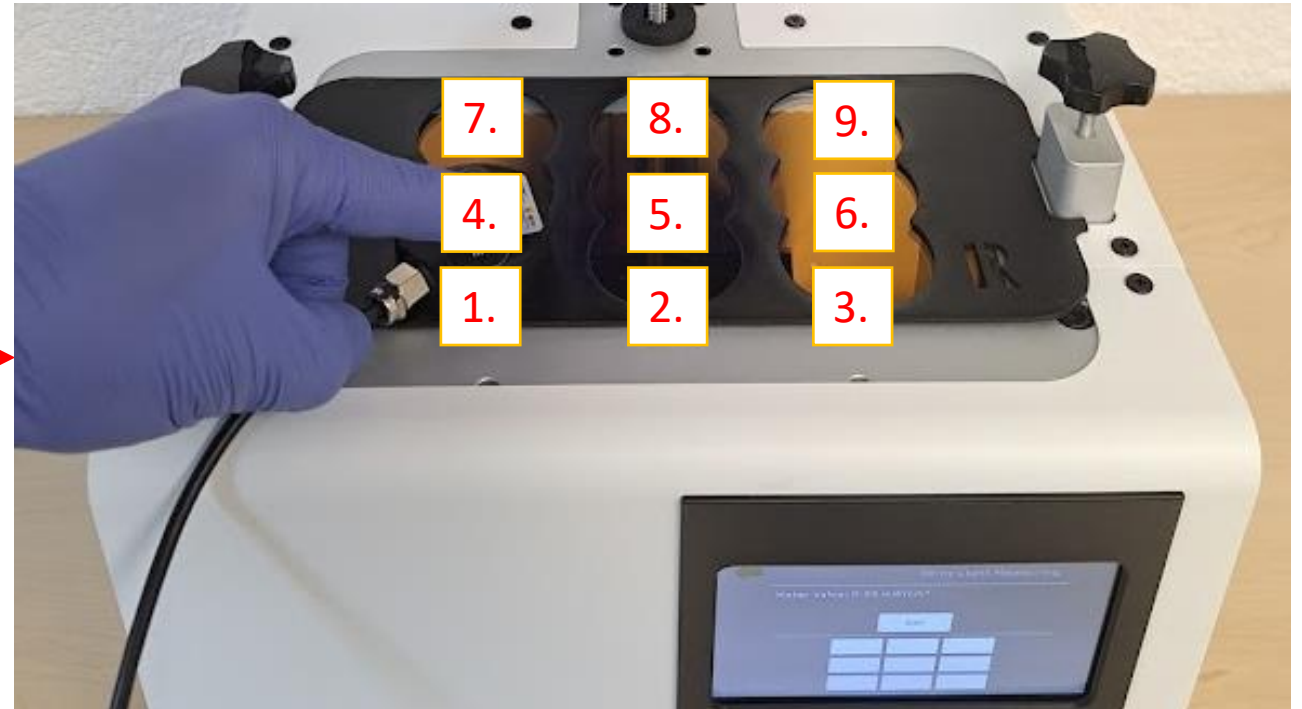
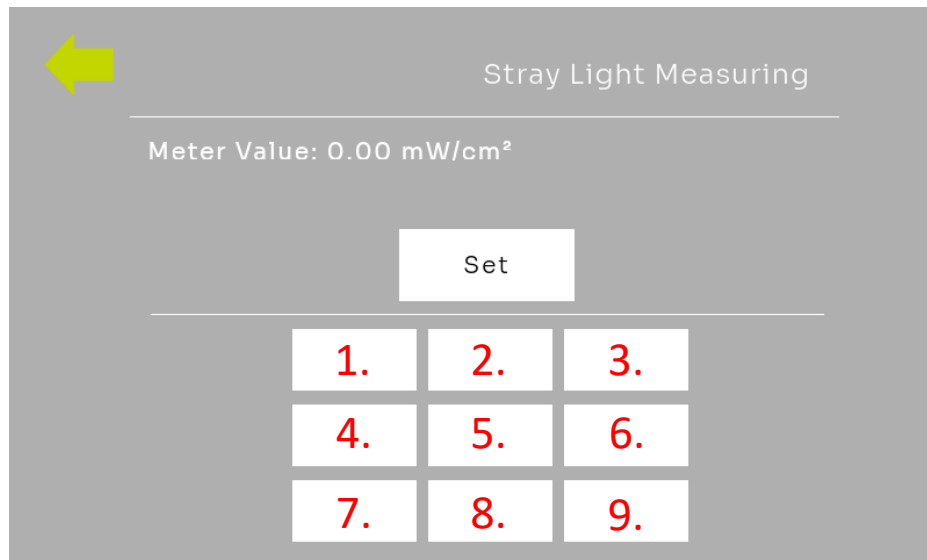


5.2 Streulichtmessung

Der Projektor bildet nun im zweiten Feld einen dunklen Bereich ab.

Vorgehensweise:

- Wechseln Sie den Sensor auf Feld 2. und warten Sie ca. 10 Sekunden
- Klicken Sie erneut auf Set

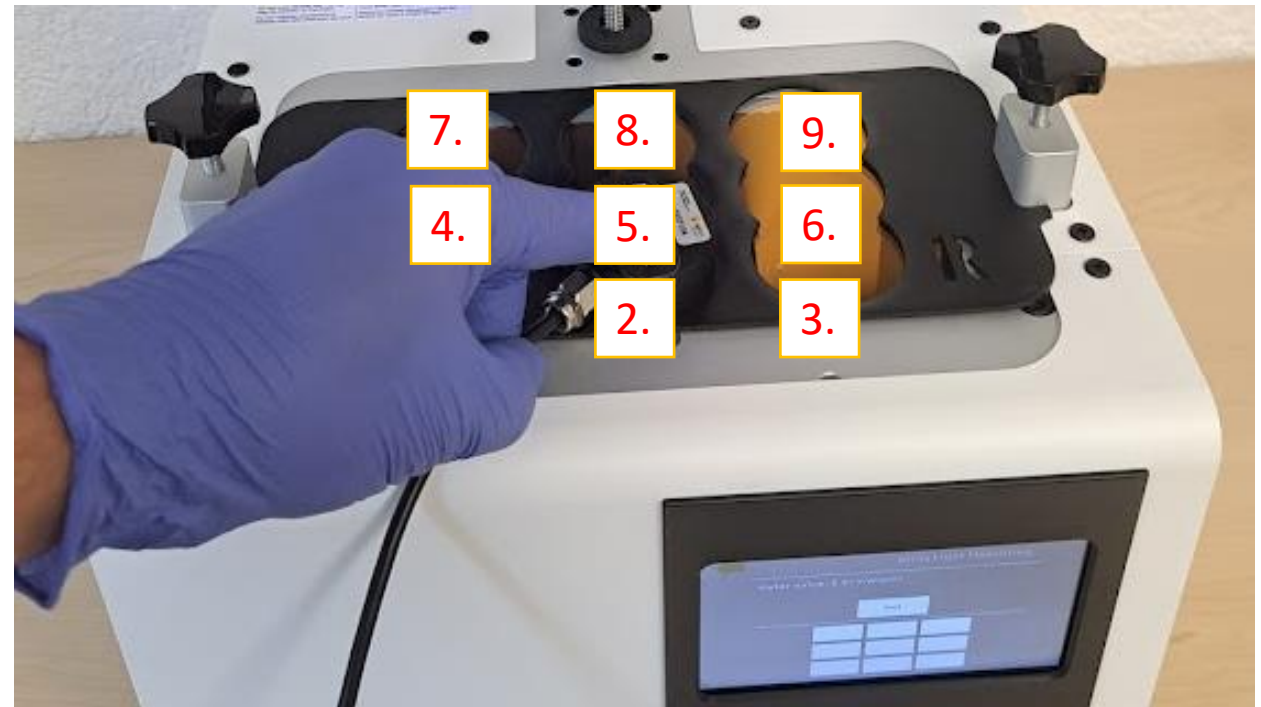
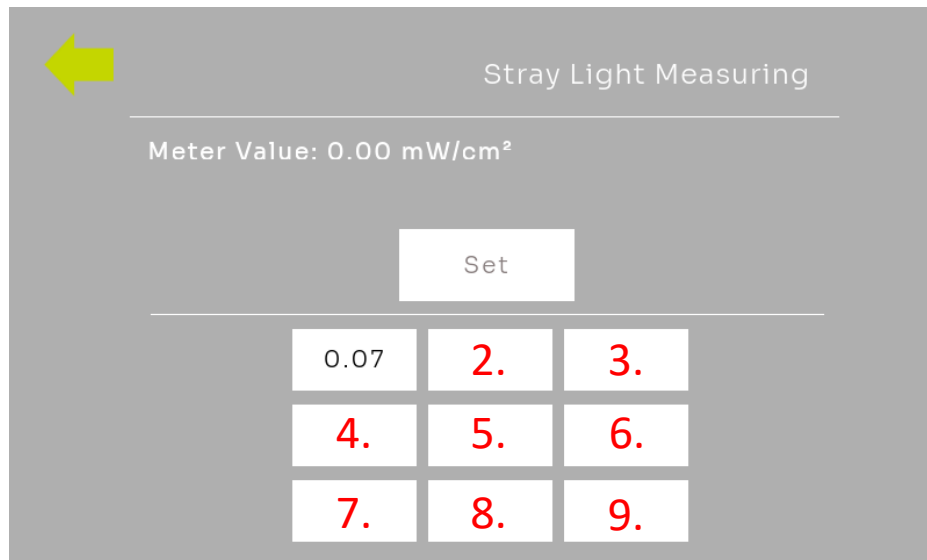


5.2 Streulichtmessung

Der Projektor bildet nach und nach in allen Feldern den dunklen Bereich ab.

Vorgehensweise:

- Messen Sie der Reihenfolge nach alle 9 Felder bis die Streulichtmessung vollständig ist
- Bestätigen Sie Punkt 9. mit Set

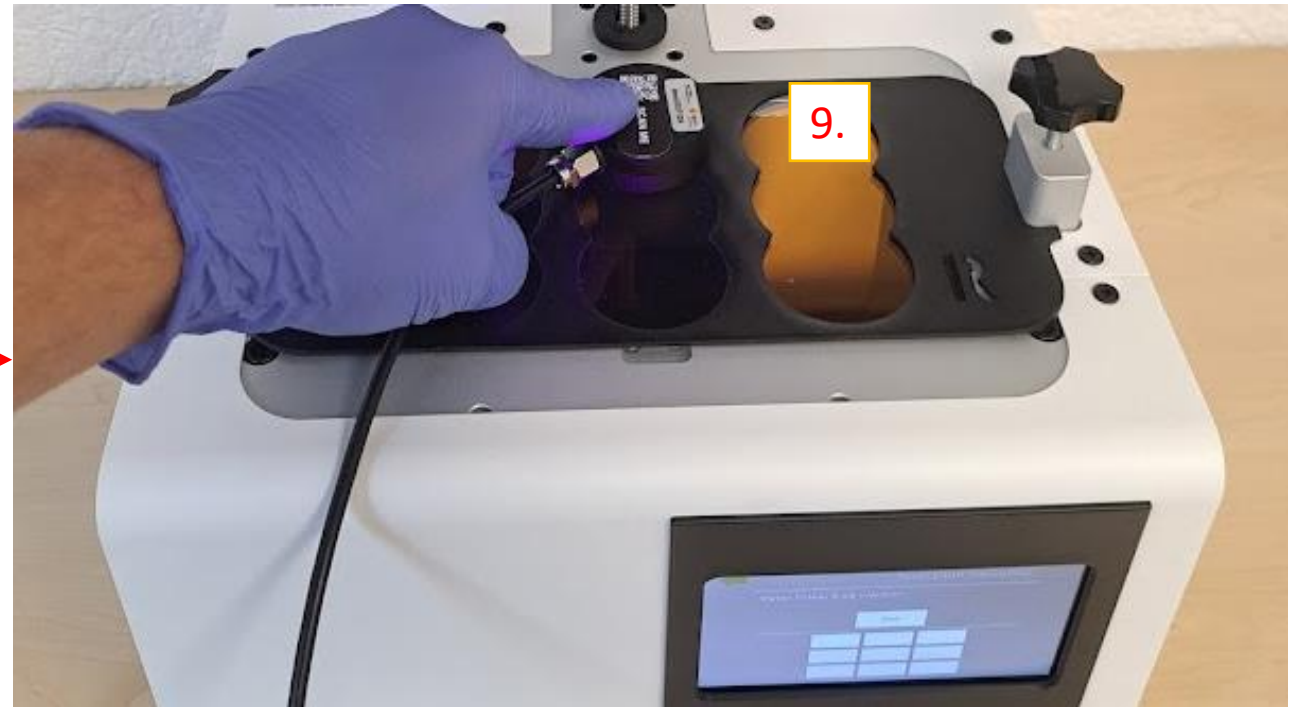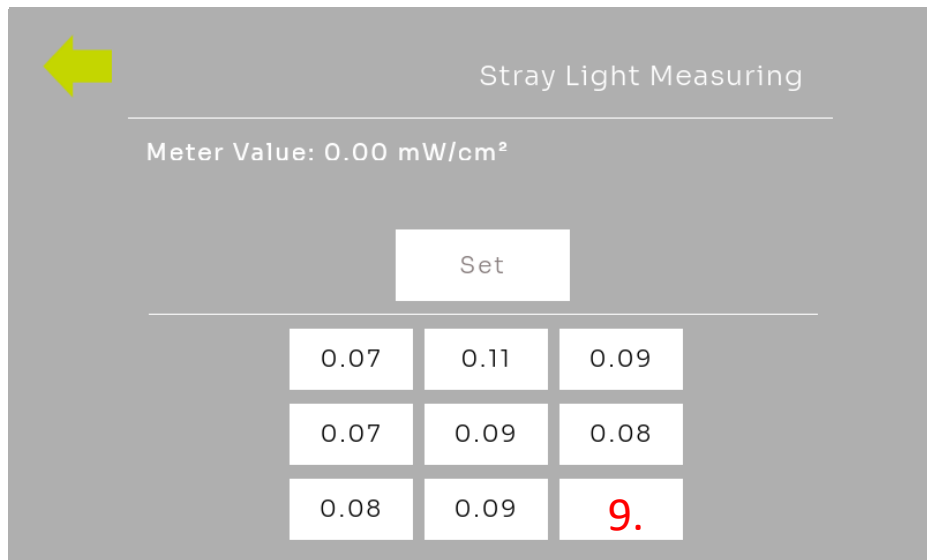


5.2 Auswertung - Streulichtmessung

- Optimalerweise erreichen die Felder bei der Streulichtmessung Werte von: $I \leq 0,1mW/cm^2$
- Sollte der Wert größer sein, prüfen Sie bitte die Sauberkeit der Anlage.
- Leichte Kratzer oder Aufrauhungen können auch zu erhöhten Streulichtwerten führen
- Ab $I \geq 0,15mW/cm^2$ wenden Sie sich bitte an Ihr DentaMile Support-Team

Bitte schließen Sie das Fenster nach Beendigung der Streulichtmessung, um den Projektor zu deaktivieren.

Sollten Sie ein Feld erneut testen wollen, klicken Sie auf das gewünscht Feld und setzen Sie den Sensor erneut auf.

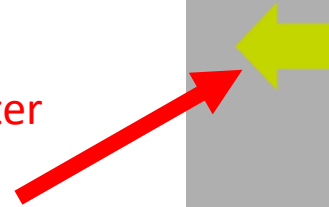


Stray Light Measuring

Meter Value: 0.00 mW/cm²

Set

0.07	0.11	0.09
0.07	0.09	0.08
0.08	0.09	0.08

6. Auswertungsdiagramm

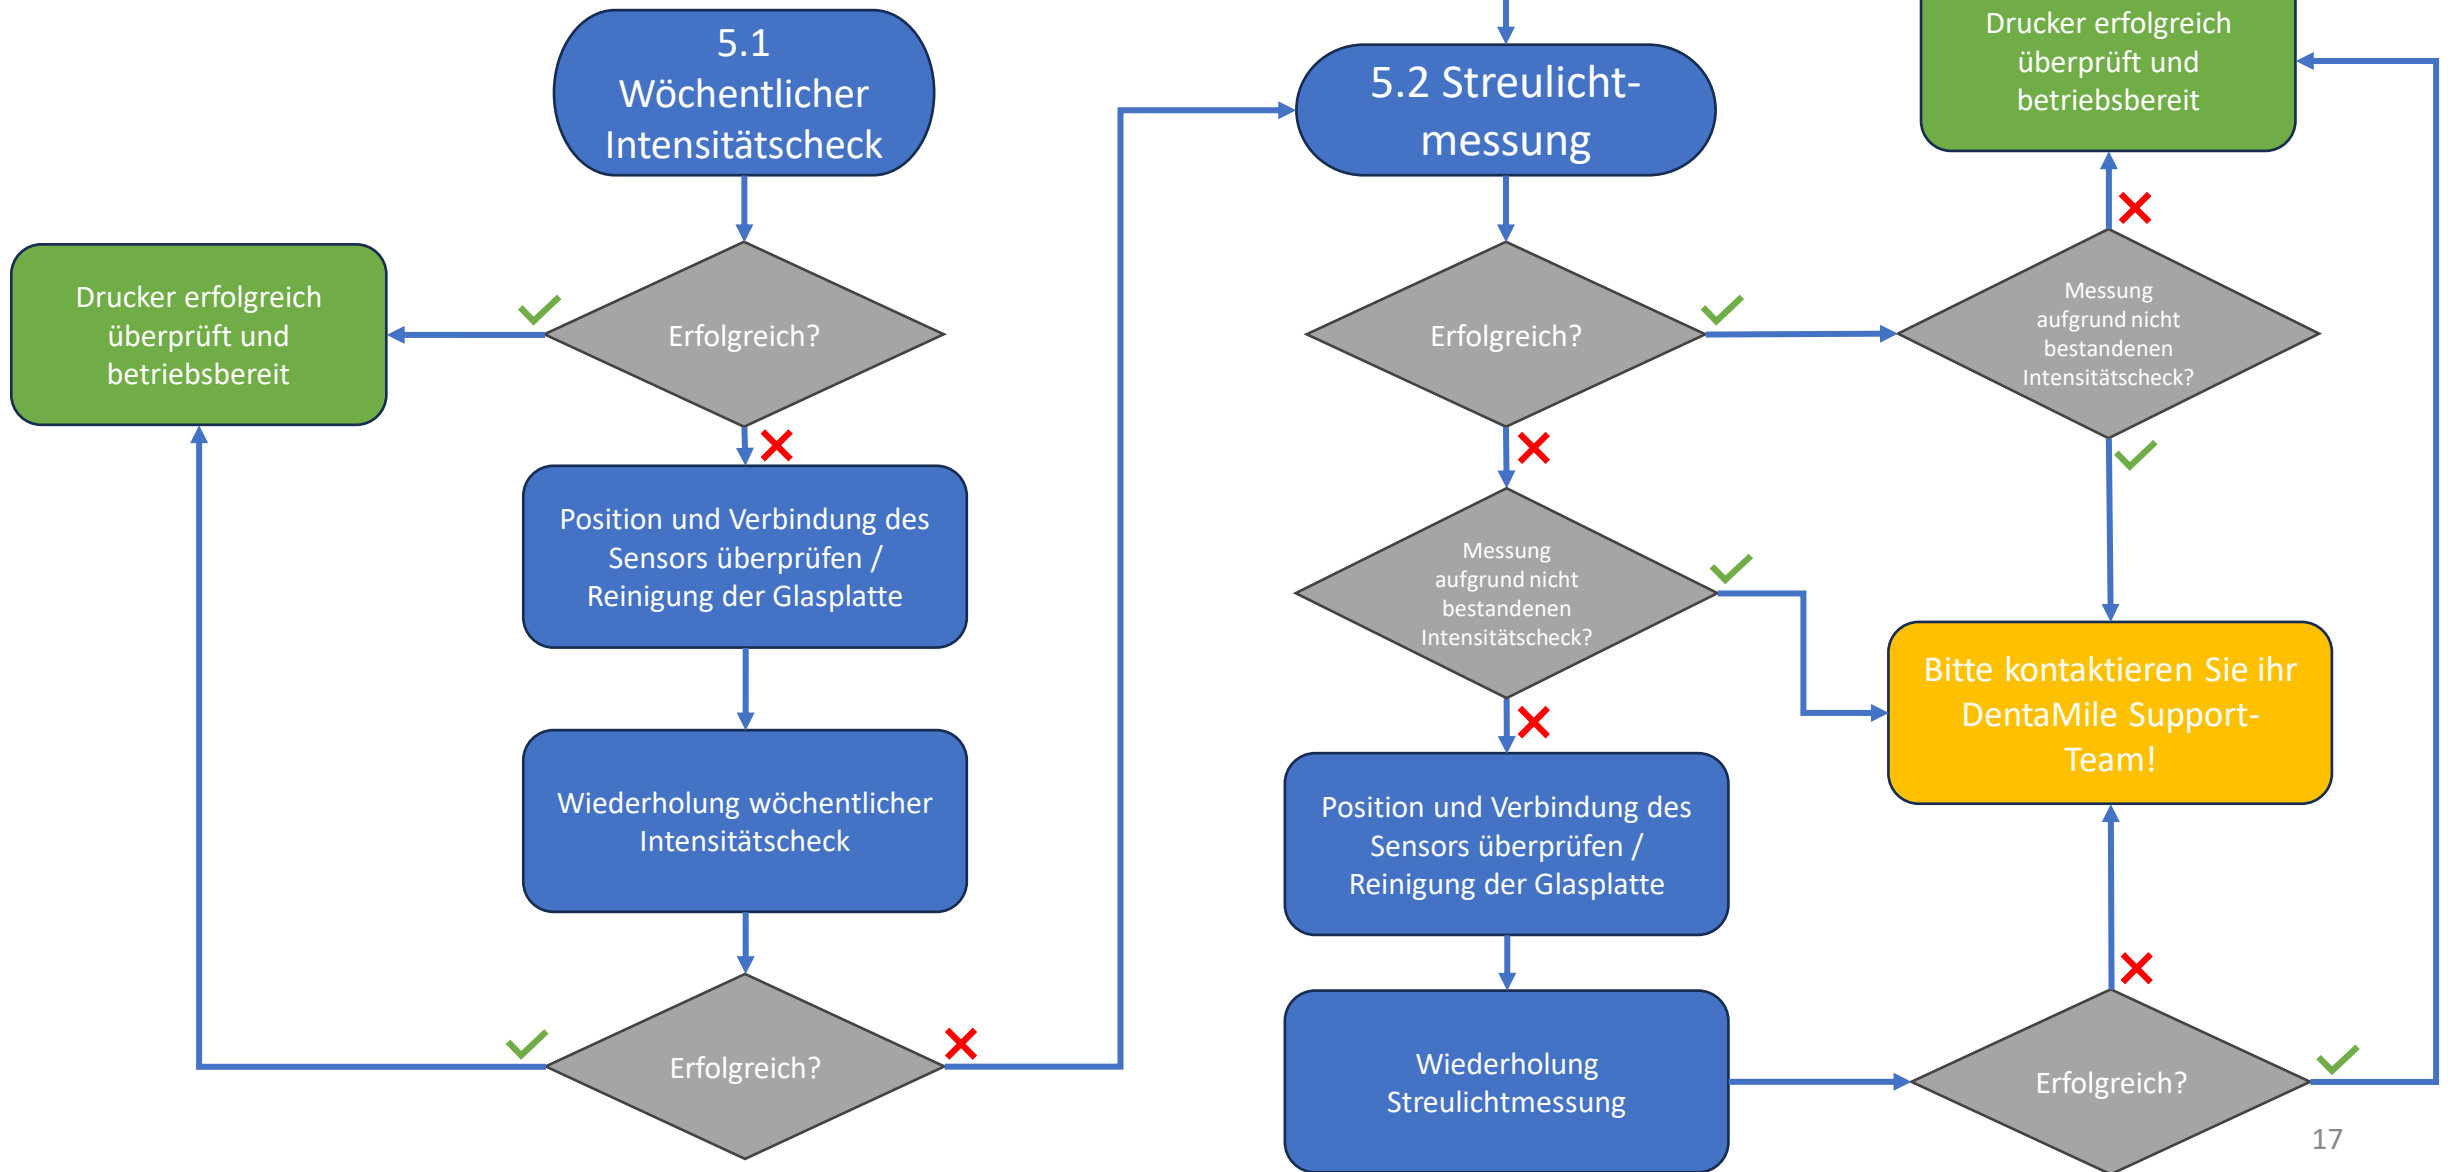

7. UV-Sensor Rekalibrierung

Die Nachfolgenden Informationen sind wichtig für Ihren validierten Workflow!

- Ihr UV-Sensor muss einmal pro Jahr recalibriert werden. Damit stellen Sie sicher, dass der Sensor verlässliche Messwerte liefert.
- Bitte senden Sie Ihren Sensor an unseren Partner BURMS zur Re-Kalibrierung
- Legen Sie Ihren Sensor hierfür in einen gepolsterten Umschlag und senden diesen an

BURMS 3D Druck GmbH und Co.KG.
Hermann-Löns-Str. 2
07745 Jena
Germany
- Wenn Sie einen optionalen Wartungsvertrag haben ist die Rekalibrierung in Ihren jährlichen Wartungsgebühren inbegriffen. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie die Re-Kalibrierung ca. 4 Wochen vor Ihrer jährlichen Wartung an unseren Partner schicken, da sie für die Wartung einen recalibrierten Sensor benötigen.
- Sollten Sie keinen Wartungsvertrag abgeschlossen haben, wird die Rekalibrierung mit **299,-** in Rechnung gestellt.

8. Ablauf bei Wartungsvertrag

Ablauf der Wartung:

1. Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit BURMS unter Benennung der Seriennummer
 - Terminvergabe unter: <https://calendly.com/burms3d/online-termin>
2. Sie erhalten nun einen möglichen Termin oder können einen Termin auswählen
 - Die Rekalibrierung erfordert Ihre Anwesenheit. Bitte planen Sie etwa 2h ein
3. Zum Termin wird Ihnen ein Mitarbeiter von BURMS einen MS TEAMS Link zur Verfügung stellen
 - TEAMS kann dabei via Browser oder via TEAMS Applikation genutzt werden
4. Bitte führen vor dem Termin folgende Tätigkeiten durch:
 - Bauplattform entfernen
 - Tank entfernen
 - Glasscheibe gewissenhaft reinigen (Isopropanol oder Glasreiniger)
 - Einschalten der Anlage
 - Achten Sie darauf, dass eine Verbindung mit dem Internet besteht
5. Halten Sie das folgend mitgelieferte Zubehör bereit:
 - Kalibrationsmaske
 - UV-Sensor

Alle weiteren Schritte erklärt Ihnen ihr Ansprechpartner bei BURMS.

Bitte beachten Sie: Der Termin kann nur auf Deutsch oder Englisch durchgeführt werden.

English



**Instructions for weekly intensity testing
and stray light measurement**

General instructions/notes


- Please always use appropriate safety measures:
 - UV protective goggles
 - Gloves
- Avoid direct sunlight or other light sources that can affect the results.
- Keep the sensor clean and avoid touching the sensor surface.
- The results can provide the following indications:
 - Cleanliness of the window
 - Wear and tear of the window
 - Degeneration of the projector
- If you are unsure, please contact your DentaMile support team.




1. Remove the tank, build platform, and start the printer

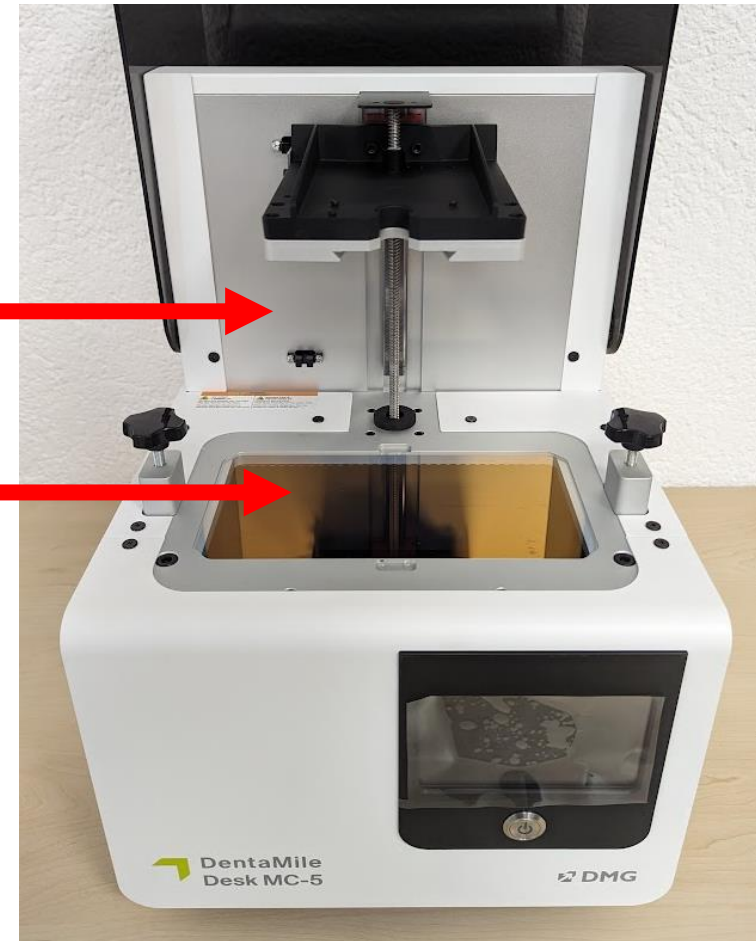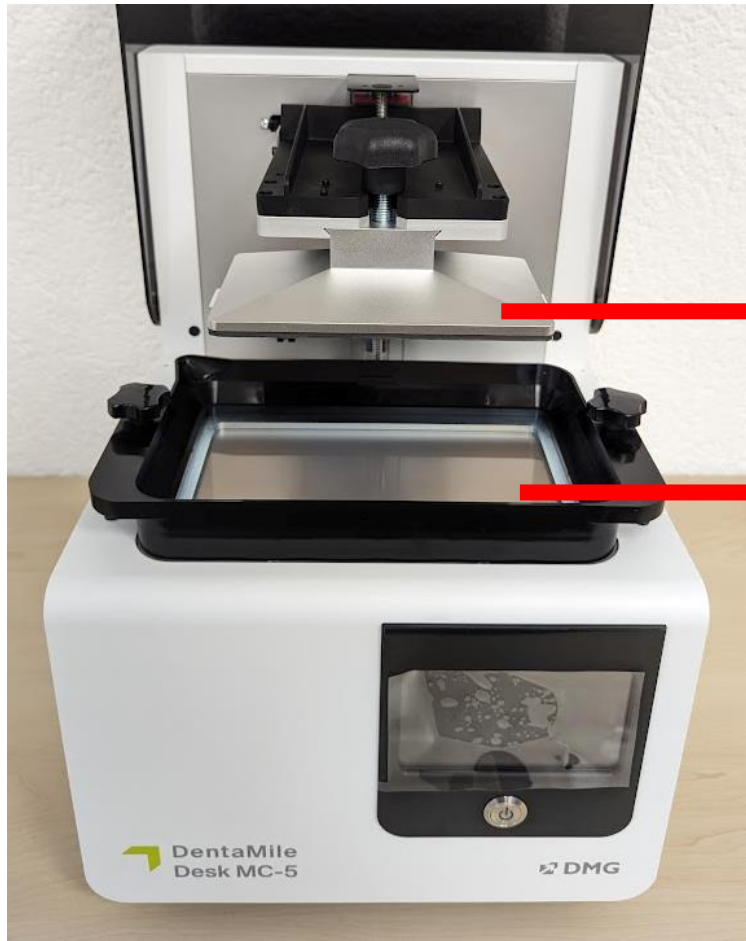


2. Insert the sensor mask

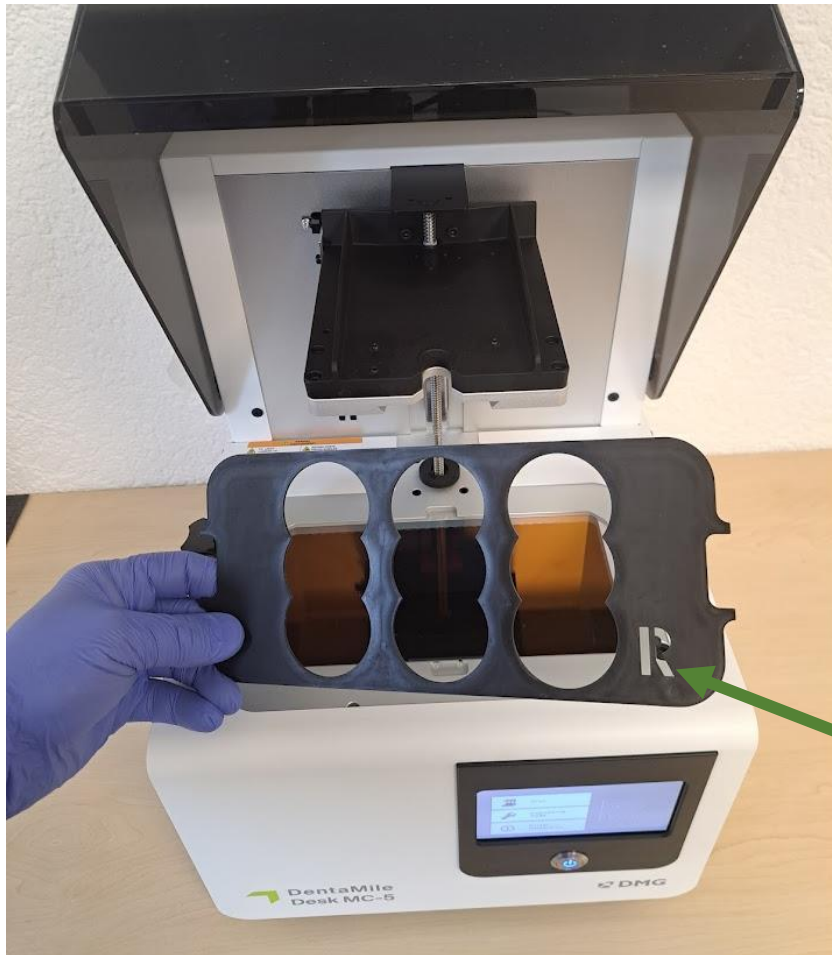



on the
right

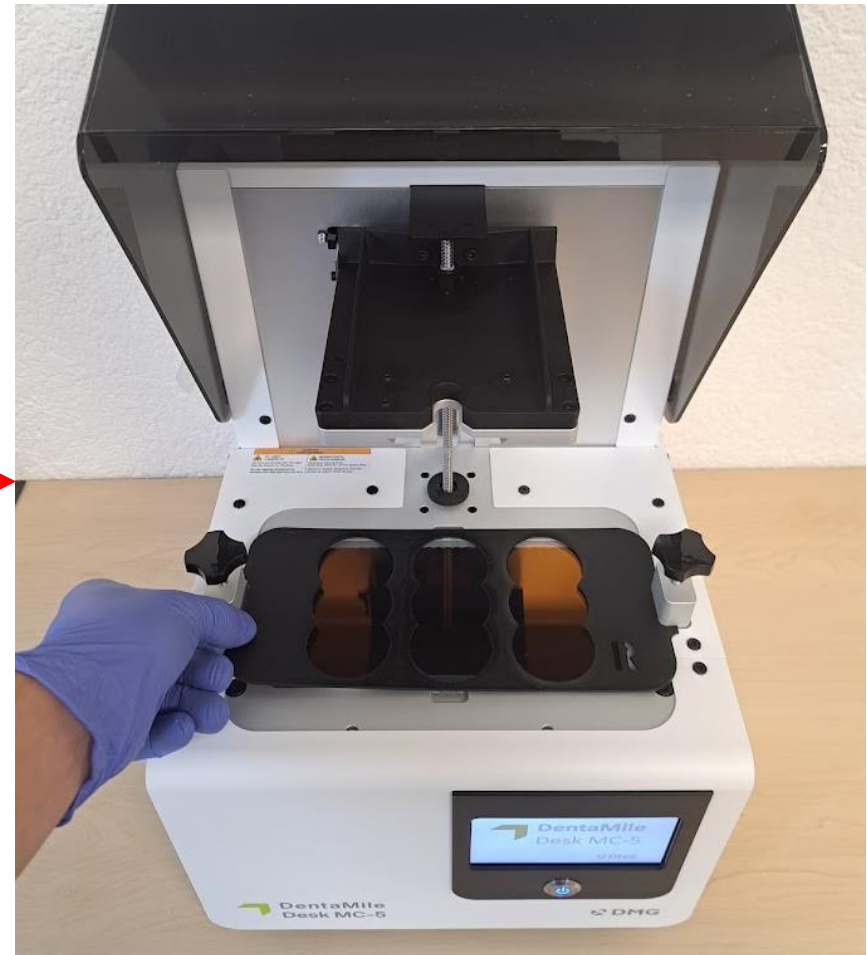


3. Connect the UV sensor.

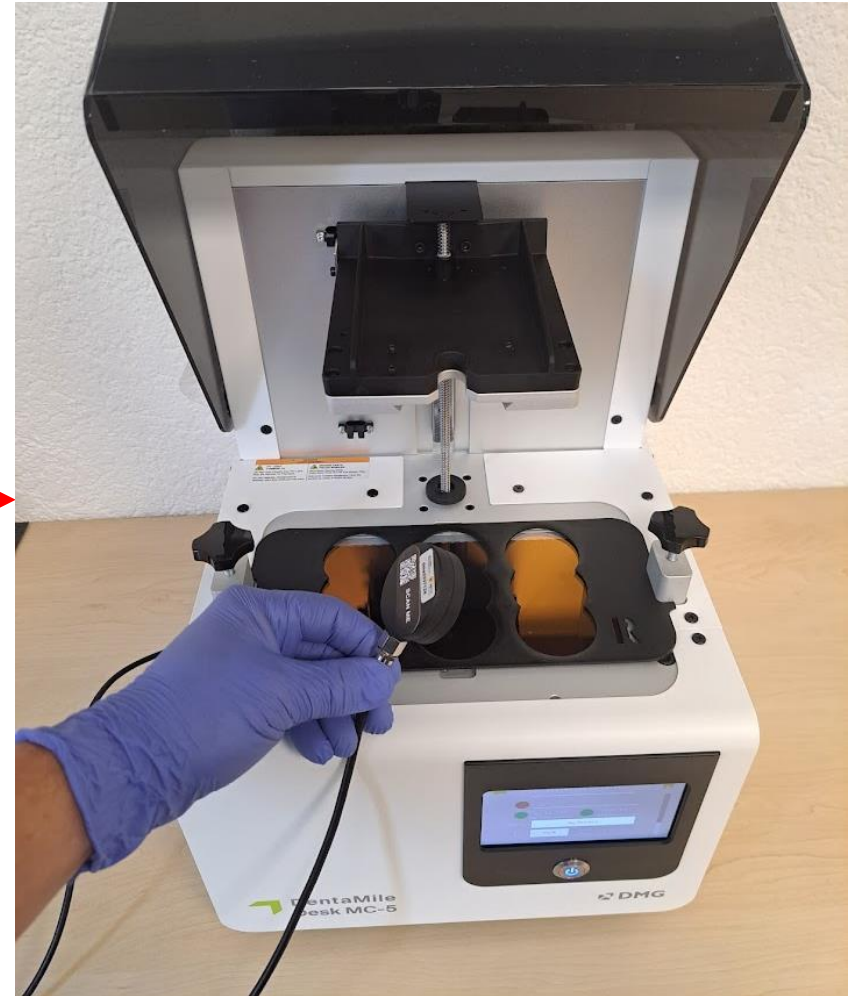




4. Position the sensor in the center.

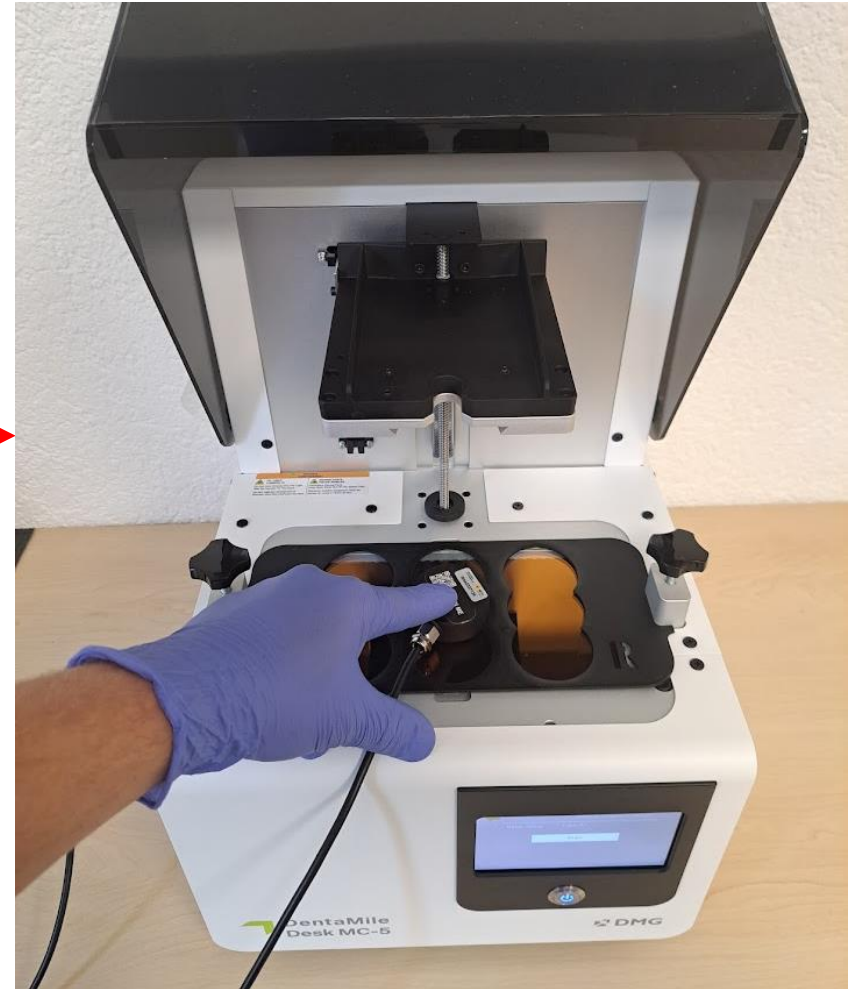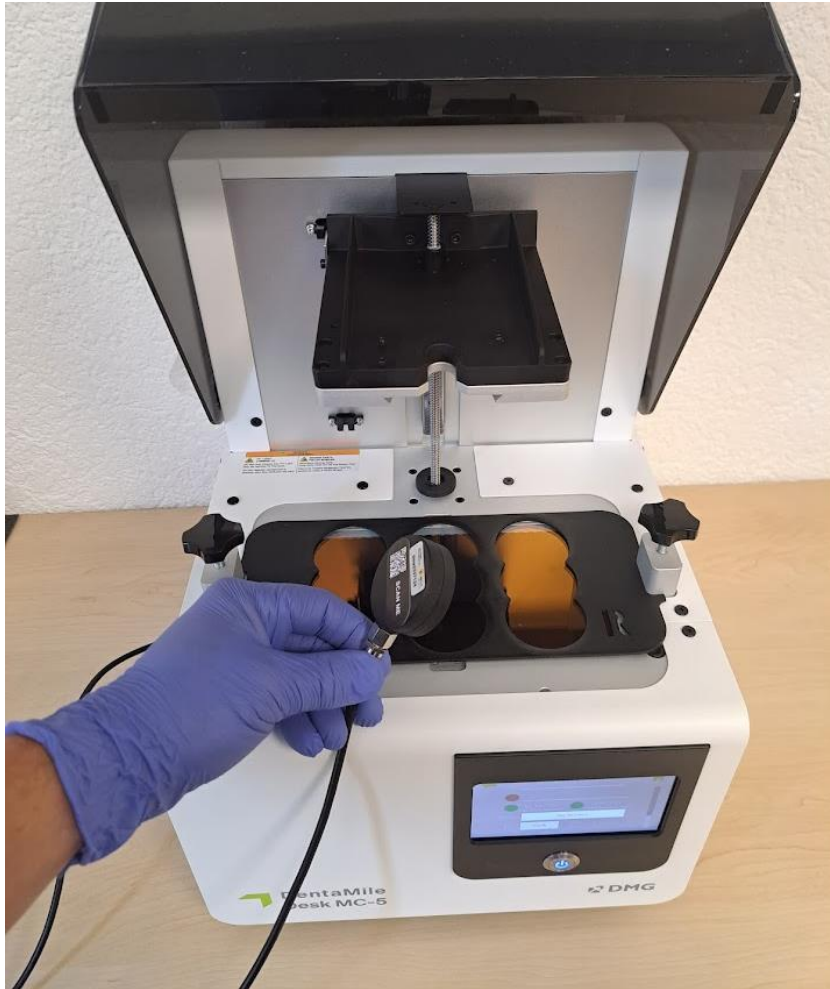

5. Navigate to the projector menu.

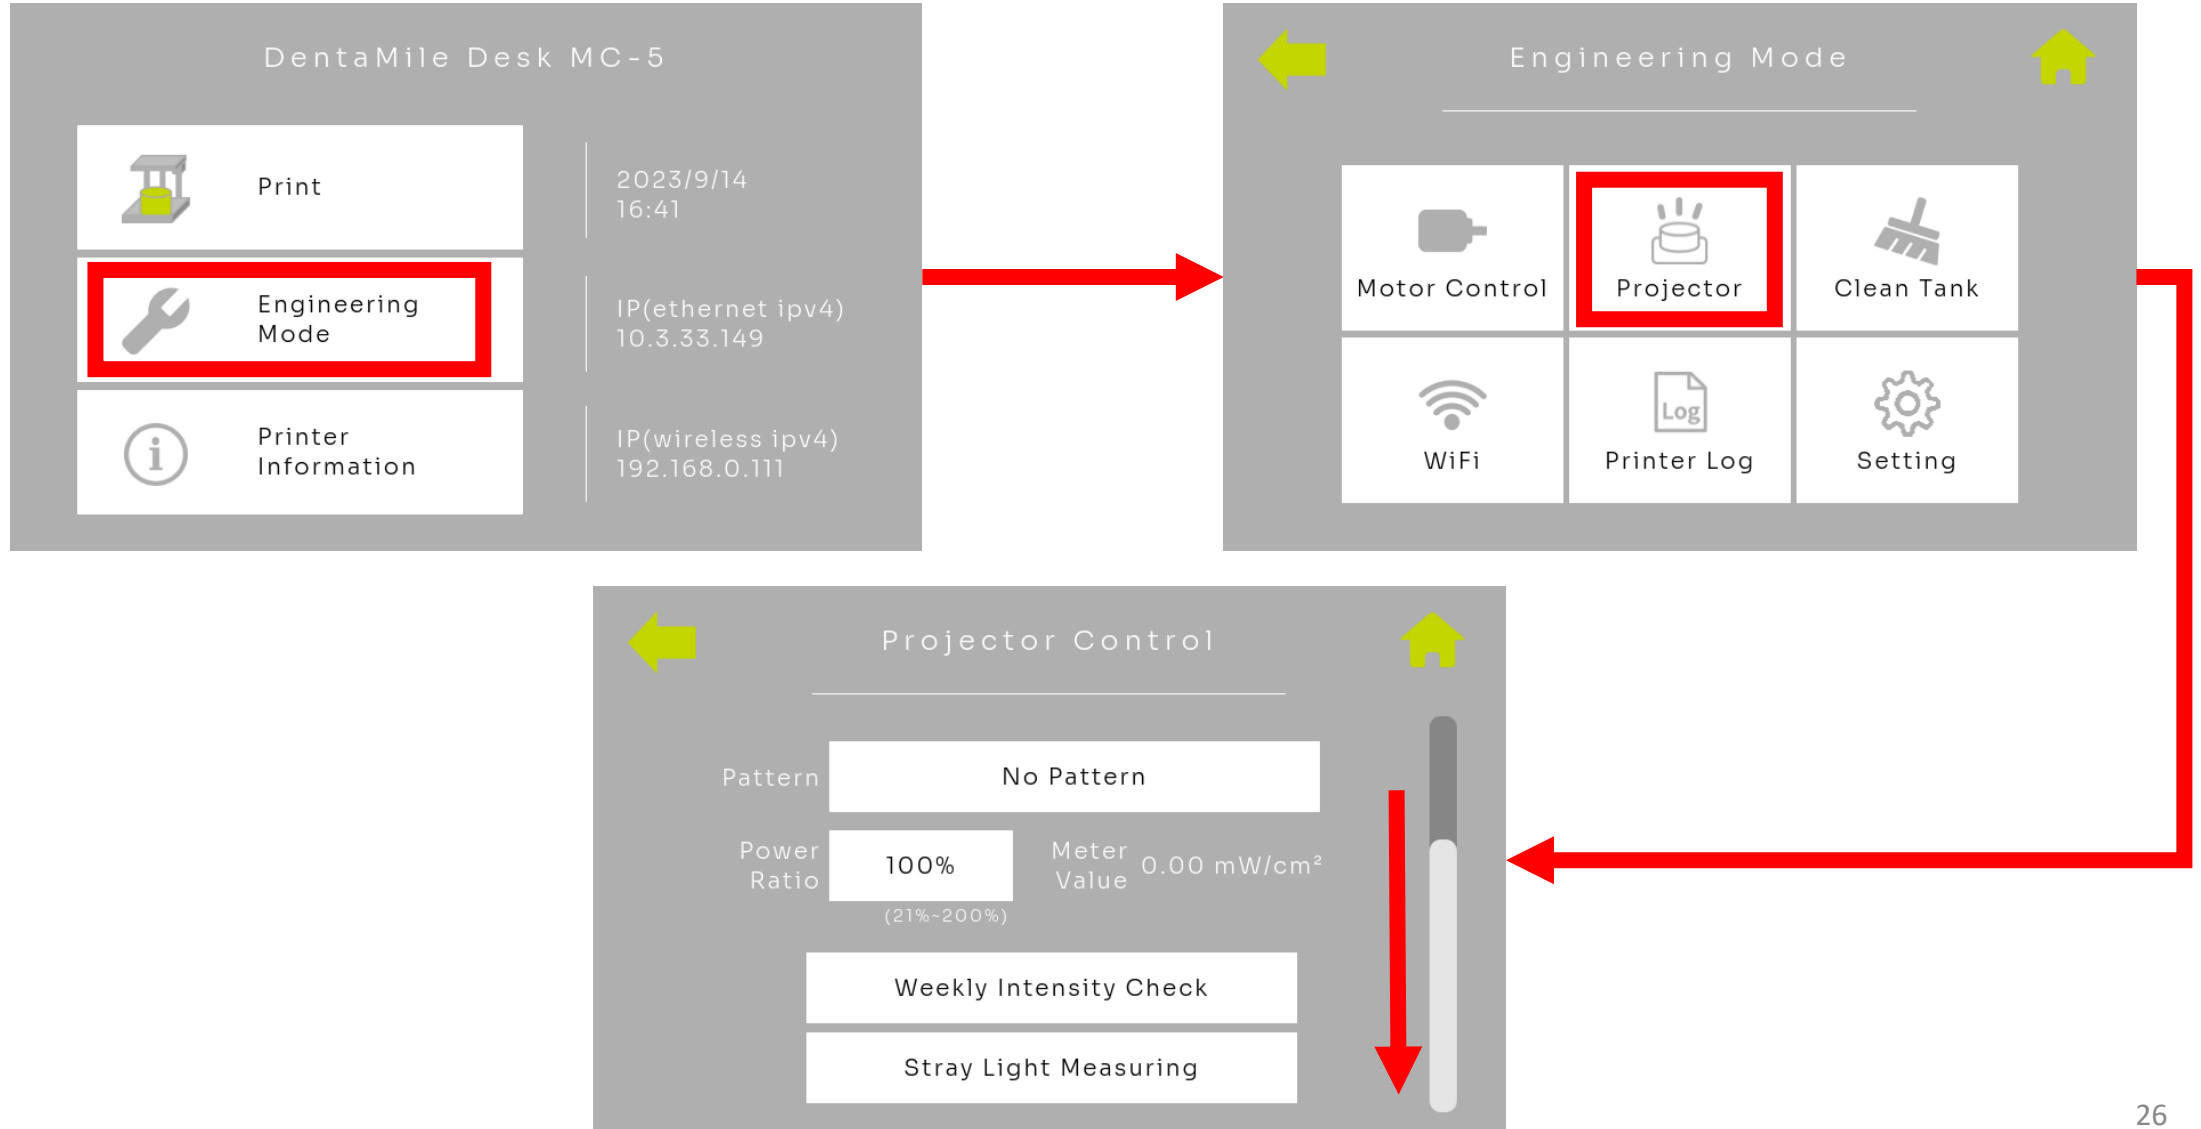

5.1 Weekly intensity test.

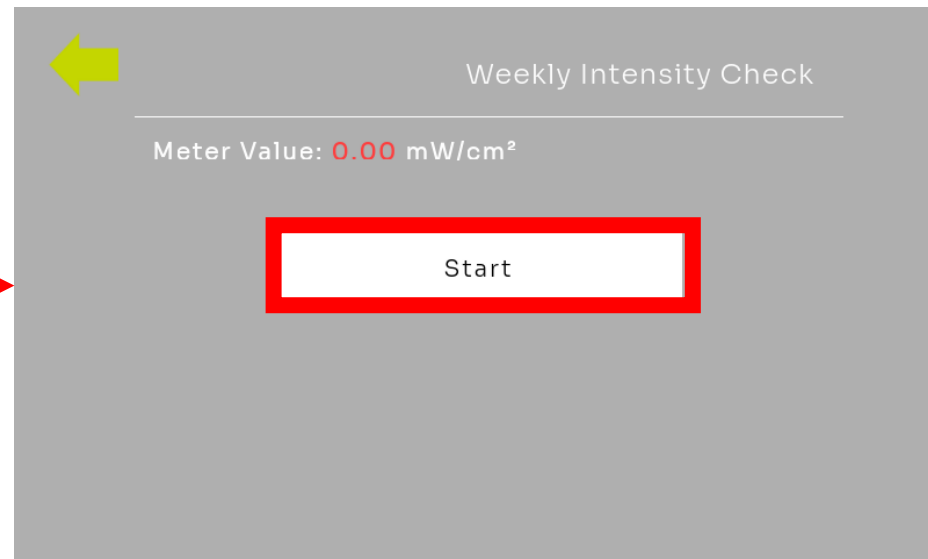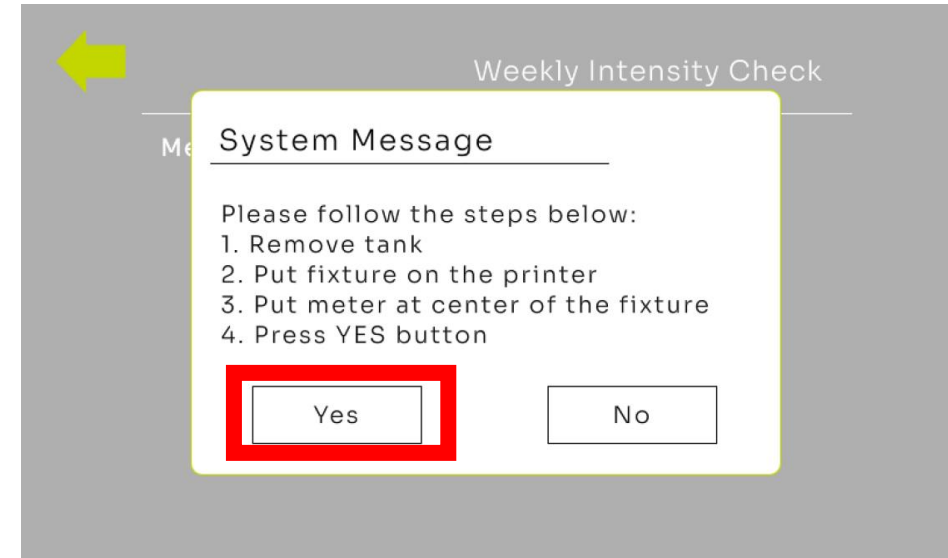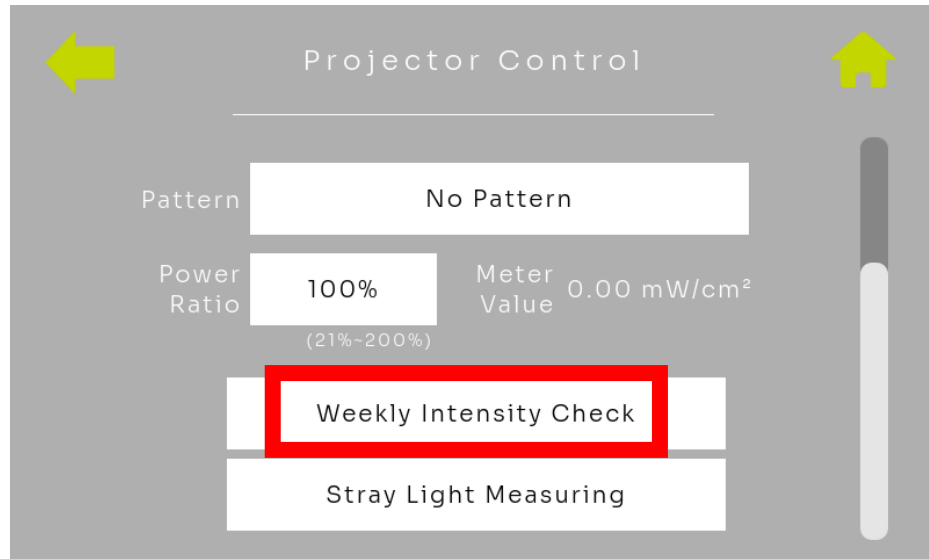




Please check:

- Tank and picker have been removed.
- Sensor mask has been inserted.
- UV sensor is positioned in the center.
- Press "Yes."

5.1 Analysis - Weekly Intensity Test.

The test is now running for 30 seconds. Please gently press the sensor against the glass pane during the runtime, avoiding any slipping. After the test is complete, a pop-up message will indicate whether the test has passed.

If the test has passed, you may proceed with printing.

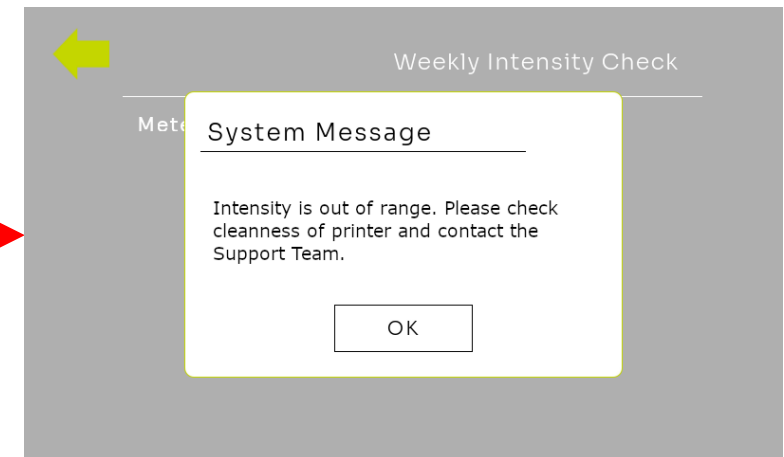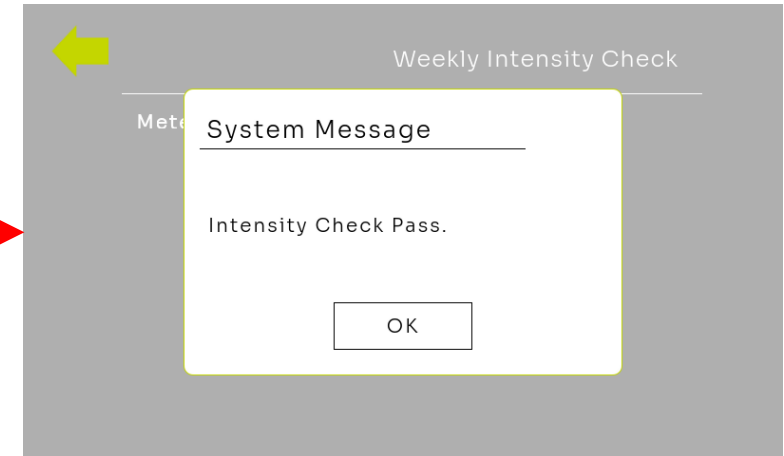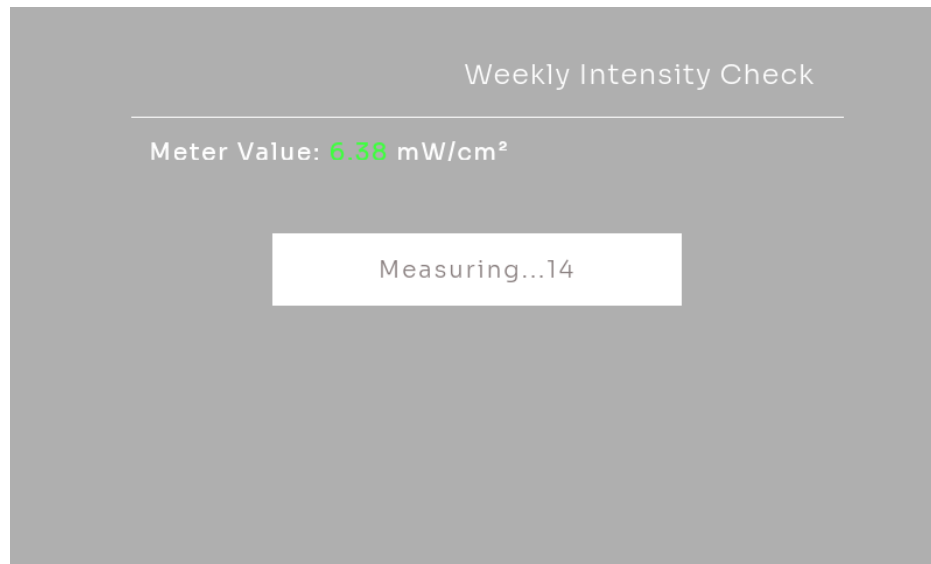


If the test did not pass, please first check the sensor connection, correct positioning, and the cleanliness of the setup. Then, repeat the test. If the test still does not pass, perform a stray light measurement (see section 5.2 and 6).

5.2 Stray light measurement

If the weekly intensity test has failed or there are component or printing errors, perform the stray light measurement.

Procedure:

- Refer to step 3.
- Position the UV sensor at the first position, front left.

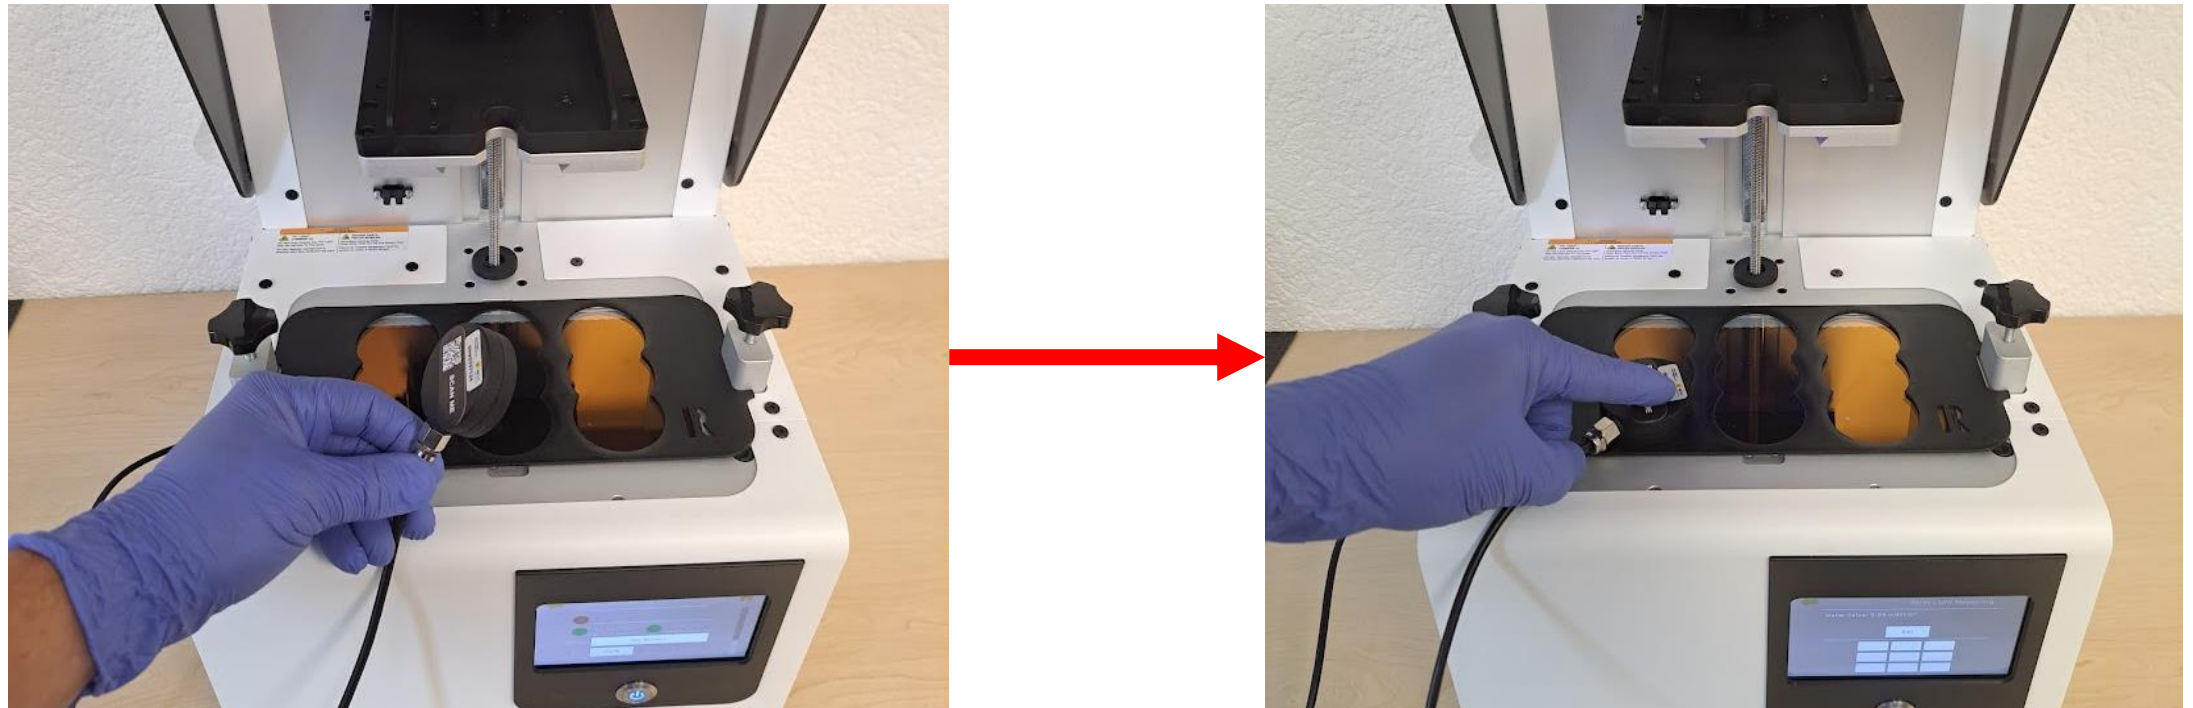


5.2 Stray light measurement

Navigate to the projector menu (see point 5.)

Procedure:

- Select 'Stray Light Measuring.'
- Confirm all points in the system message.


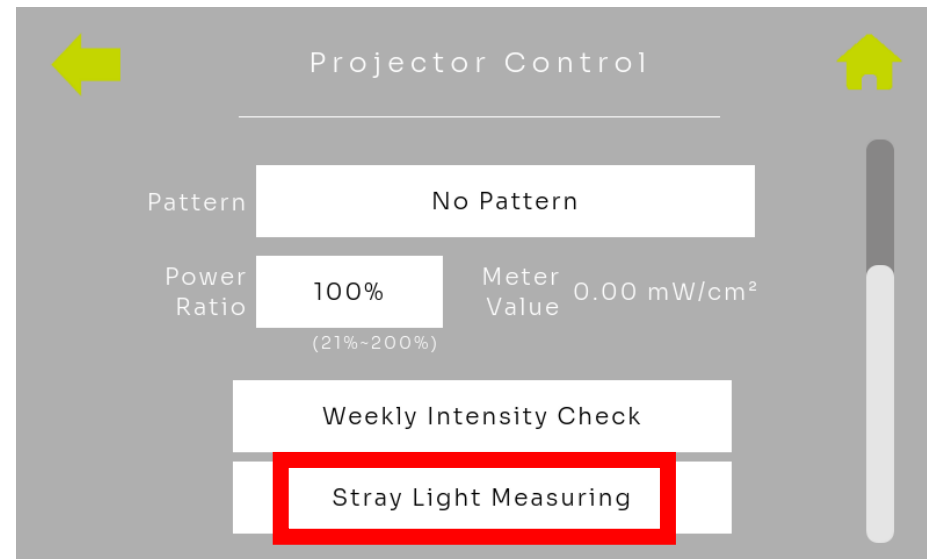


5.2 Stray light measurement

The projector is now displaying a dark area in the first field.

Procedure:

- Wait for approximately 10 seconds.
- Click on 'Set'.

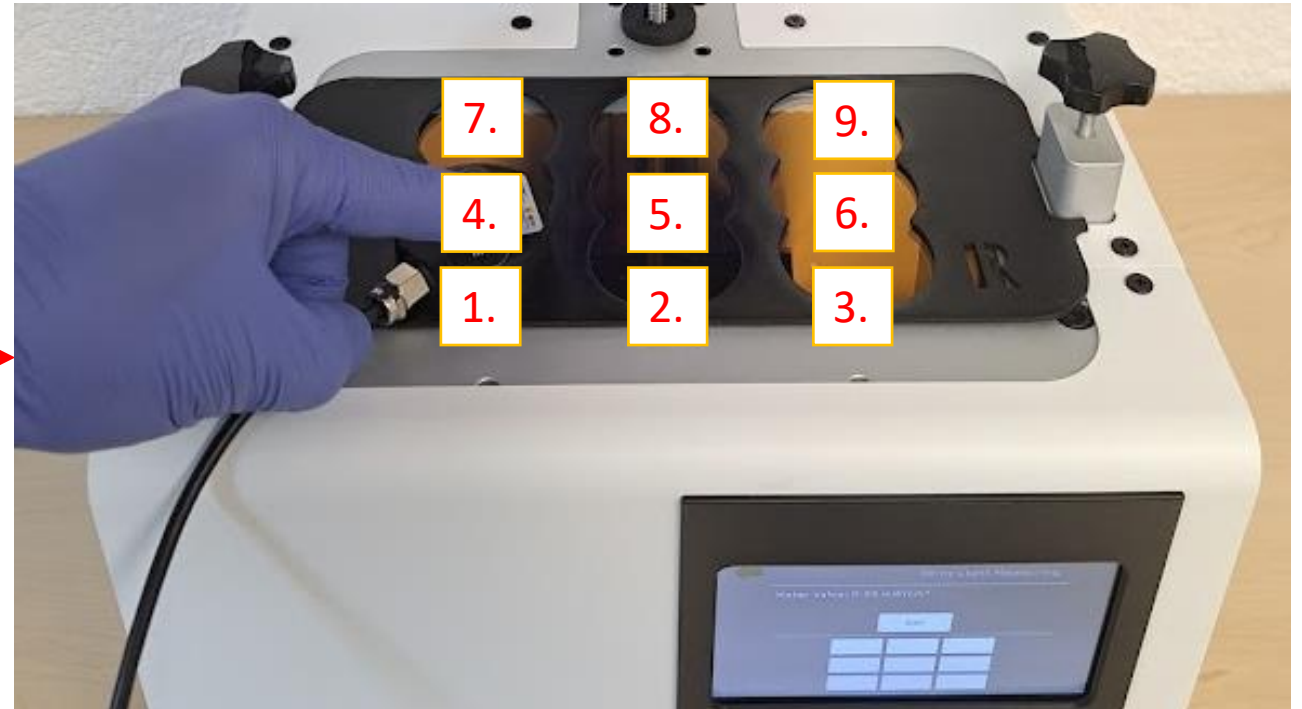
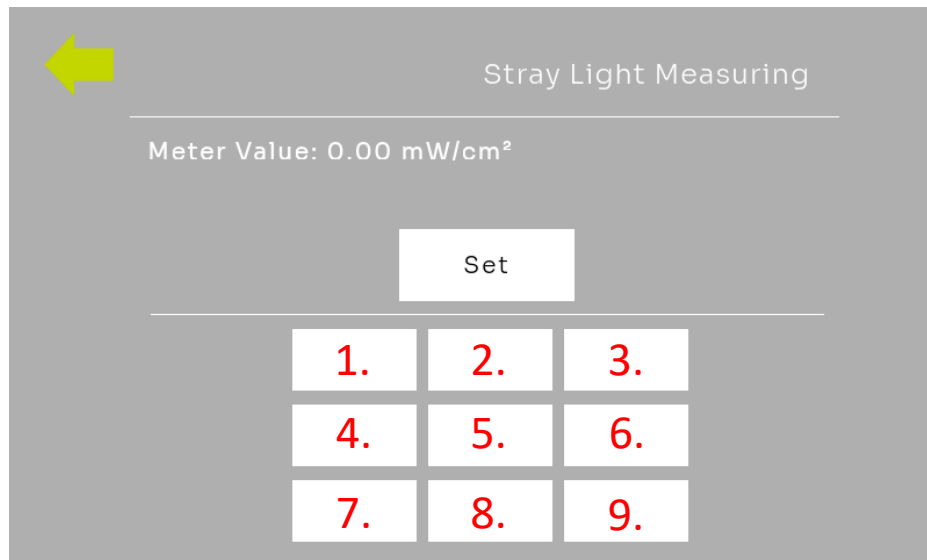


5.2 Stray light measurement

The projector is now displaying a dark area in the second field.

Procedure:

- Change the sensor to field 2 and wait for approximately 10 seconds.
- Click 'Set' again.

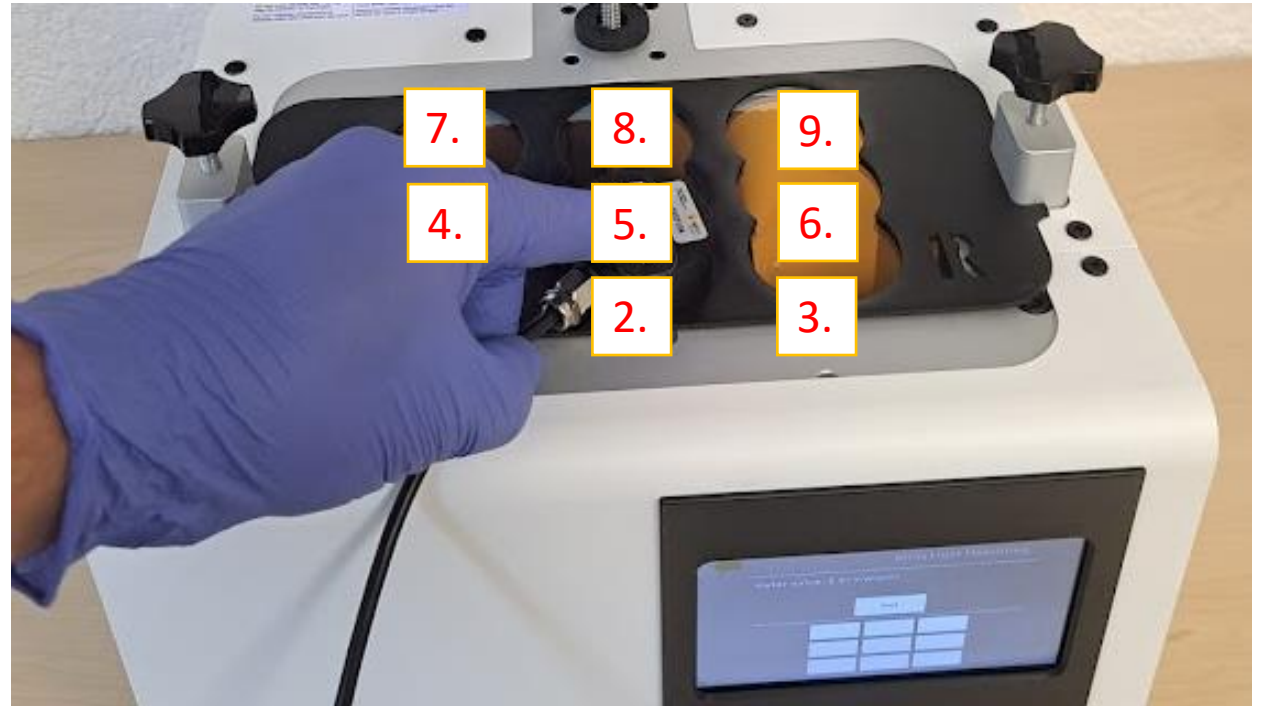
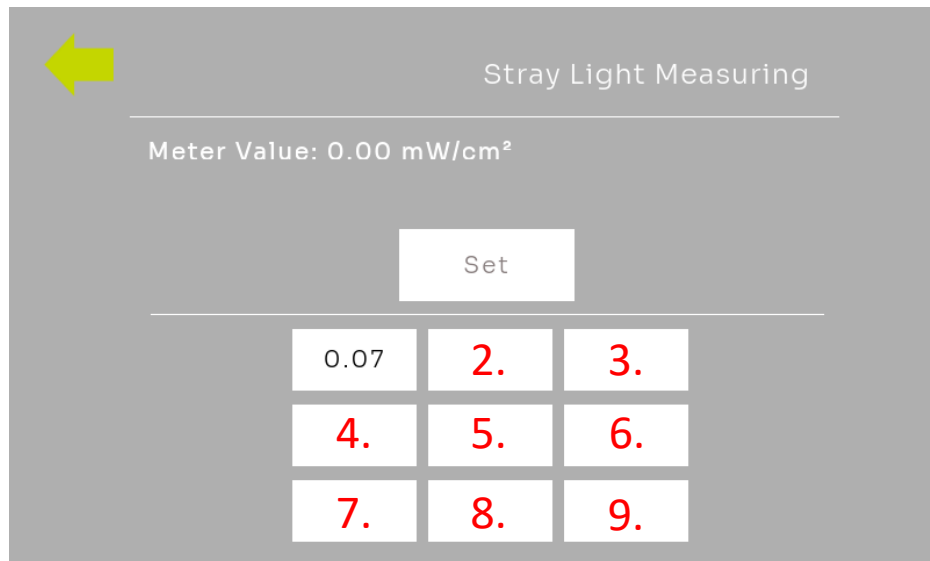


5.2 Stray light measurement

The projector is gradually displaying a dark area in all fields.

Procedure:

- Measure all 9 fields in order until the stray light measurement is complete.
- Confirm point 9 with 'Set'.

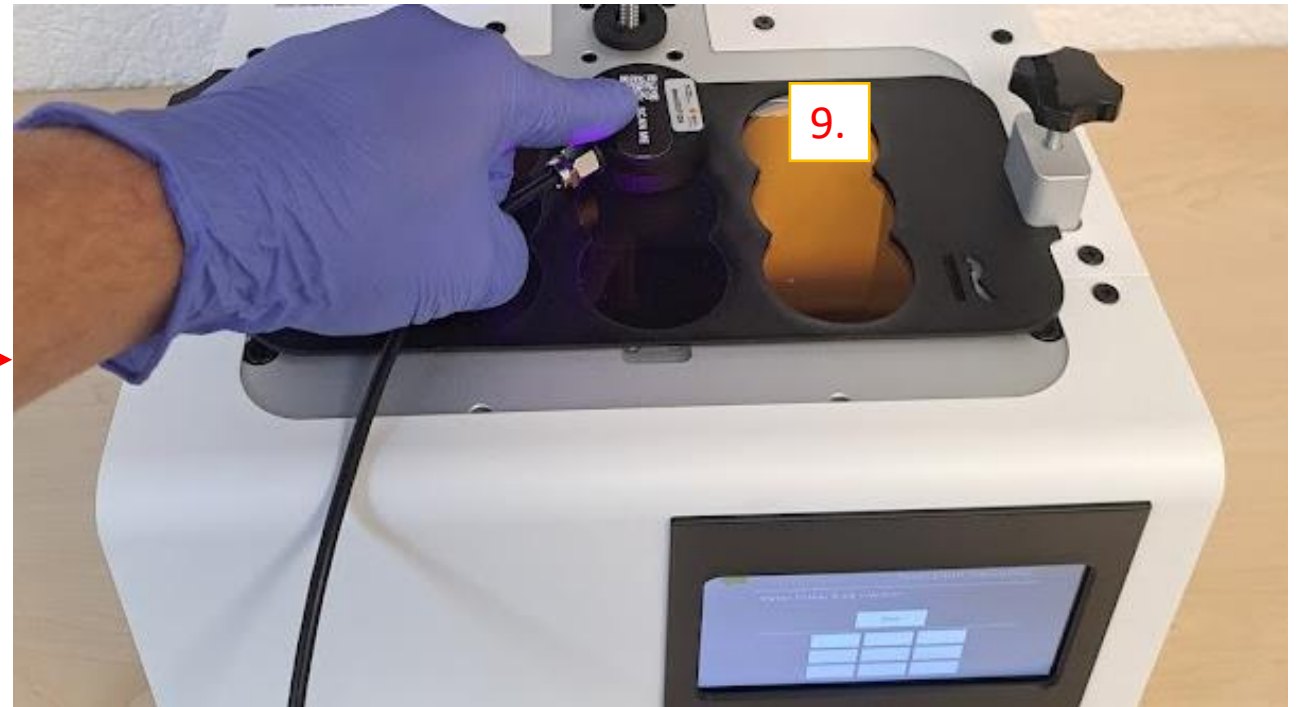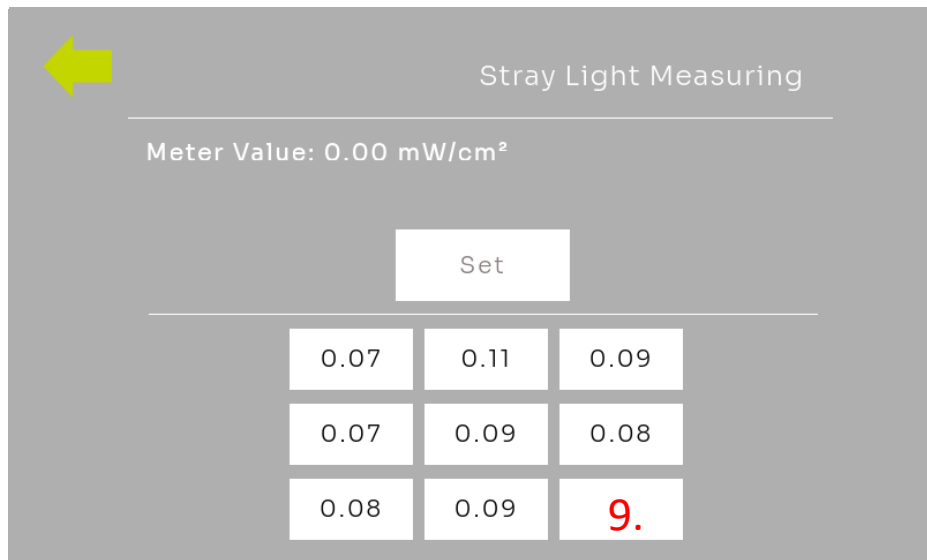

5.2 Analysis - Stray Light Measurement.

- Ideally, the fields in the stray light measurement should achieve values of: $I \leq 0,1mW/cm^2$
- If the value is higher, please check the cleanliness of the setup
- Minor scratches or roughness can also result in elevated stray light values
- For $I \geq 0,15mW/cm^2$, please contact your DentaMile support team

Please close the window after completing the stray light measurement to deactivate the projector.

If you wish to retest a field, click on the desired field and place the sensor again.



Stray Light Measuring

Meter Value: 0.00 mW/cm²

Set

0.07	0.11	0.09
0.07	0.09	0.08
0.08	0.09	0.08

6. Analysis diagram

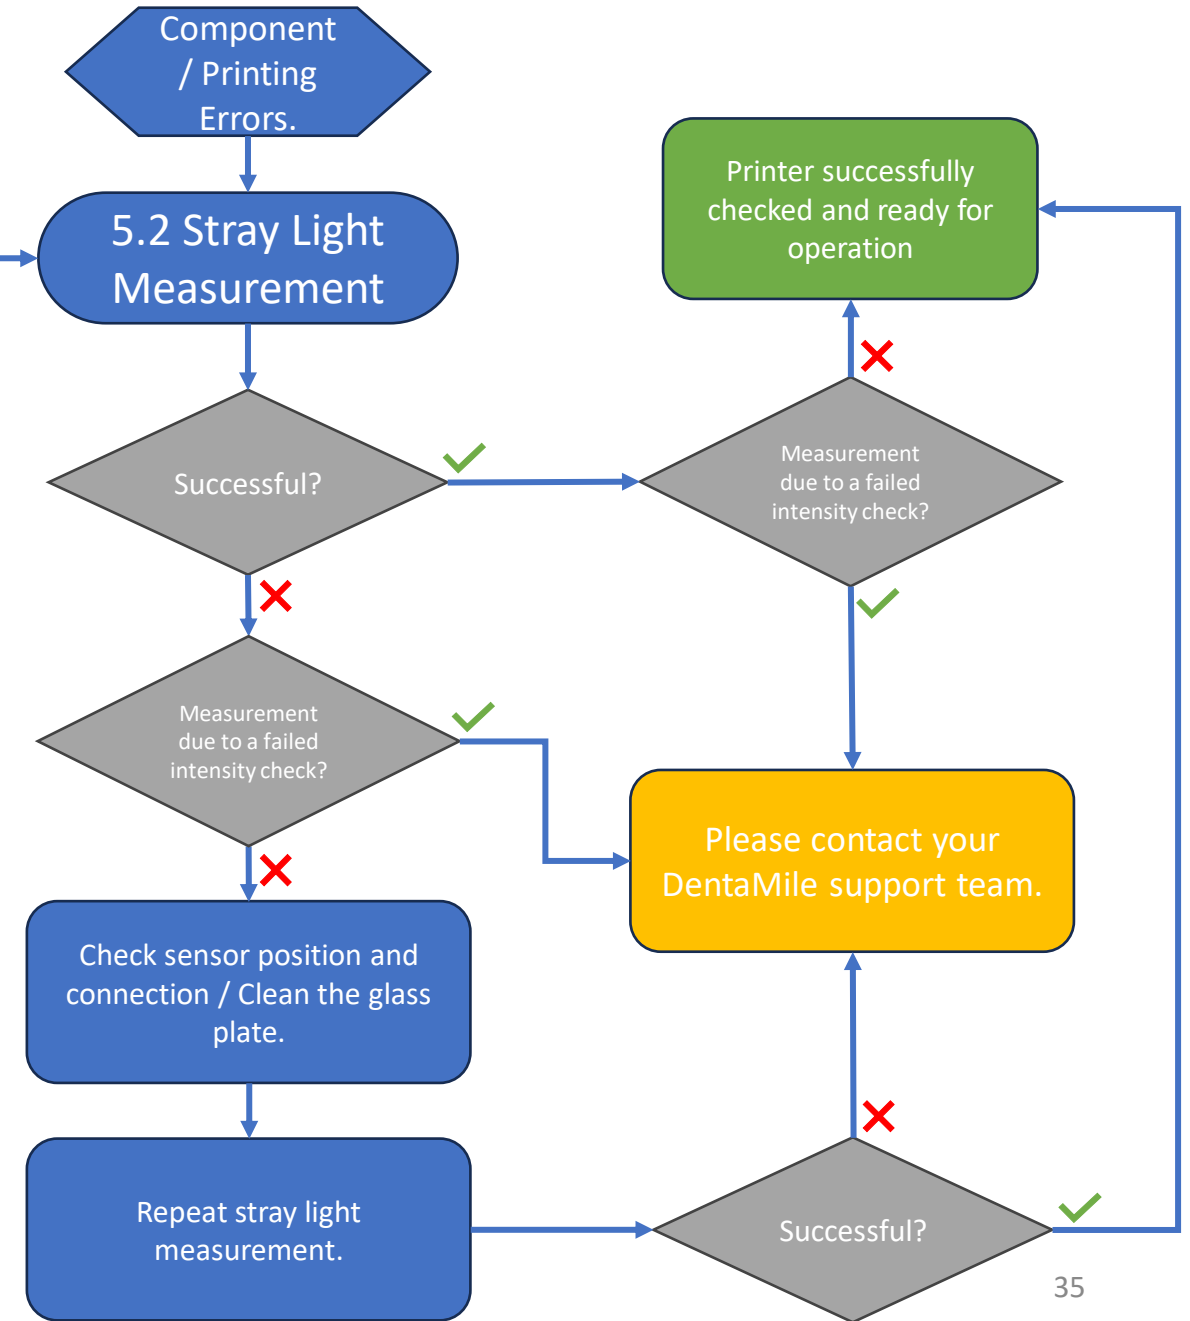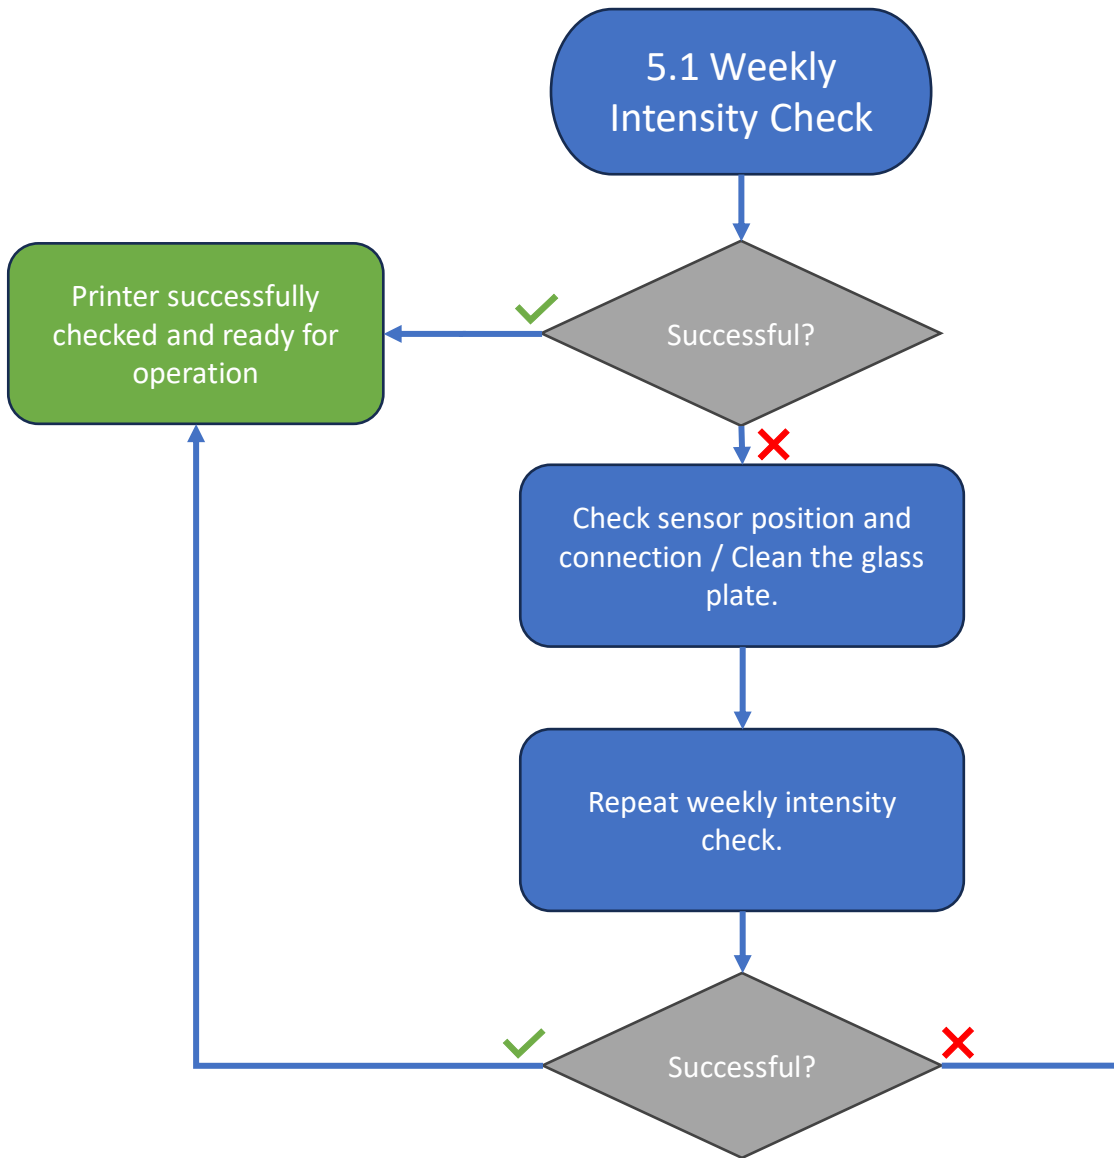

7. UV sensor recalibration

The following information is crucial for your validated workflow!

- Your UV sensor must be recalibrated once a year to ensure that it provides reliable measurements.
- Please send your sensor to our partner, BURMS, for recalibration.
- To do so, place your sensor in a padded envelope and send it to:

BURMS 3D Druck GmbH and Co.KG.

Hermann-Löns-Str. 2

07745 Jena

Germany

- If you have an optional maintenance contract, the recalibration is included in your annual maintenance fees. Please make sure to send the sensor for recalibration approximately 4 weeks before your annual maintenance, as a recalibrated sensor is required for the maintenance.
- If you do not have a maintenance contract, the recalibration will be invoiced at €299.

8. Procedure with Maintenance Contract

The maintenance procedure:

1. Please schedule an appointment with BURMS, specifying the serial number.
 - You can schedule an appointment at: <https://calendly.com/burms3d/online-termin>
2. You will receive a possible appointment date or can choose a suitable one.
 - The recalibration requires your presence, so please allocate approximately 2 hours for the appointment.
3. For the appointment, a BURMS employee will provide you with a MS TEAMS link.
 - You can use TEAMS via a web browser or the TEAMS application.
4. Before the appointment, please perform the following tasks:
 - Remove the build platform.
 - Remove the resin tank.
 - Thoroughly clean the glass plate (using isopropanol or glass cleaner).
 - Turn on the equipment.
 - Ensure you have an internet connection.
5. Please have the following supplied accessories ready:
 - Calibration mask
 - UV sensor

Your contact at BURMS will explain all further steps to you.

Please note that the appointment can only be conducted in German or English.

Polski



Instrukcje dotyczące tygodniowego pomiaru intensywności i pomiaru światła rozproszonego

Ogólne wskazówki/informacje.


- Proszę zawsze stosować odpowiednie środki ochrony osobistej:
 - Ochronne okulary przeciwsłoneczne UV
 - Rękawice
 - Unikaj światła słonecznego lub innych źródeł światła, które mogą wpłynąć na wyniki.
- Zachowaj czystość czujnika i unikaj dotykania jego **powierzchni**.
- Wyniki mogą dostarczyć następujące wskazówki:
 - Czystość szyby
 - Zużycie szyby
 - Degeneracja projektora
- W przypadku wątpliwości, proszę skontaktować się z zespołem wsparcia DentaMile.




1. Usuń zbiornik, platformę budowlaną i uruchom drukarkę.

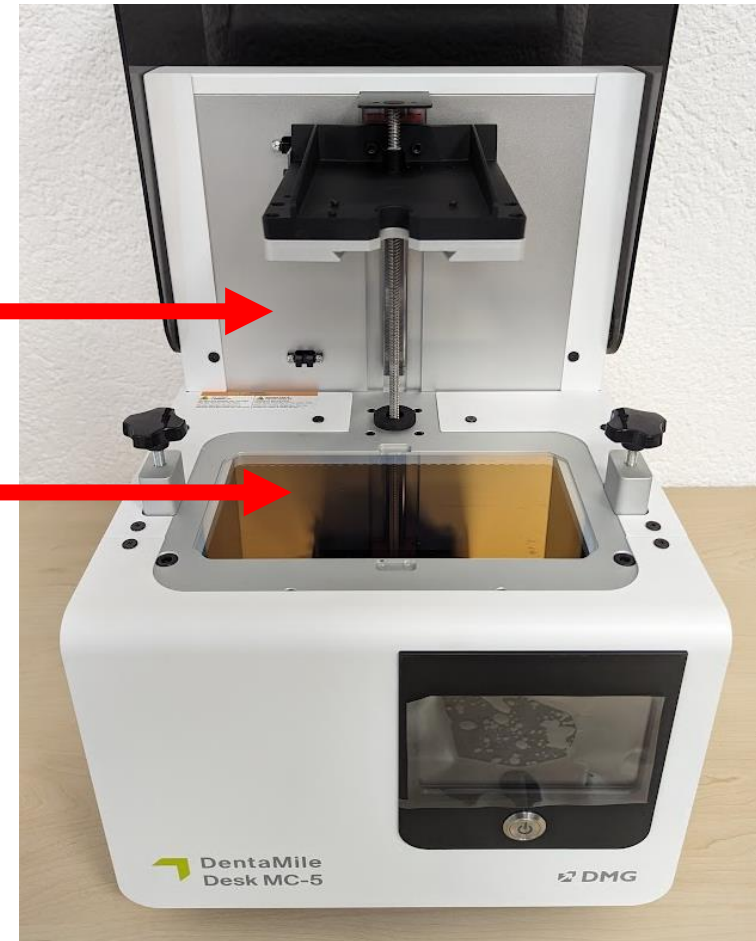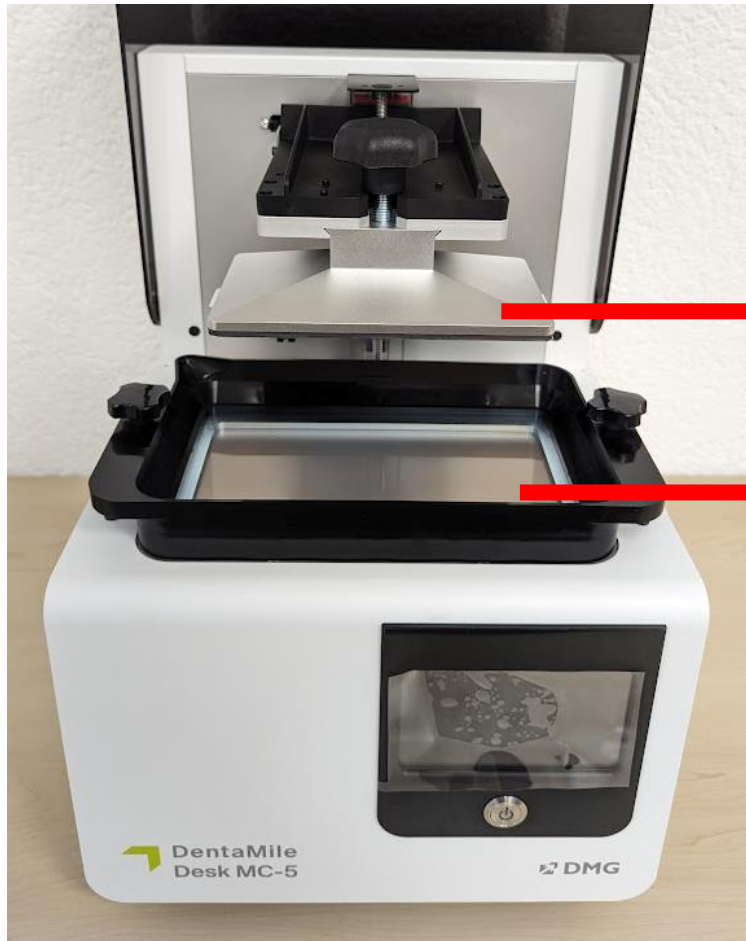


2. Włóż maskę sensora

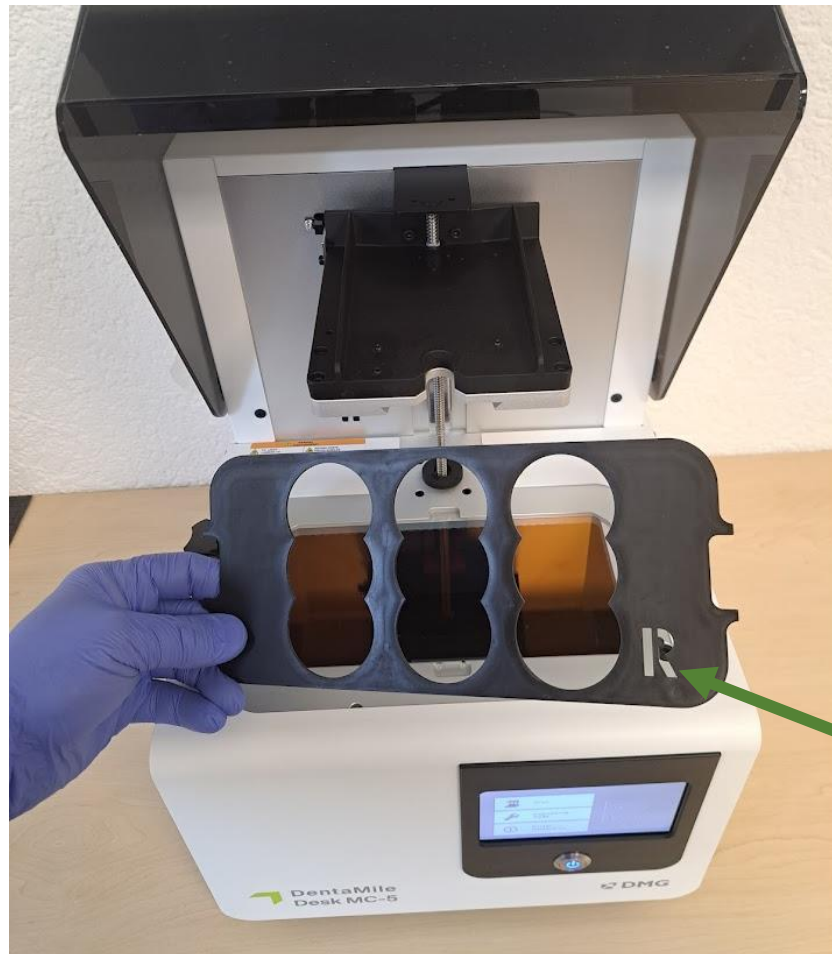



prawo

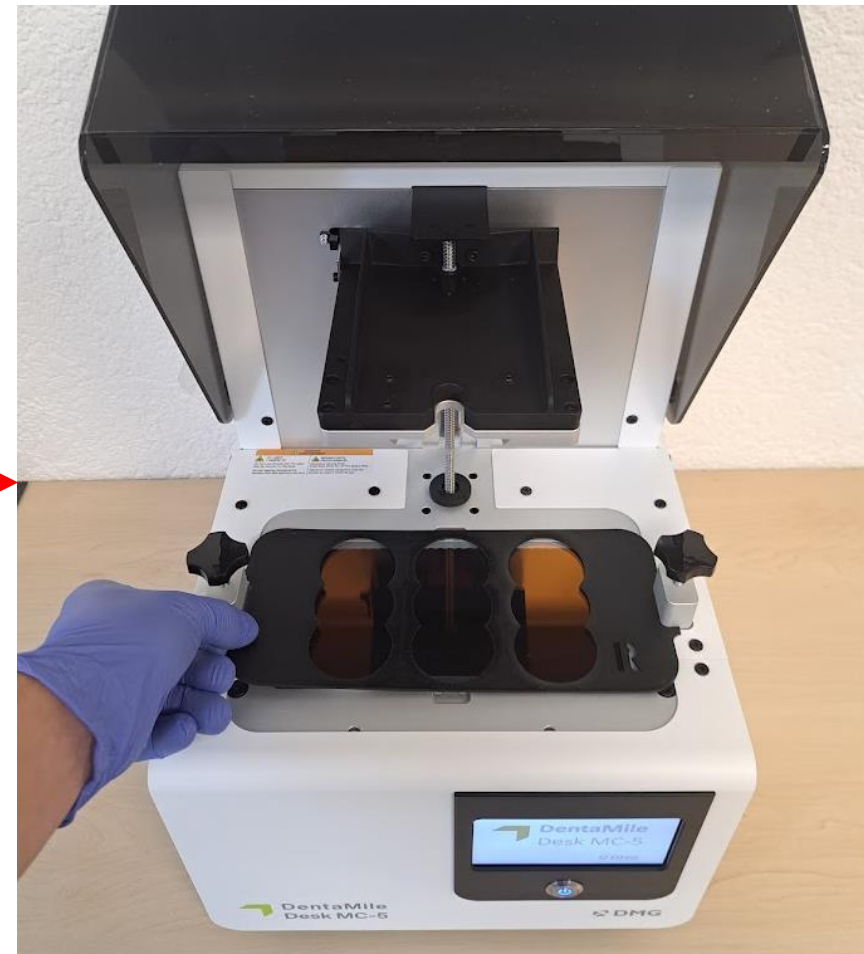


3. Podłącz czujnik UV

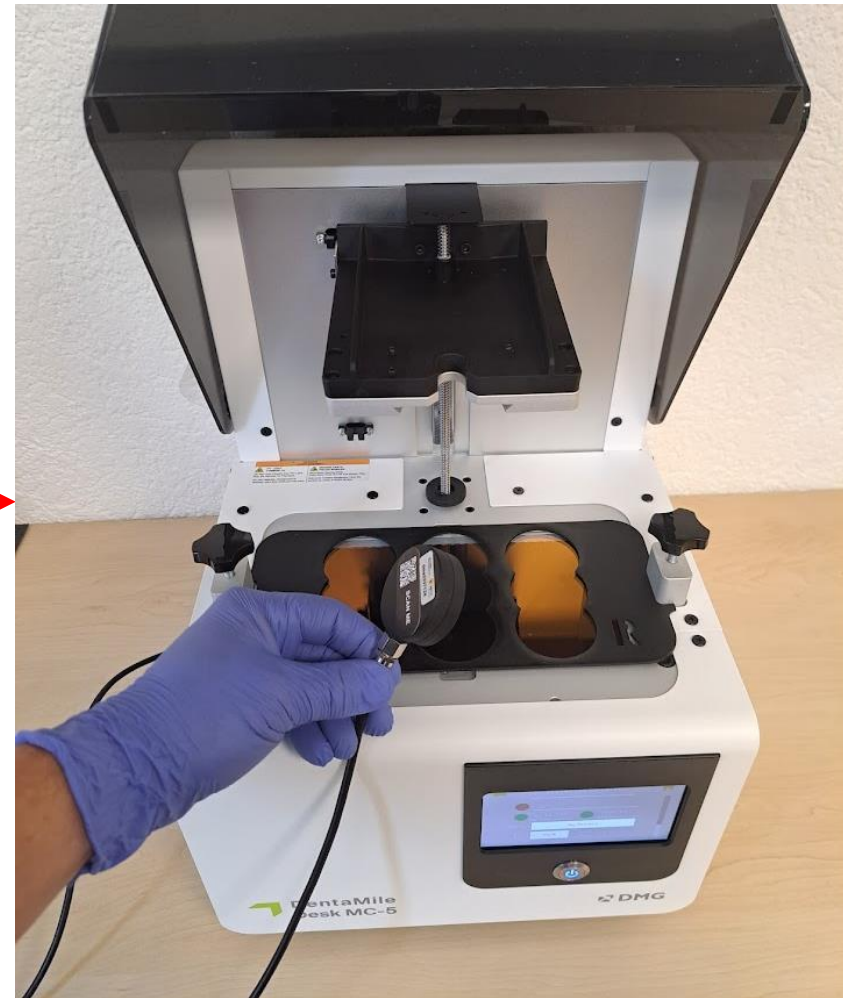




4. Umieść czujnik centralnie.

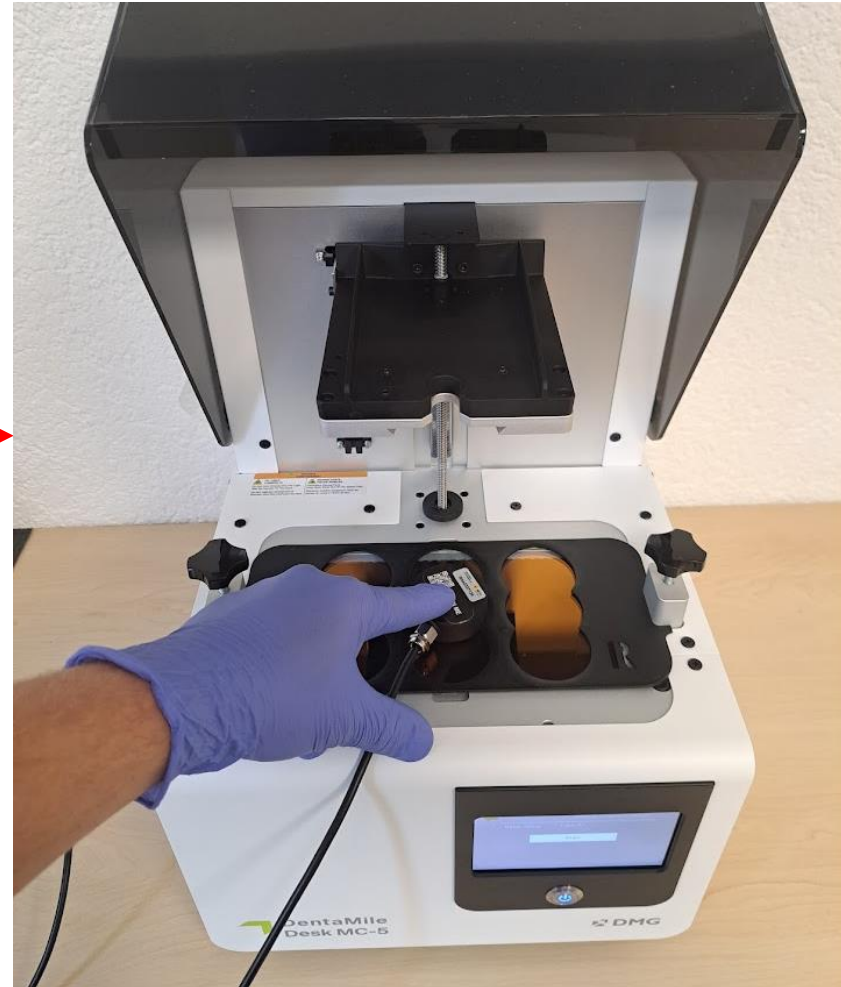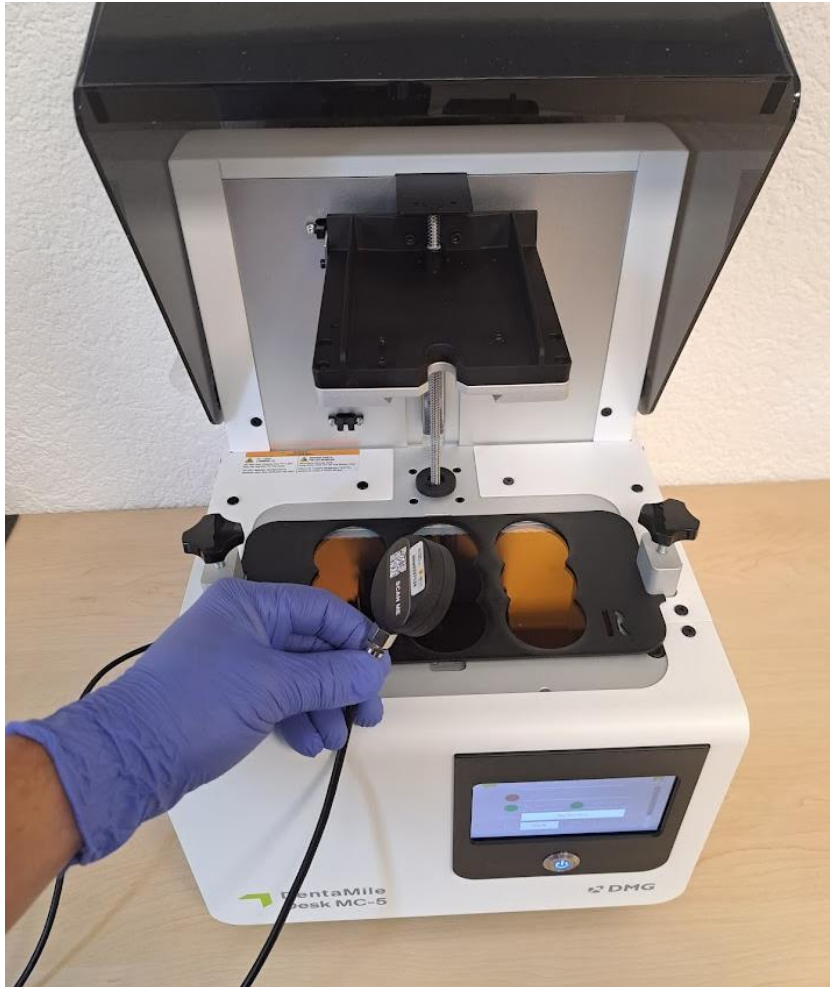

5. Przejdź do menu projektora

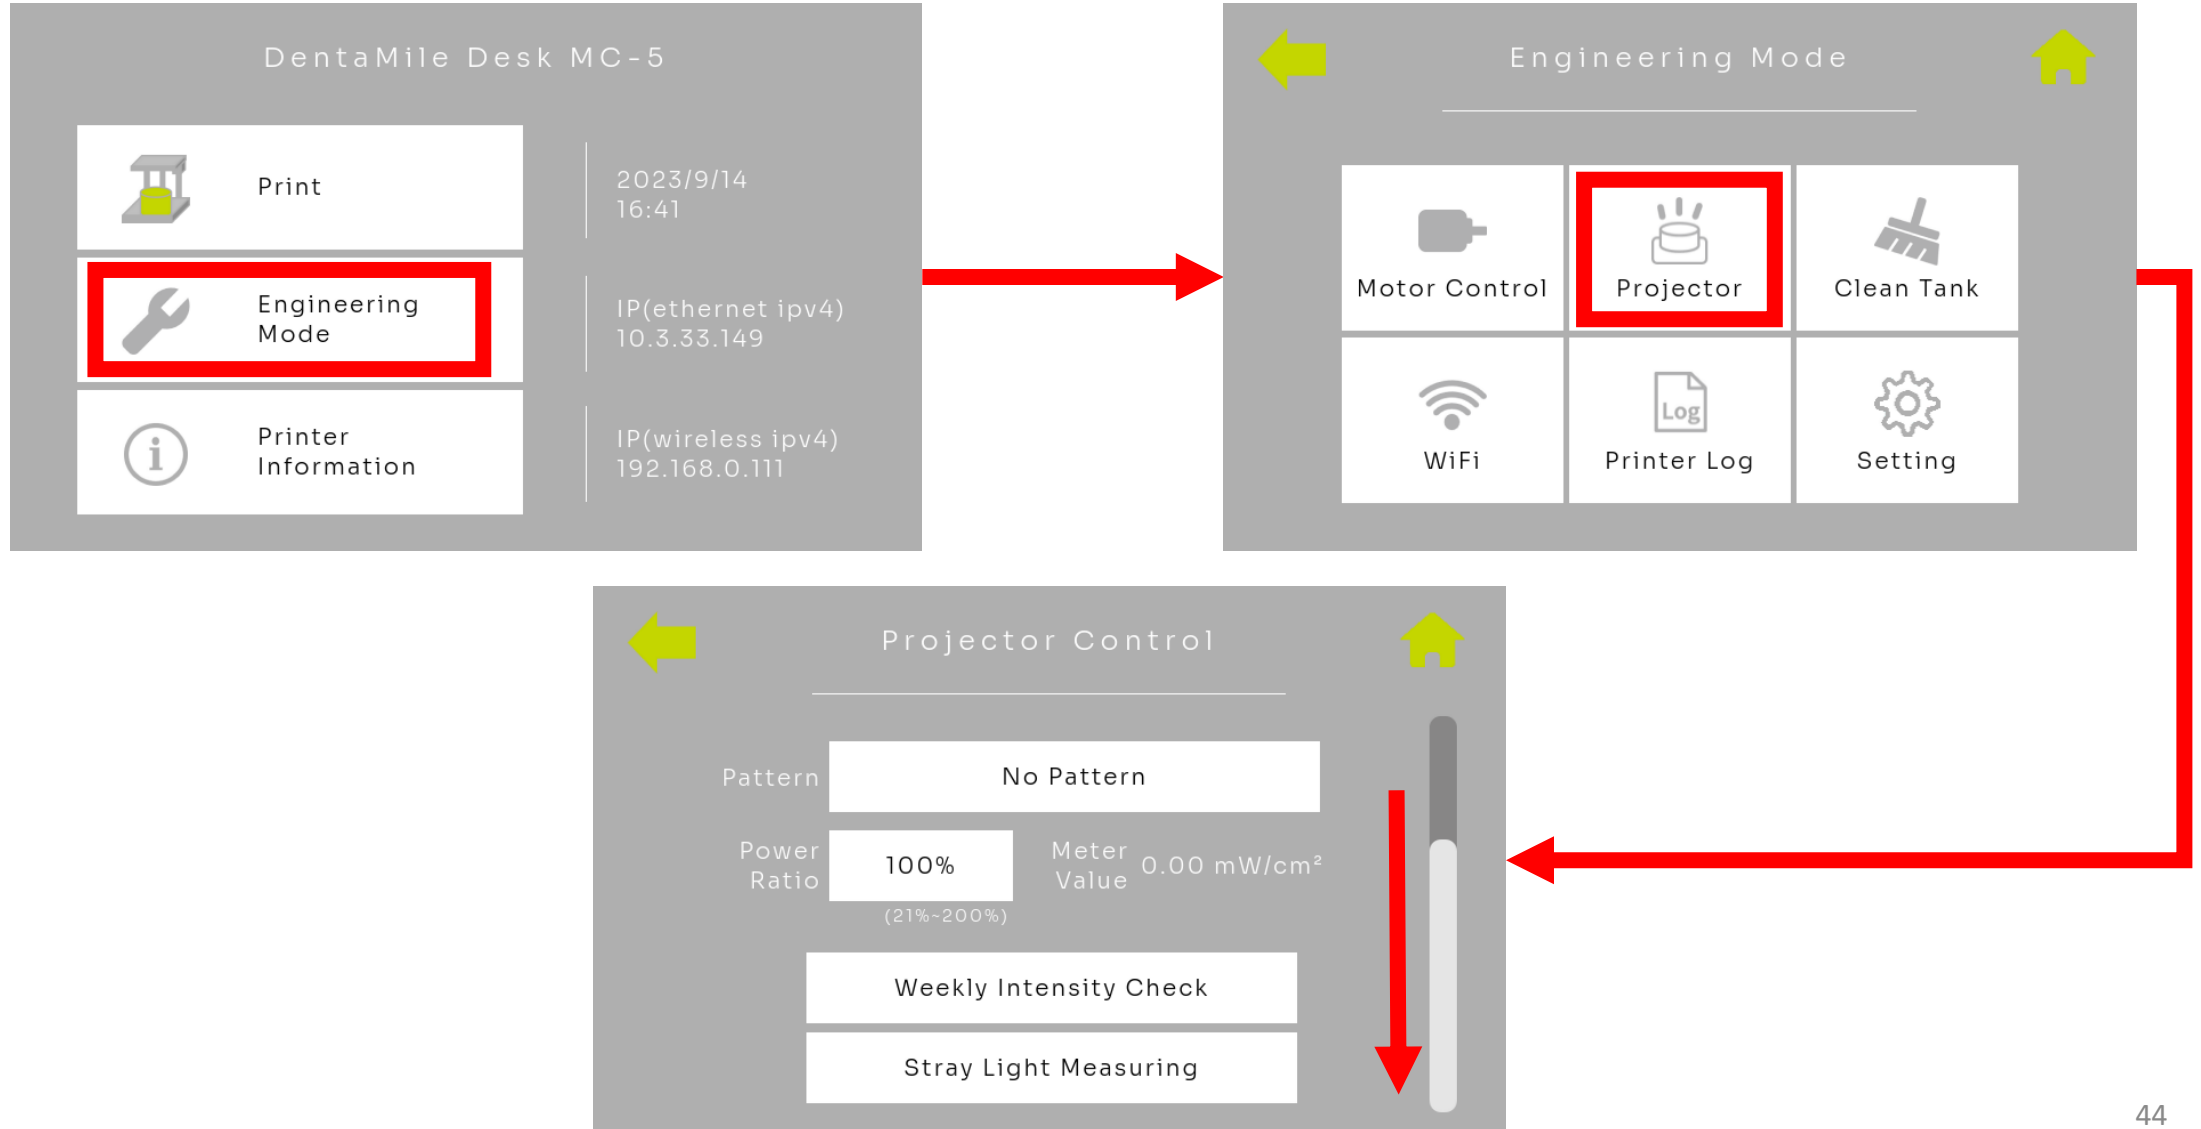

5.1 Tygodniowy test intensywności.

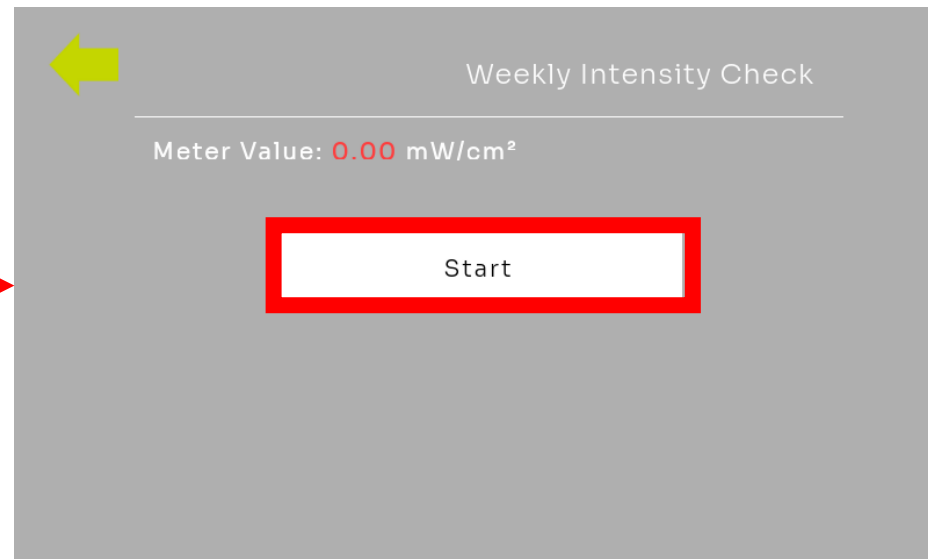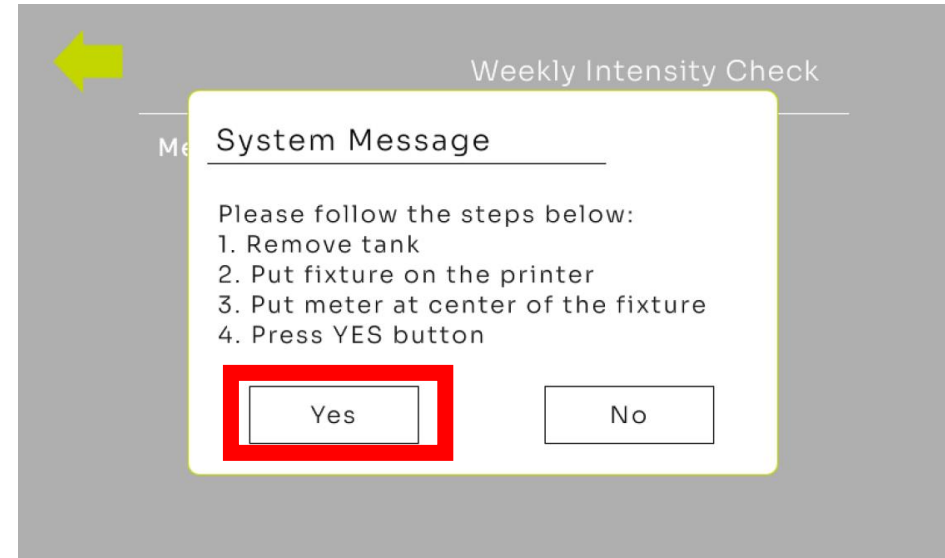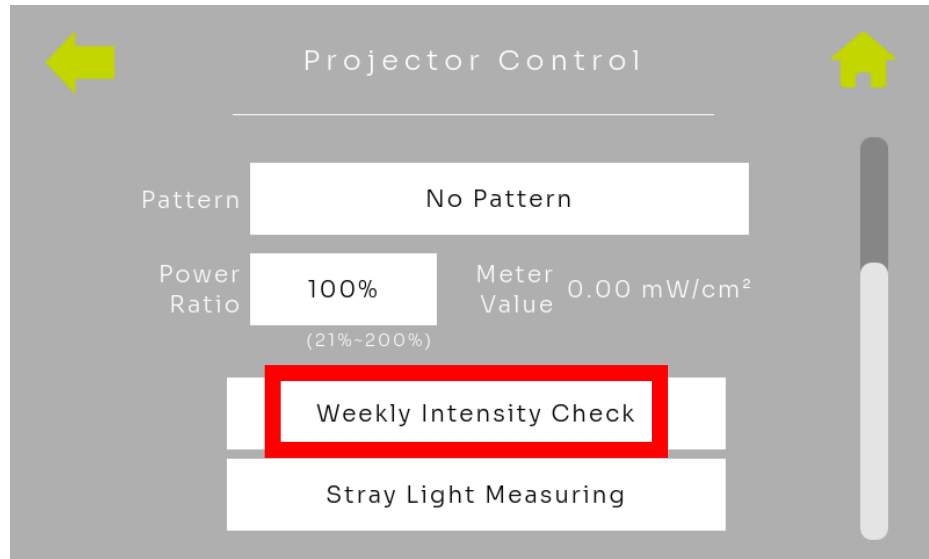



Proszę sprawdzić:

- Zbiornik i zbieracz zostali usunięci.
- Maskę czujnika została włożona.
- Czujnik UV jest umieszczony na środku.
- Naciśnij "Tak".

5.1 Analiza - tygodniowy test intensywności

Test trwa teraz przez 30 sekund. Proszę delikatnie nacisnąć czujnik na szybie i unikać przesuwania go podczas trwania testu. Po zakończeniu testu wyświetli się komunikat typu pop-up, informujący, czy test został zaliczony.

Jeśli test został zaliczony, możesz kontynuować drukowanie.

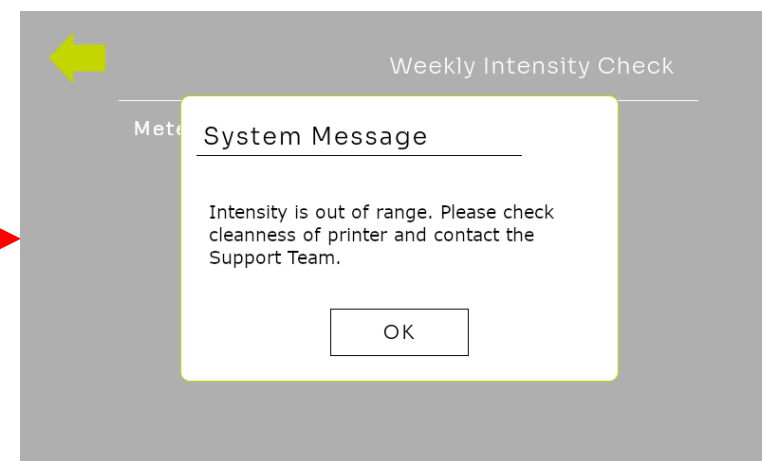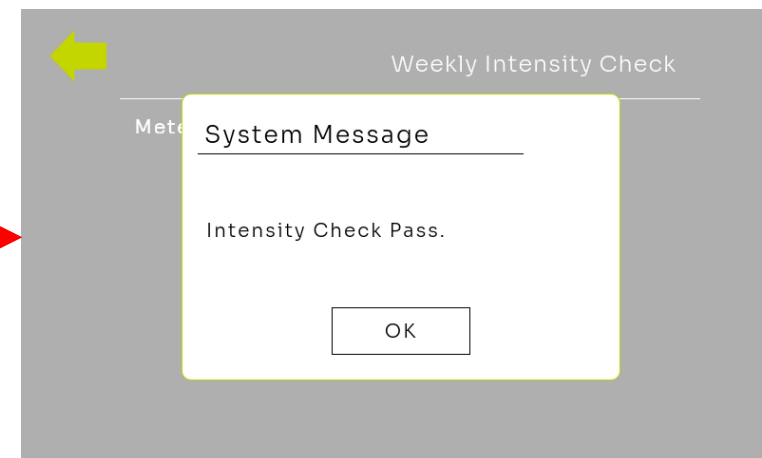



W przypadku niezaliczenia testu, proszę najpierw sprawdzić połączenie czujnika, jego prawidłową pozycję i czystość urządzenia. Następnie powtórz test. Jeśli test wciąż nie zostanie zaliczony, przeprowadź pomiar rozproszonego światła (patrz punkty 5.2 i 6).

5.2 Pomiar rozproszonego światła

Jeśli test intensywności na tydzień nie powiódł się lub wystąpiły błędy komponentów lub drukowania, przeprowadź pomiar rozproszonego światła.

Procedura:

- Patrz punkt 3
- Umieść czujnik UV na pierwszej pozycji z przodu po lewej stronie

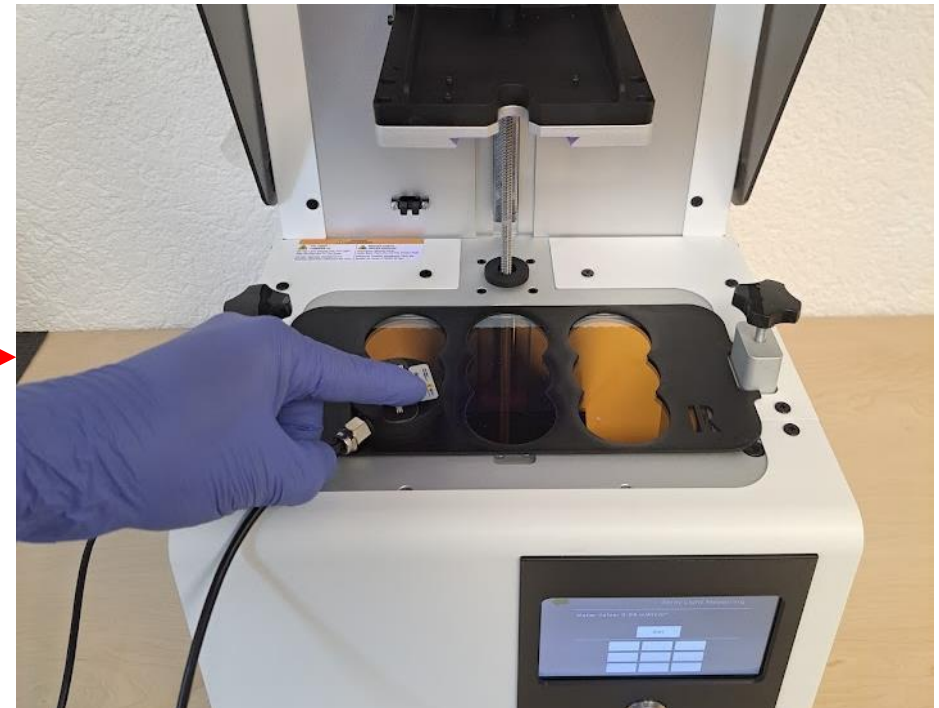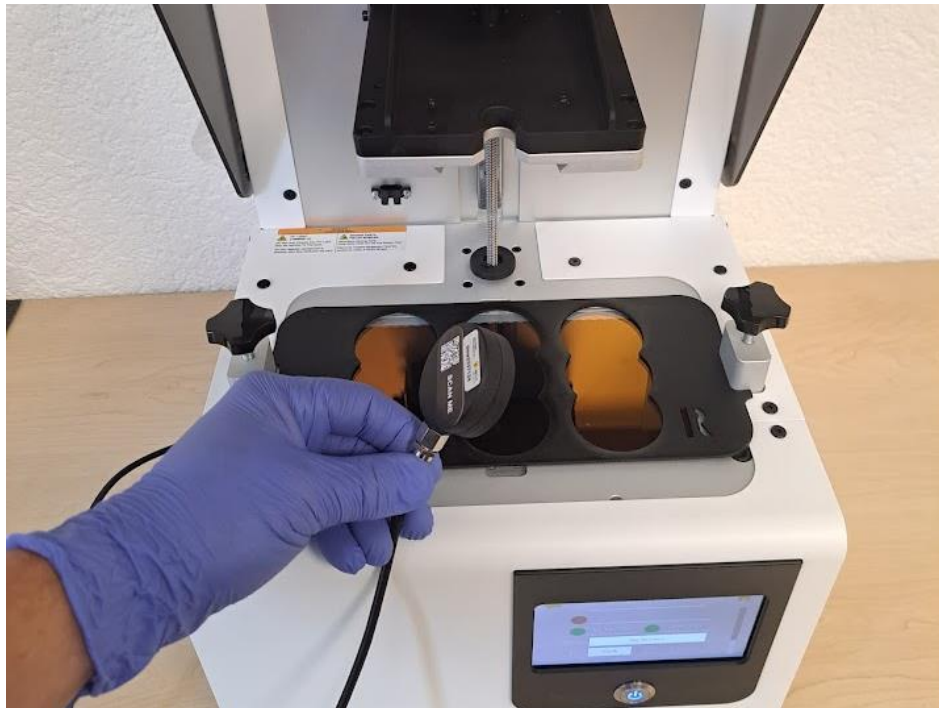


5.2 Pomiar rozproszonego światła

Przejdź do menu projektora (patrz punkt 5.)

Procedura:

- Wybierz opcję 'Pomiar rozproszonego światła'


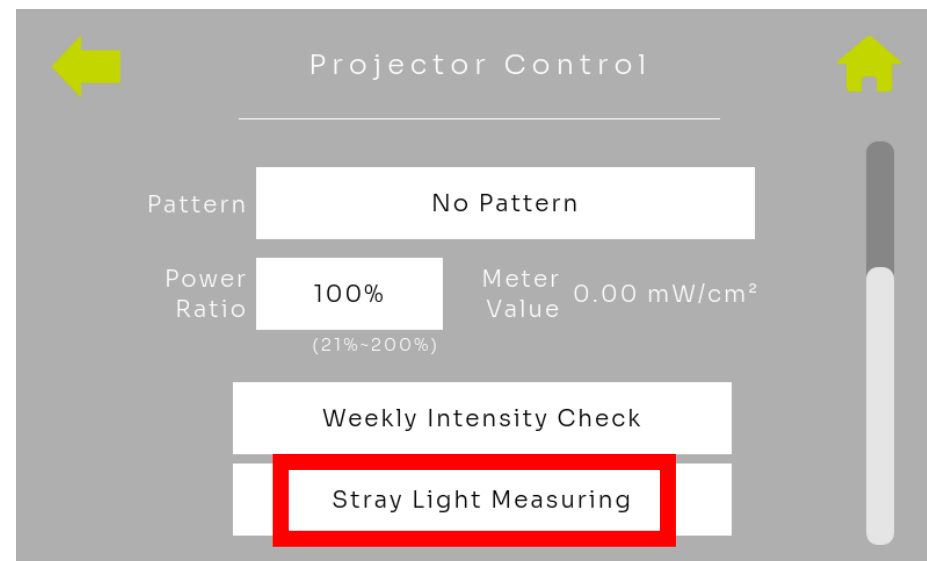


5.2 Pomiar rozproszonego światła

Projektor obecnie wyświetla ciemny obszar w pierwszym polu.

Procedura:

- Poczekaj około 10 sekund
- Kliknij 'Ustaw'

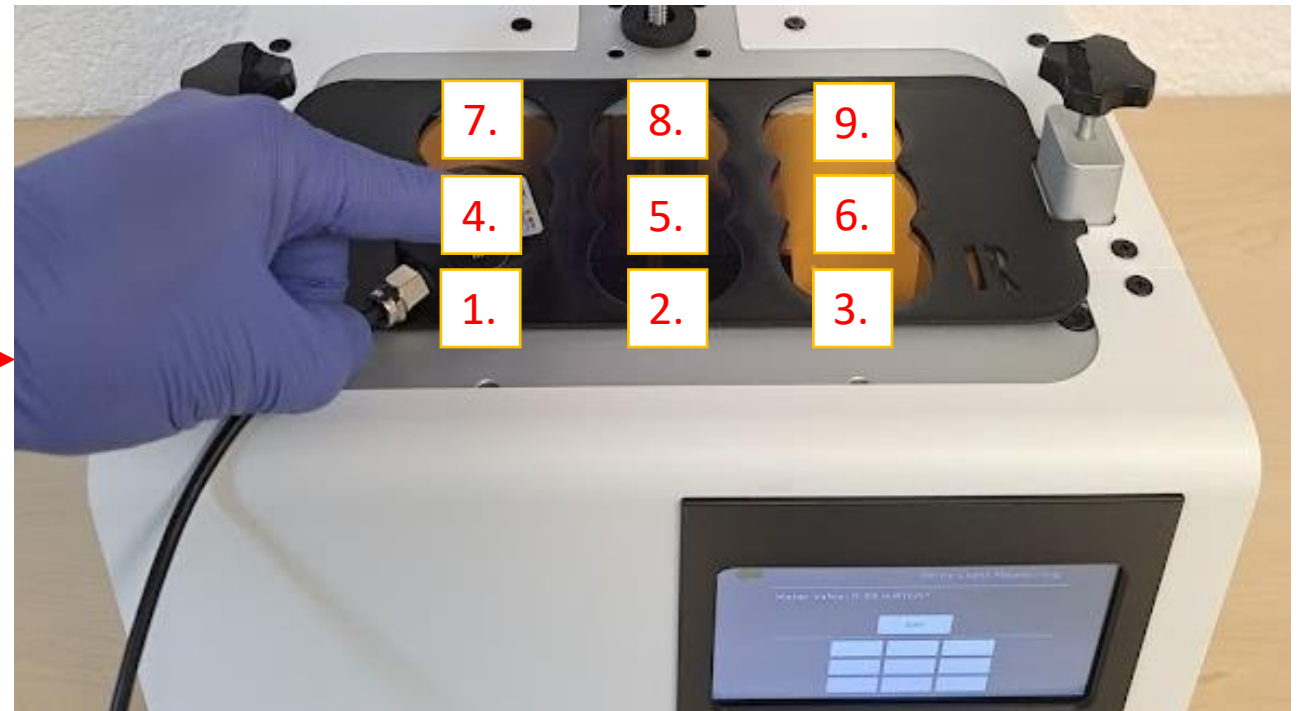
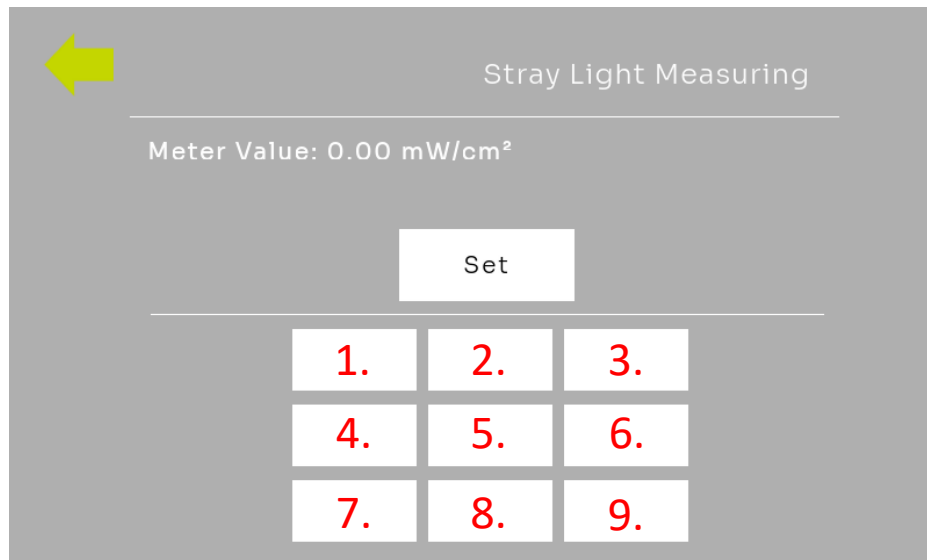


5.2 Pomiar rozproszonego światła

Projektor obecnie wyświetla ciemny obszar w drugim polu.

Procedura:

- Przenieś czujnik na pole 2 i poczekaj około 10 sekund
- Kliknij ponownie 'Ustaw'

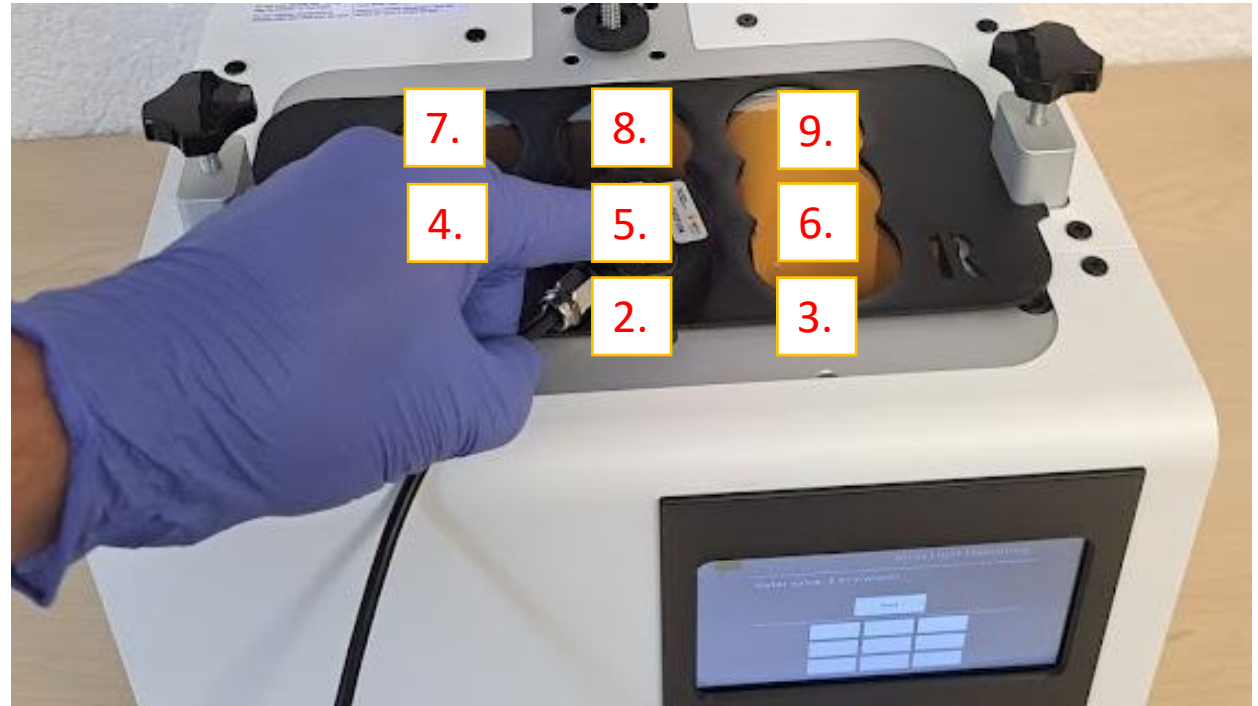
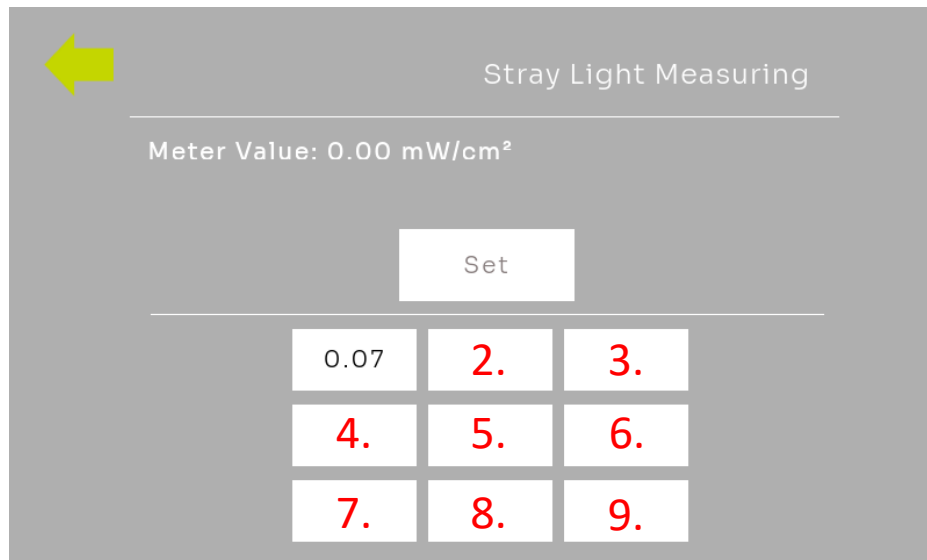


5.2 Pomiar rozproszonego światła

Projektor stopniowo wyświetla ciemne obszary we wszystkich polach.

Procedura:

- Pomiar przeprowadź kolejno na wszystkich 9 polach, aż pomiar rozproszonego światła będzie zakończony
- Potwierdź punkt 9, naciskając 'Ustaw'

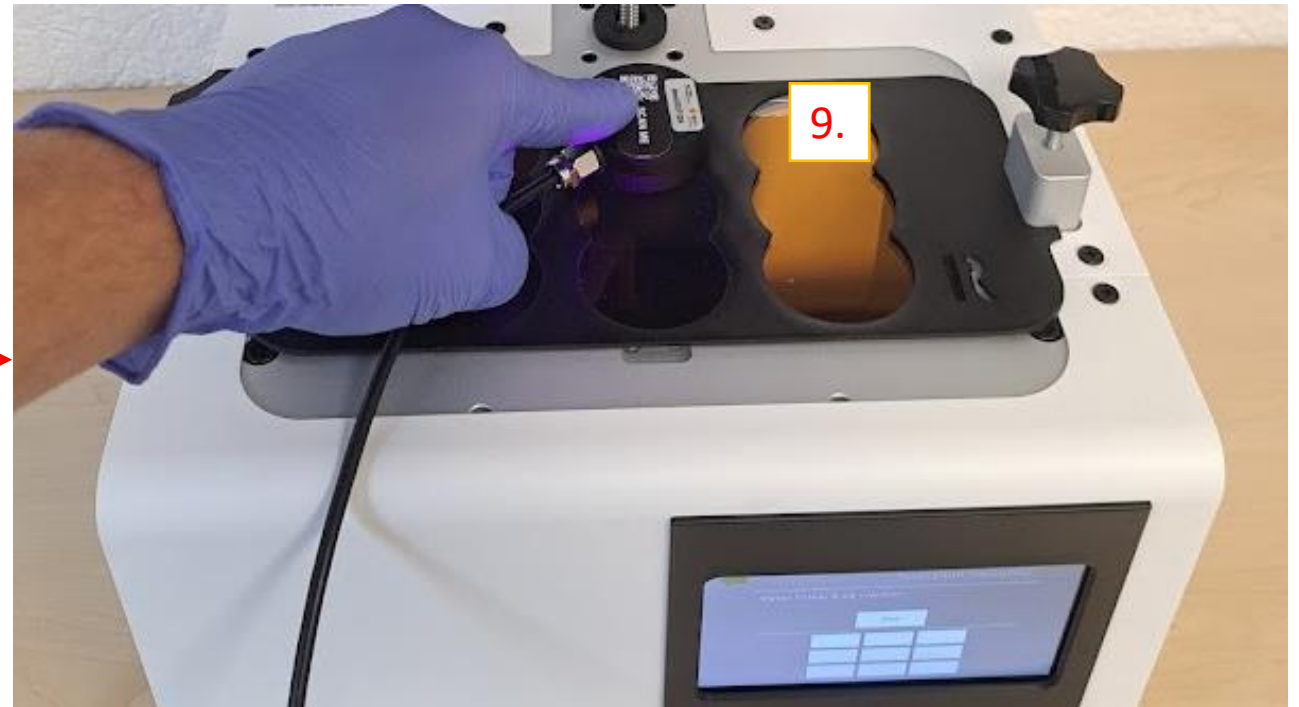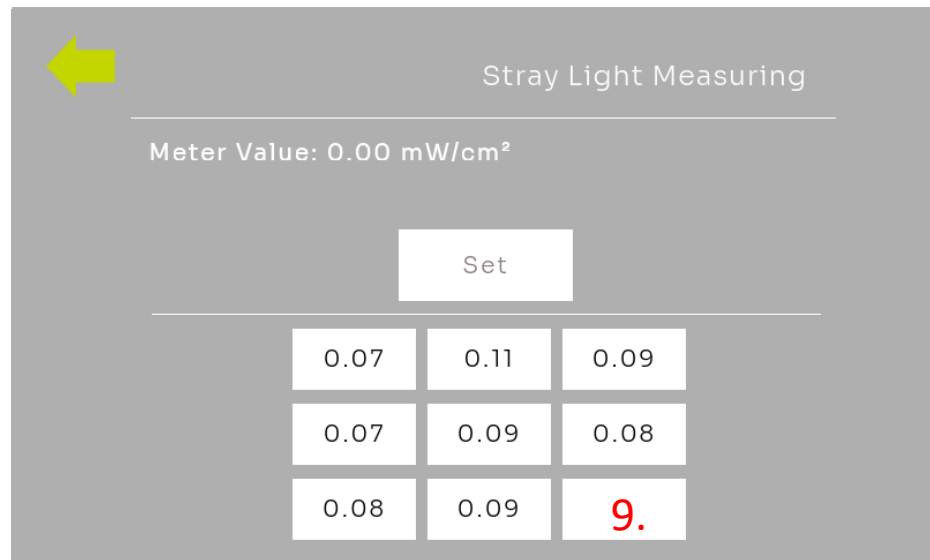

5.2 Auswertung - Streulichtmessung

- Optymalnie, wyniki pomiaru rozproszonego światła w polach powinny wynosić: $I \leq 0,1mW/cm^2$
- Jeśli wartość jest wyższa, proszę sprawdzić czystość urządzenia.
- Niewielkie rysy lub nierówności mogą również prowadzić do zwiększonych wartości rozproszonego światła
- Jeśli $I \geq 0,15mW/cm^2$, proszę skontaktować się z zespołem wsparcia DentaMile

Proszę zamknąć okno po zakończeniu pomiaru rozproszonego światła, aby wyłączyć projektor.

Jeśli chcesz ponownie przetestować pole, kliknij na żądane pole i umieść czujnik ponownie.



Stray Light Measuring

Meter Value: 0.00 mW/cm²

Set

0.07	0.11	0.09
0.07	0.09	0.08
0.08	0.09	0.08

6. Diagram oceny

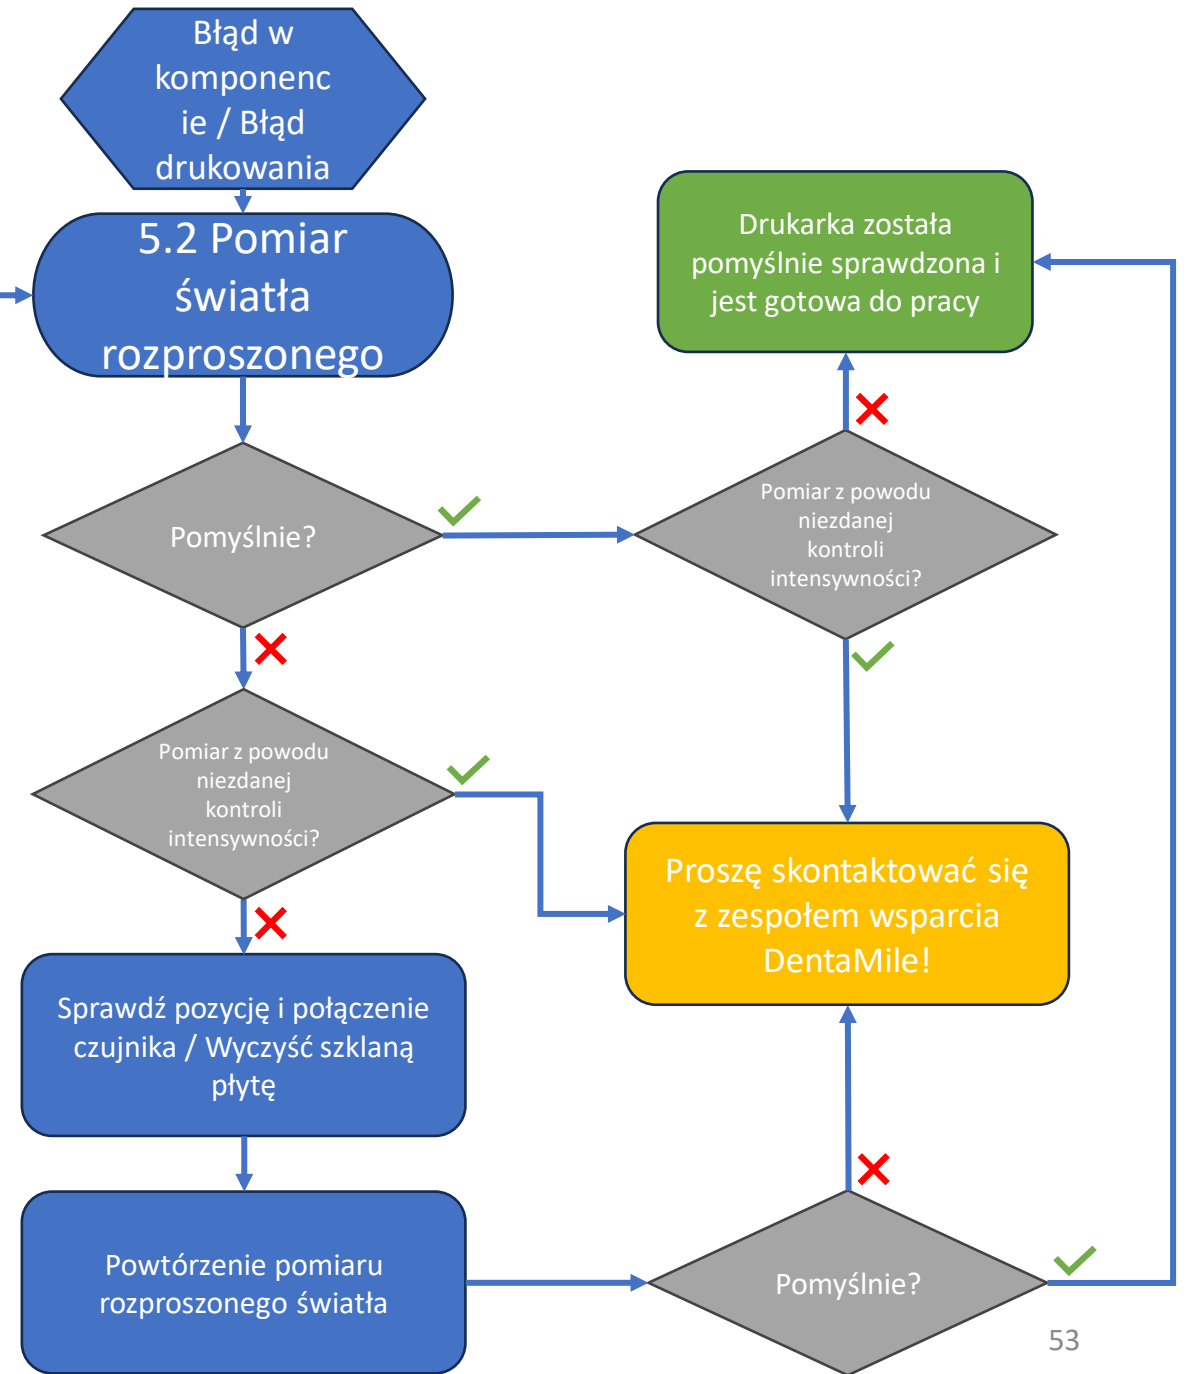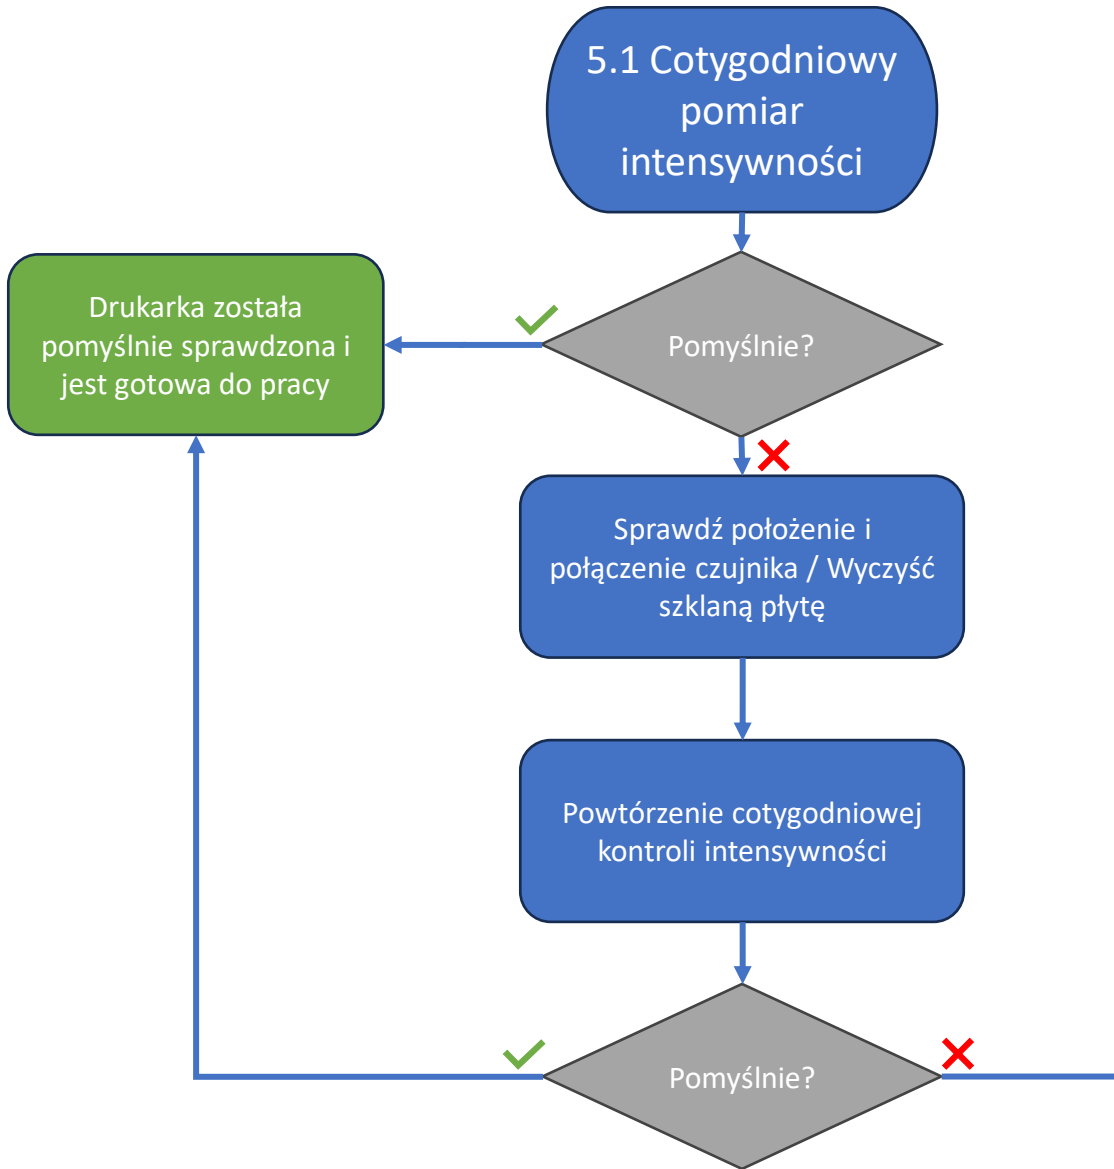

7. Rekalkibracja czujnika UV

Niższe informacje są istotne dla Państwa zwalidowanego procesu pracy!

- Państwa czujnik UV musi być rekalkibrowany raz w roku, aby zapewnić wiarygodne pomiary.
- Proszę odesłać swój czujnik do naszego partnera BURMS w celu rekalkibracji.
- Aby to zrobić, umieść swój czujnik w wyściełanej kopercie i wyślij go na adres:

BURMS 3D Druck GmbH und Co.KG.
Hermann-Löns-Str. 2
07745 Jena
Niemcy

- Jeśli mają Państwo opcjonalny kontrakt serwisowy, rekalkibracja jest wliczona w roczne opłaty serwisowe. Upewnijcie się, że wyślą Państwo czujnik na rekalkibrację około 4 tygodnie przed terminem corocznej konserwacji, ponieważ do konserwacji wymagany jest czujnik po rekalkibracji.
- Jeśli nie mają Państwo kontraktu serwisowego, rekalkibracja zostanie naliczona na fakturze w wysokości 299,- EUR.

8. Procedura związana z umową serwisową

Procedura konserwacji:

1. Proszę umówić termin z firmą BURMS, podając numer seryjny.
 - Termin można zarezerwować na stronie: <https://calendly.com/burms3d/online-termin>
2. Teraz otrzymają Państwo możliwy termin lub będą mogli wybrać odpowiedni.
 - Rekalibracja wymaga Państwa obecności. Proszę zaplanować około 2 godzin na wizytę.
3. W dniu spotkania pracownik firmy BURMS udostępni Państwu link do spotkania w aplikacji MS Teams.
 - Aplikację Teams można używać w przeglądarce internetowej lub za pomocą aplikacji Teams.
4. Proszę wykonać następujące czynności przed spotkaniem:
 - Usunięcie platformy drukującej
 - Usunięcie zbiornika z żywicą
 - Dokładne wyczyszczenie szklanej płyty (za pomocą izopropanolu lub środka do czyszczenia szkła)
 - Włączenie urządzenia
 - Upewnienie się, że jest dostępne połączenie internetowe
5. Przygotowanie do użytku załączonego wyposażenia:
 - Maski kalibracyjnej
 - Czujnika UV

Wszelkie dodatkowe informacje oraz instrukcje otrzymają Państwo od swojego kontaktu w firmie BURMS. Proszę zauważyć, że termin można umówić tylko w języku niemieckim lub angielskim.

Português



**Instruções para teste de intensidade semanal
e medição de luz difusa**

Instruções/Notas gerais


- Por favor, sempre tome as medidas de proteção apropriadas:
 - Óculos de proteção UV
 - Luvas
- Evite a luz solar ou outras fontes de luz que possam afetar os resultados.
- Mantenha o sensor limpo e evite tocar na sua superfície.
- Os resultados podem fornecer as seguintes informações:
 - Limpeza do vidro
 - Desgaste do vidro
 - Degeneração do projetor
- Em caso de dúvida, entre em contato com a equipe de suporte da DentaMile




1. Remova o tanque, a plataforma de construção e inicie a impressora

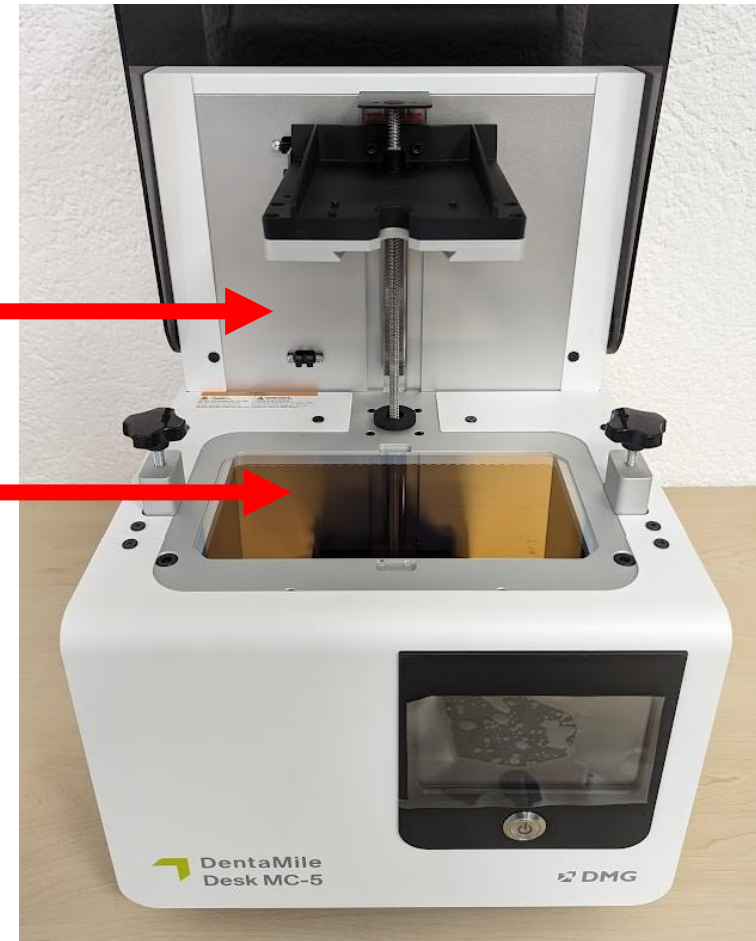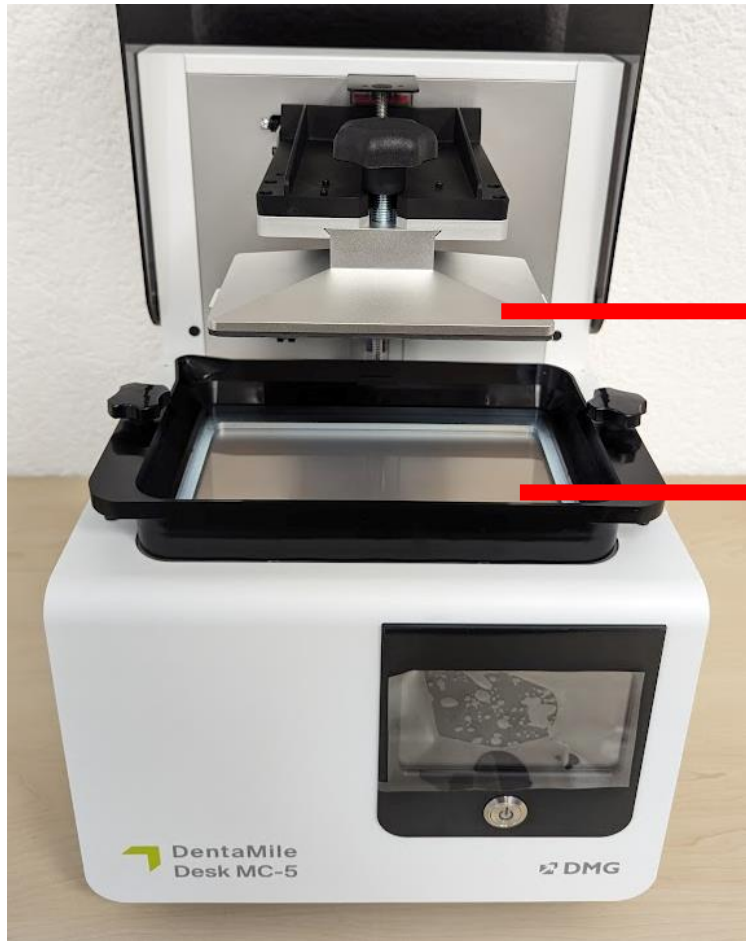


2. Insira a máscara do sensor

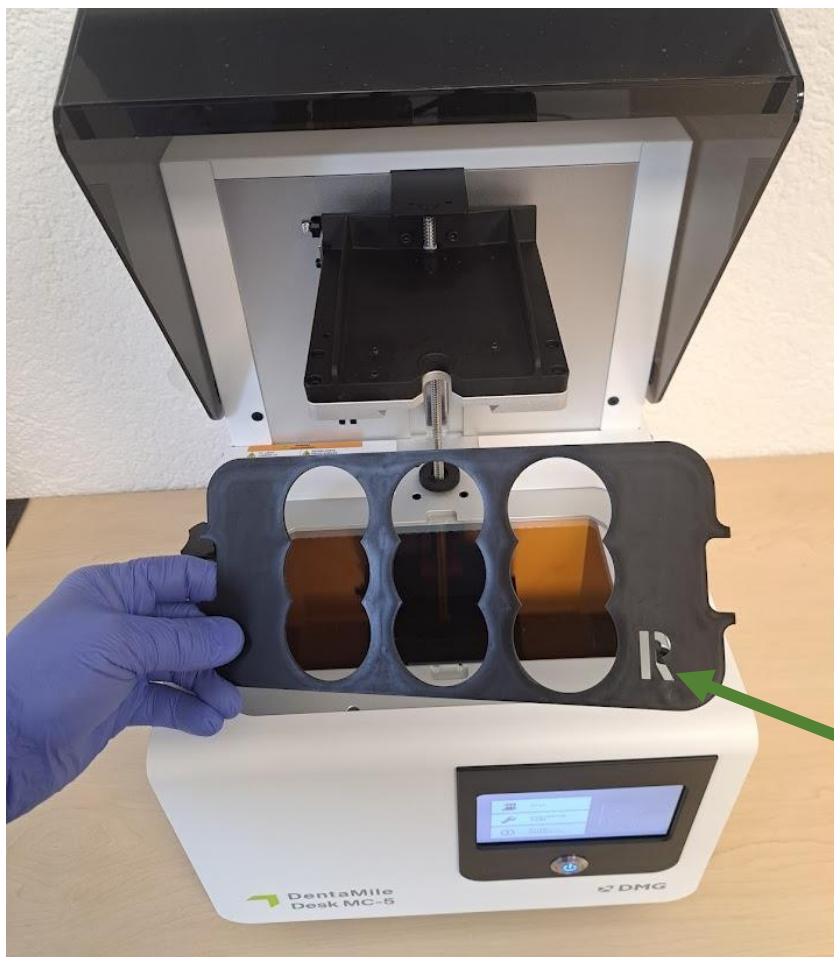



à direita.

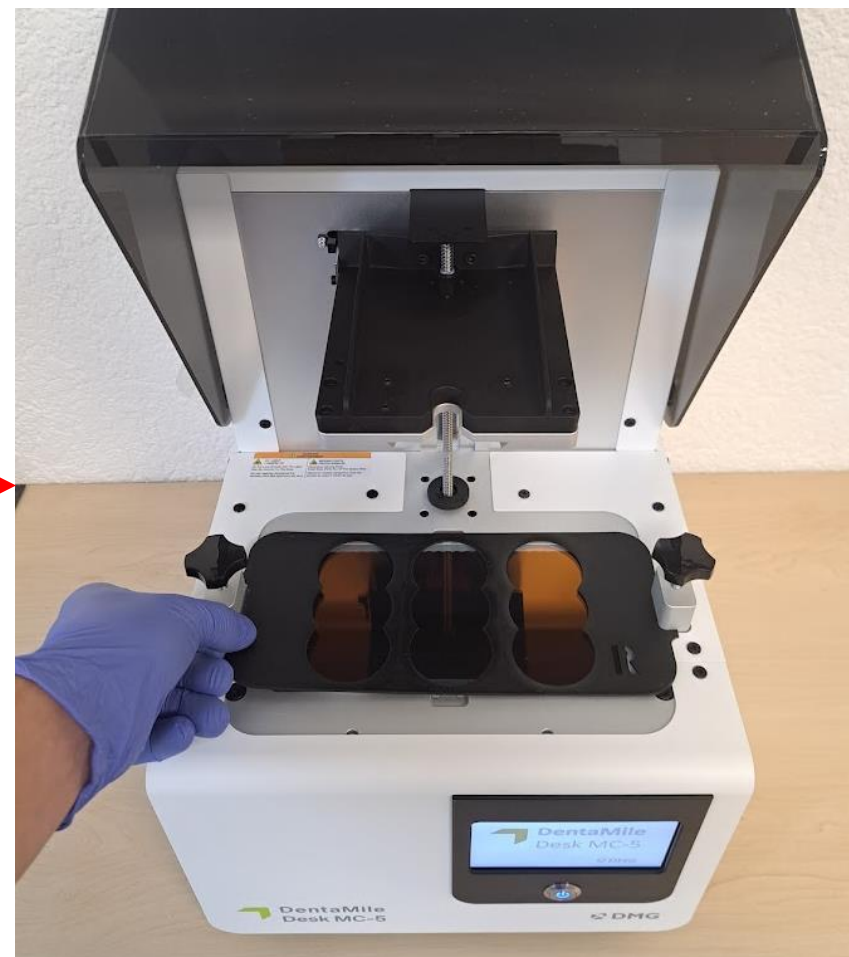


3. Conecte o sensor UV

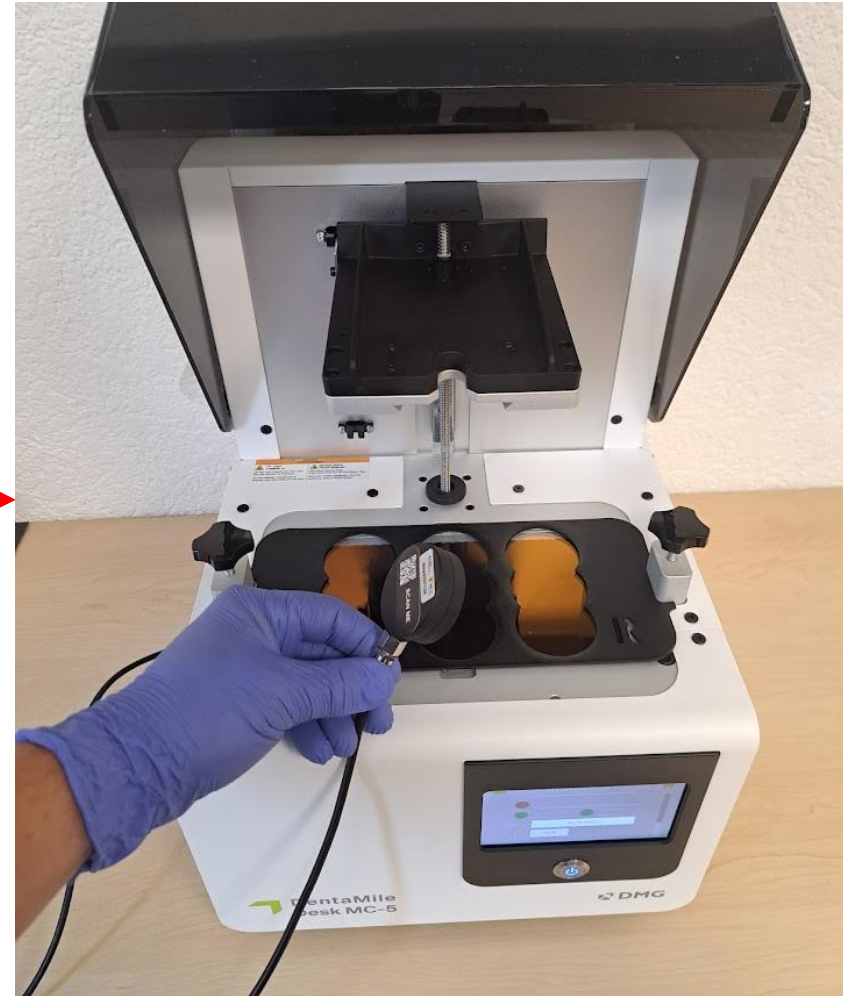




4. Posizione o sensor no centro

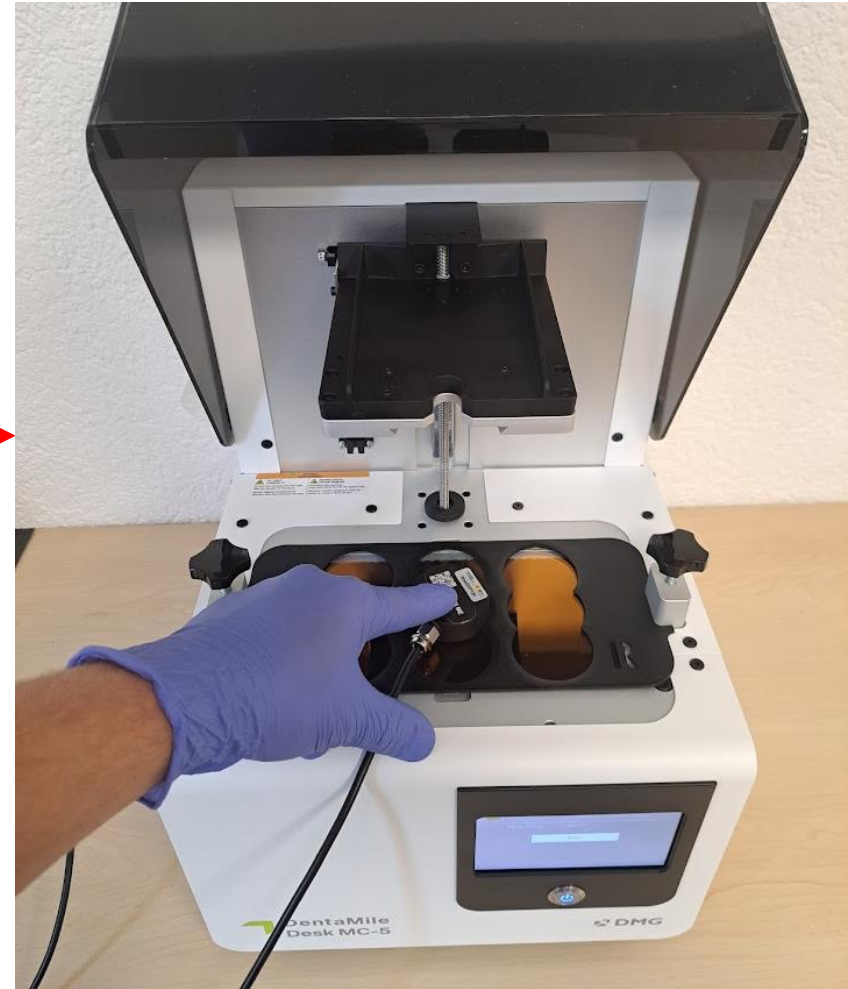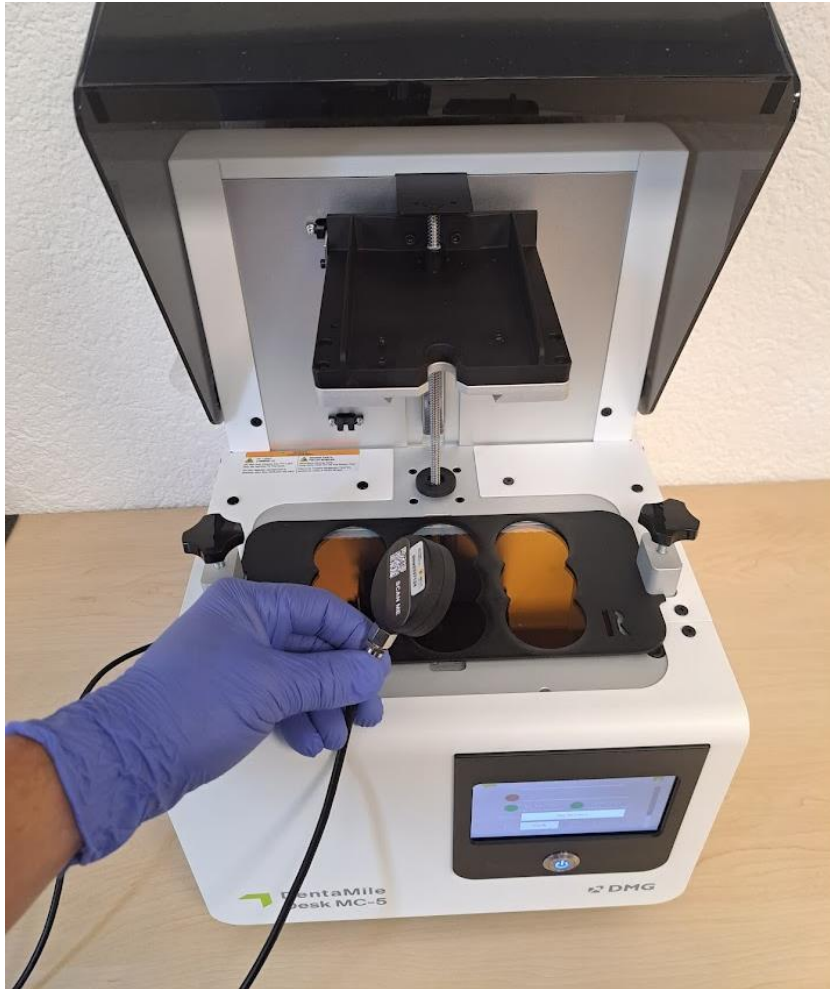

5. Navegue até o menu do projetor

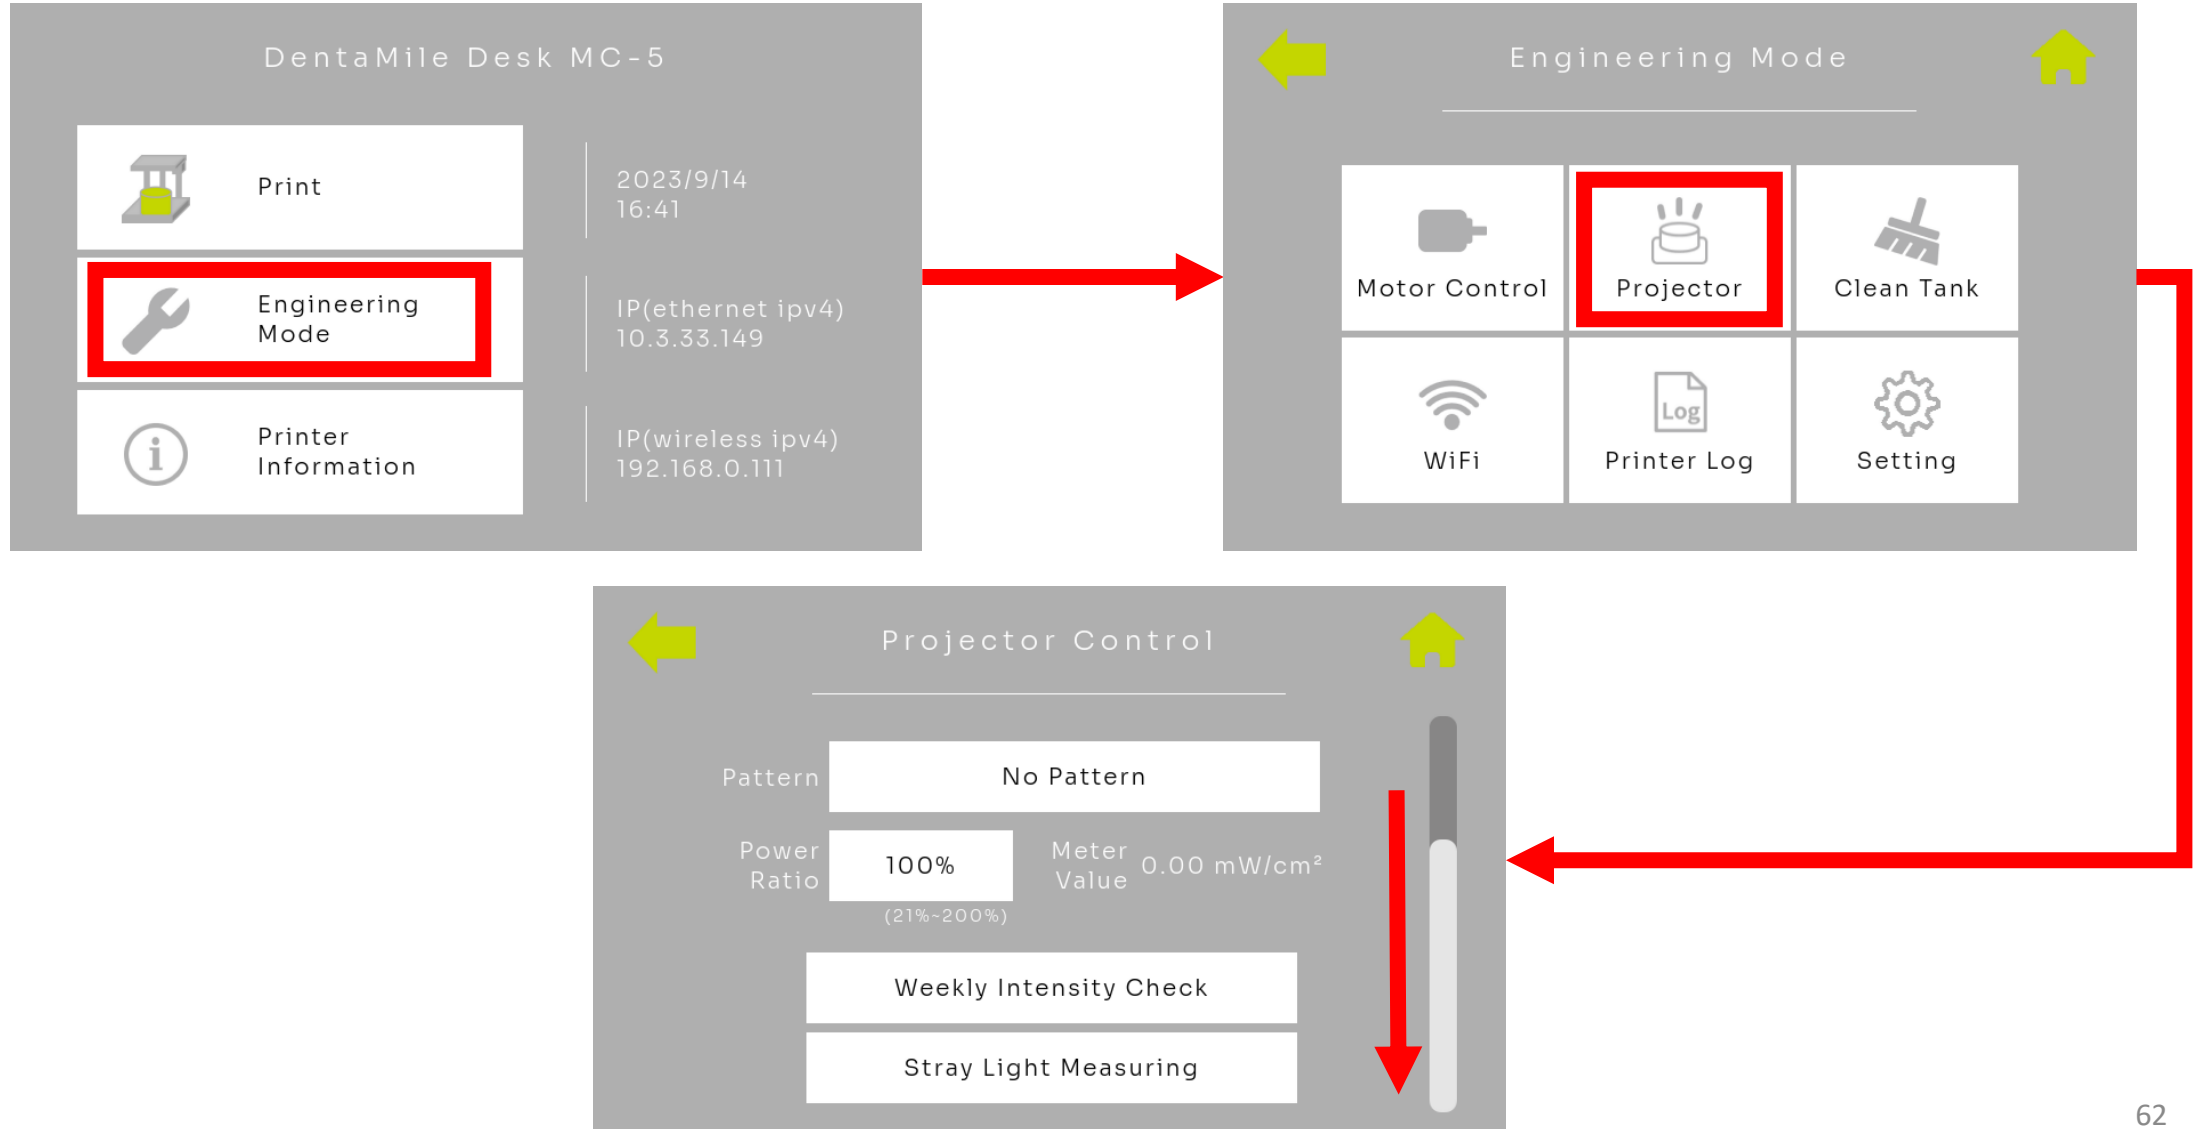

5.1 Semanal Teste de Intensidade

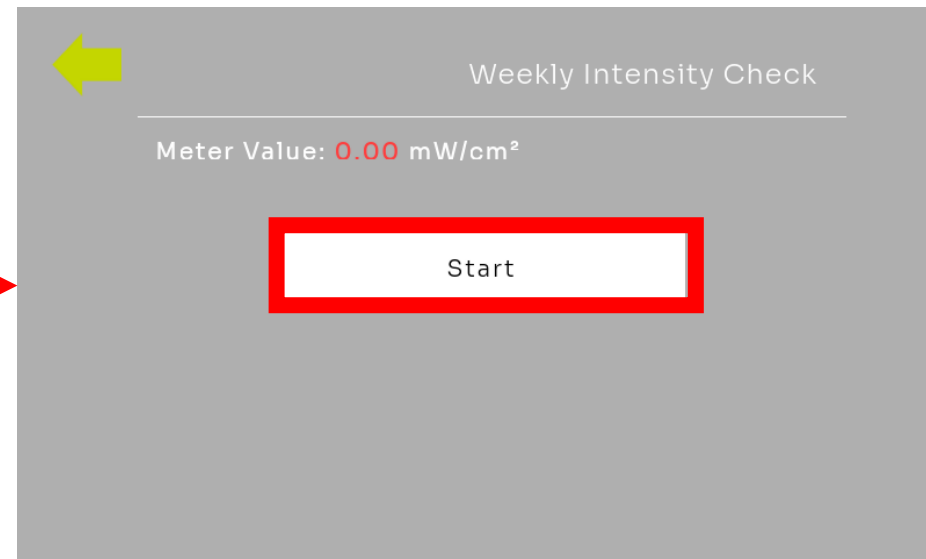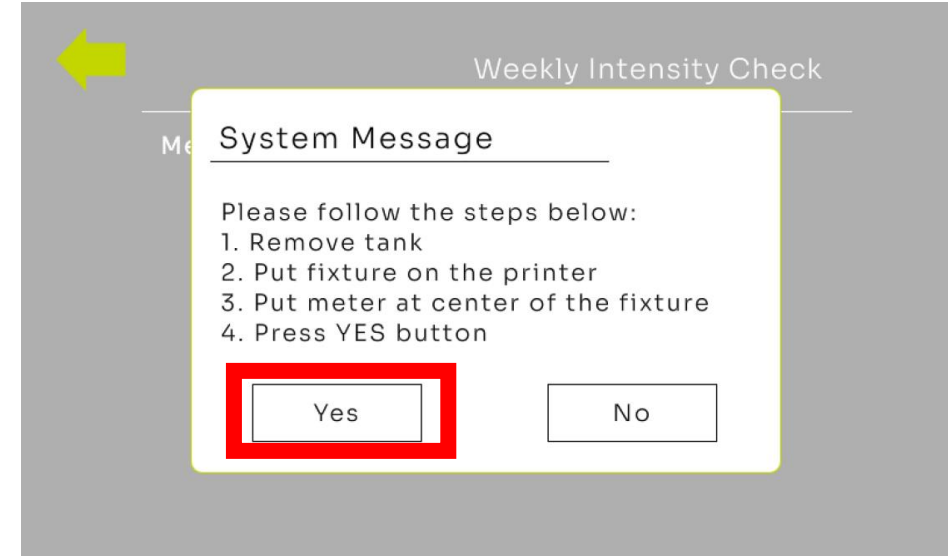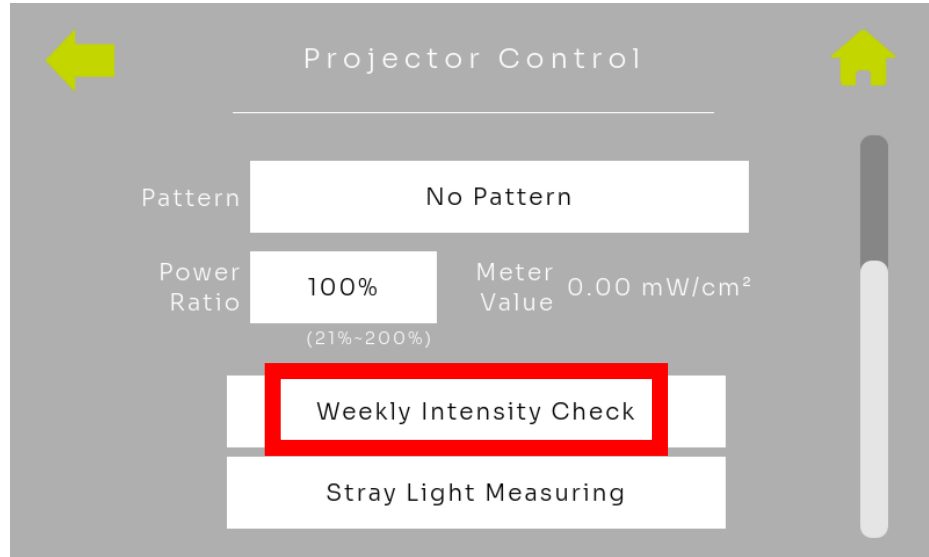




Por favor, verifique:

- O tanque e o coletor foram removidos.
- A máscara do sensor foi inserida.
- O sensor UV está posicionado no centro.
- Pressione "Sim".

5.1 Avaliação - Teste Semanal de Intensidade

O teste está em andamento por 30 segundos. Pressione levemente o sensor na superfície de vidro durante o teste e evite que ele escorregue. Após a conclusão do teste, uma mensagem pop-up informará se o teste foi aprovado.

Se o teste for aprovado, você pode continuar com a impressão.

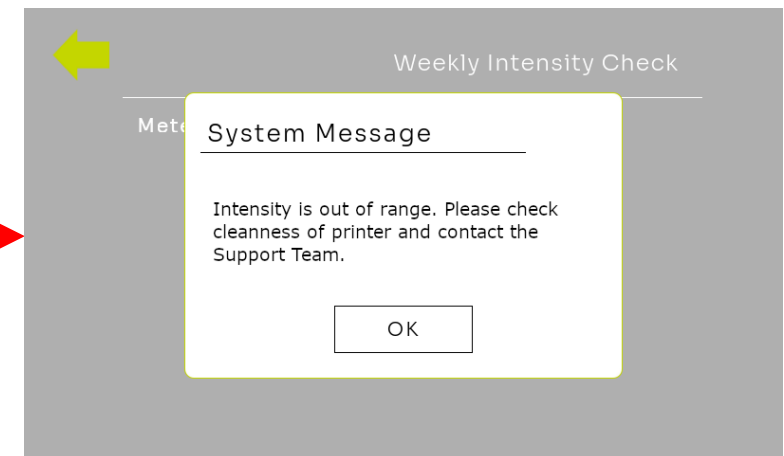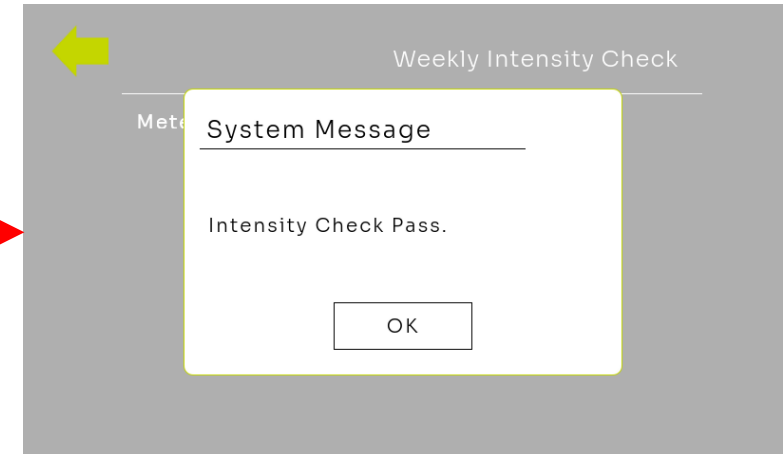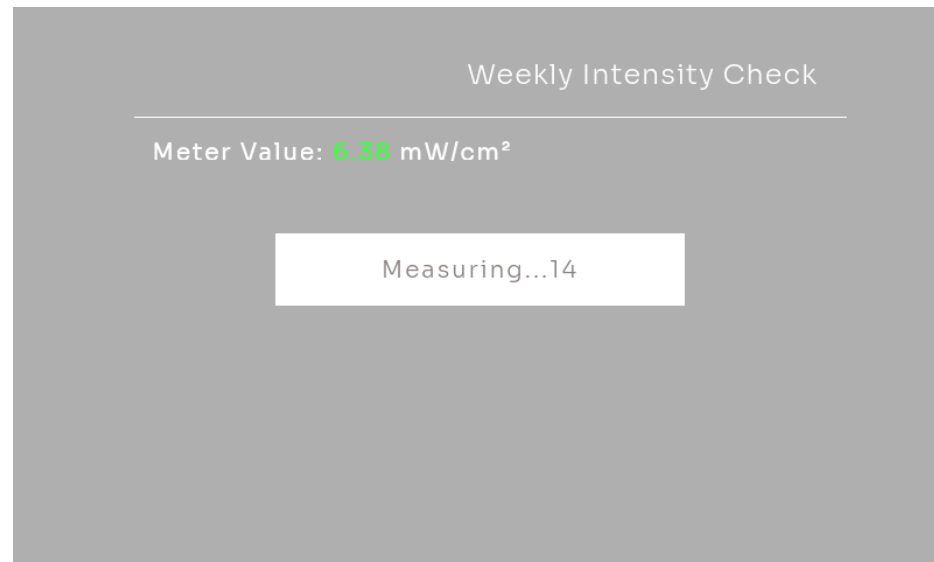


Se o teste não for aprovado, verifique inicialmente a conexão do sensor, a posição correta e a limpeza do equipamento. Em seguida, repita o teste. Se o teste ainda não for aprovado, realize uma medição de luz difusa (consulte 5.2 e 6).

5.2 Medição de Luz Difusa

Se o teste semanal de intensidade falhar ou ocorrerem erros nos componentes ou na impressão, realize a medição de luz difusa.

Procedimento:

- Consulte o passo 3.
- Posicione o sensor UV na primeira posição à esquerda na parte frontal

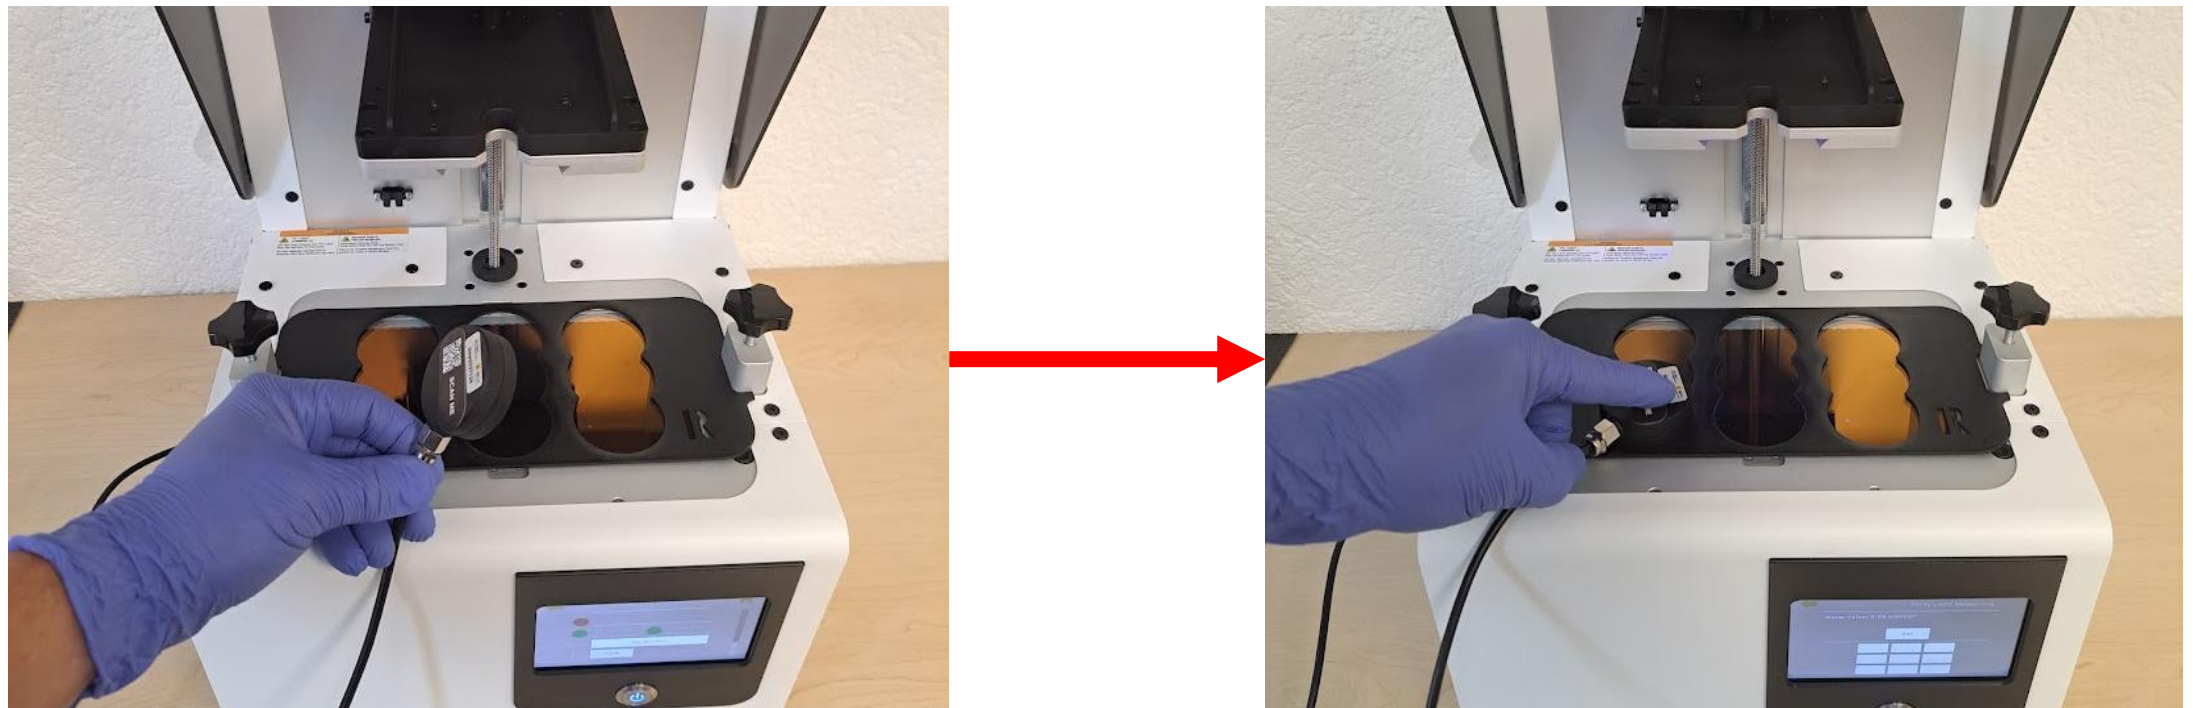


5.2 Medição de Luz Difusa

Navegue até o menu do projetor (consulte o ponto 5.)

Procedimento:

- Selecione 'Medição de Luz Difusa'


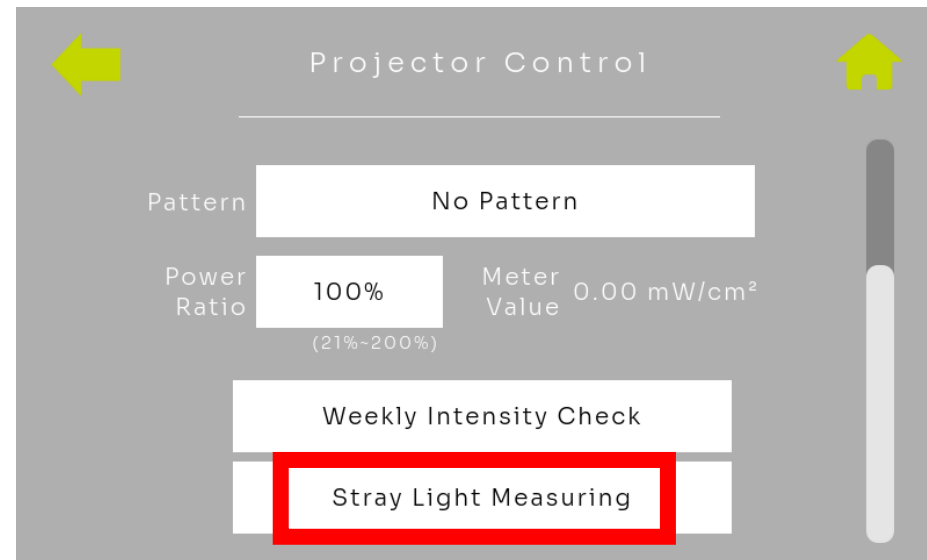


5.2 Medição de Luz Difusa

O projetor agora está exibindo uma área escura no primeiro campo.

Procedimento:

- Aguarde aproximadamente 10 segundos
- Clique em 'Definir'

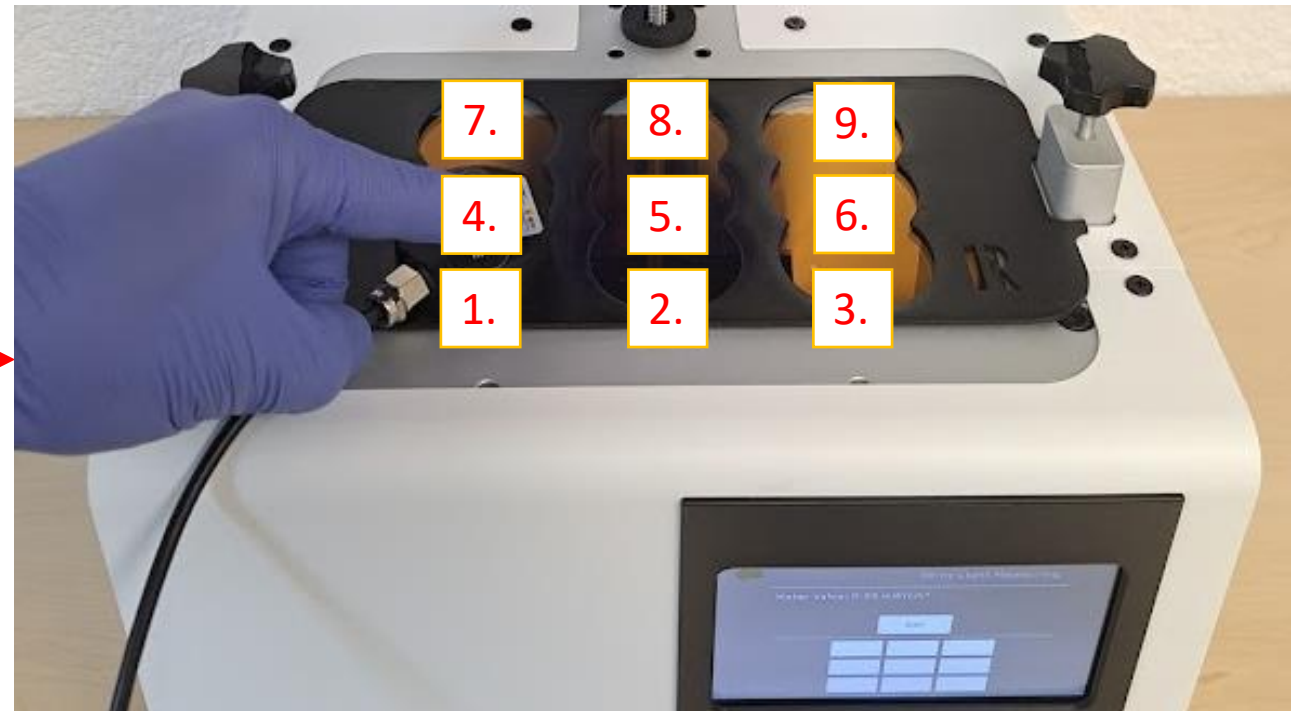
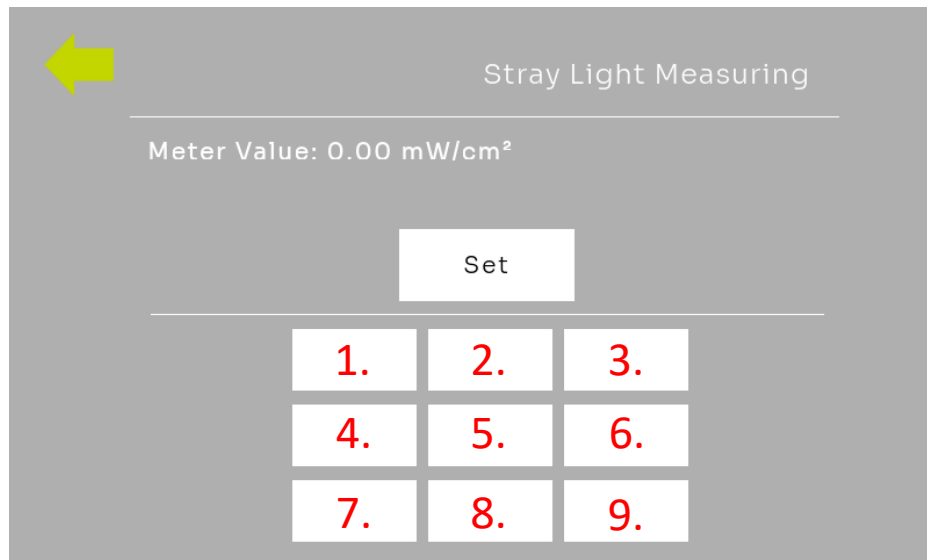


5.2 Medição de Luz Difusa

O projetor agora está exibindo uma área escura no segundo campo.

Procedimento:

- Mova o sensor para o campo 2 e aguarde cerca de 10 segundos.
- Clique novamente em 'Definir'

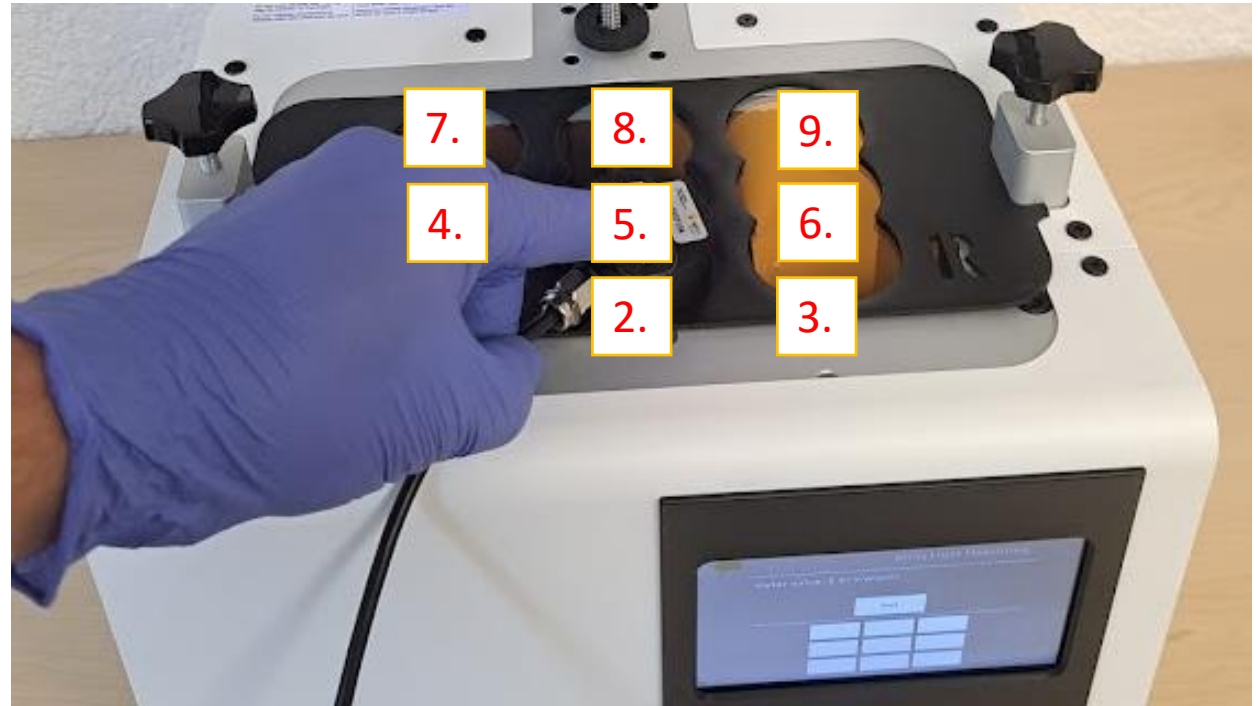
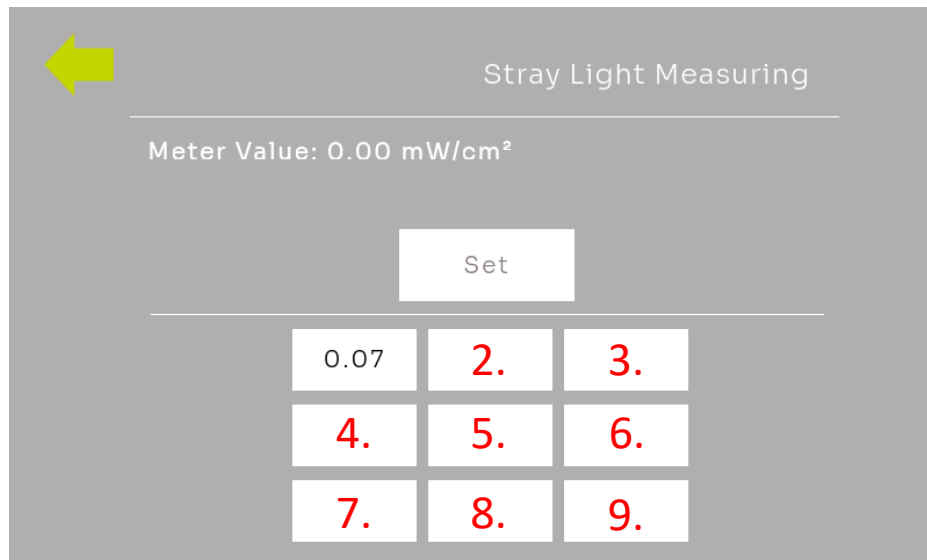


5.2 Medição de Luz Difusa

O projetor agora está gradualmente exibindo uma área escura em todos os campos.

Procedimento:

- Meça sequencialmente todos os 9 campos até que a medição de luz difusa esteja completa.
- Confirme o Ponto 9, clicando em 'Definir'

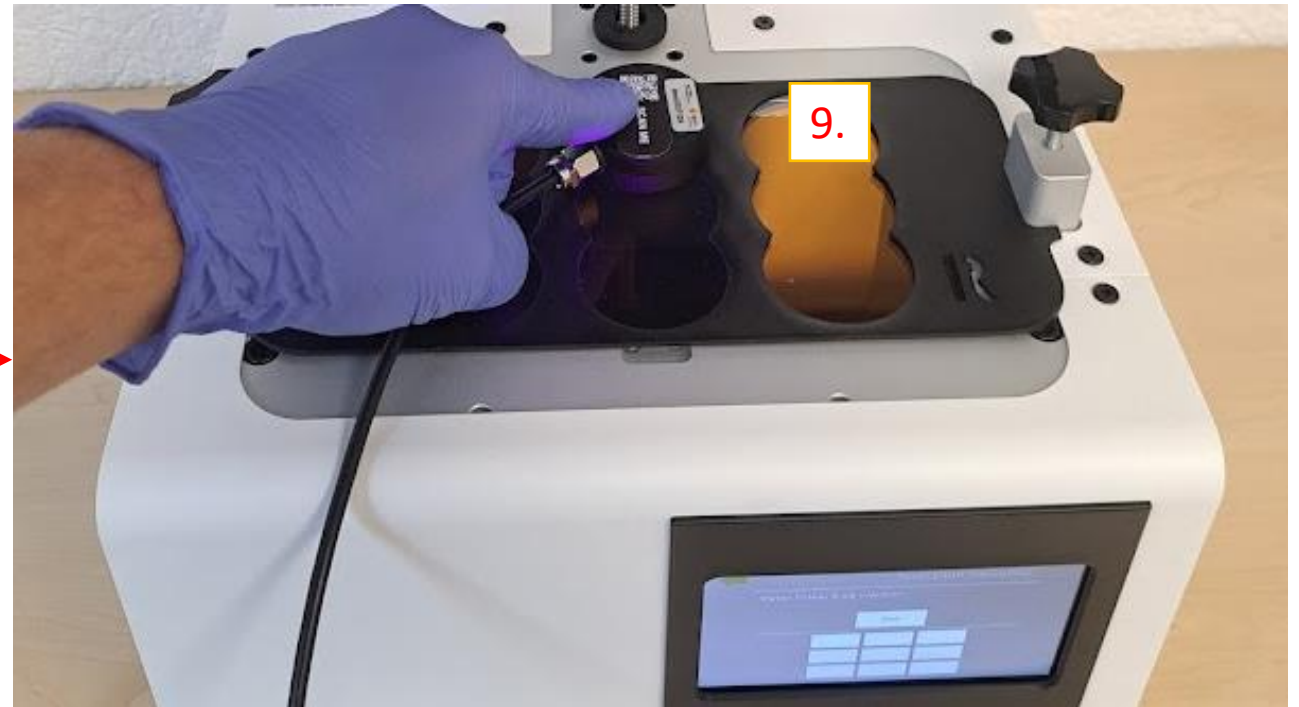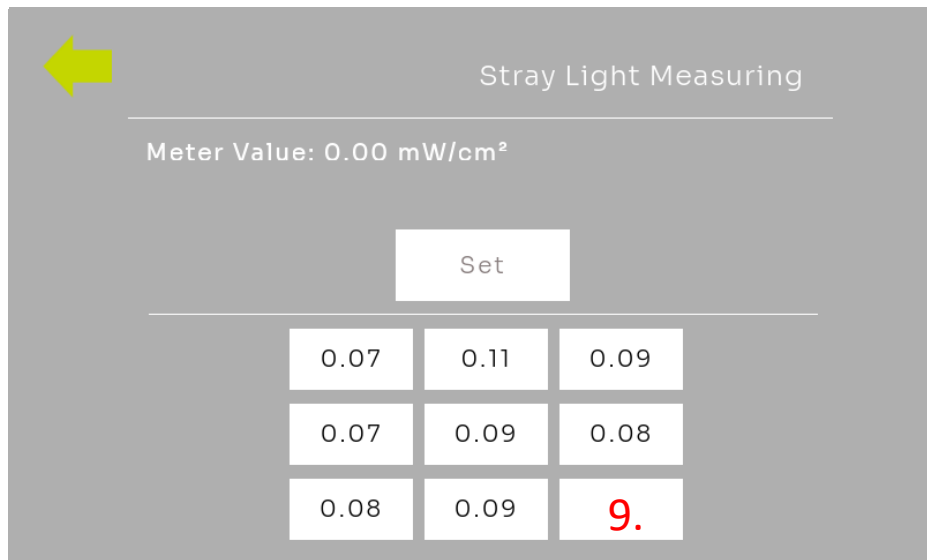

5.2 Avaliação - Medição de Luz Difusa

- Idealmente, os campos na medição de luz difusa devem alcançar valores de: $I \leq 0,1mW/cm^2$
- Se o valor for maior, verifique a limpeza do equipamento
- Arranhões leves ou asperezas também podem levar a valores aumentados de luz difusa.
- Se $I \geq 0,15mW/cm^2$, entre em contato com a equipe de suporte da DentaMile.

Após a conclusão da medição de luz difusa, por favor, feche a janela para desativar o projetor.

Se desejar testar um campo novamente, clique no campo desejado e posicione novamente o sensor.


Stray Light Measuring

Meter Value: 0.00 mW/cm²

Set

0.07	0.11	0.09
0.07	0.09	0.08
0.08	0.09	0.08

6. Diagrama de Avaliação

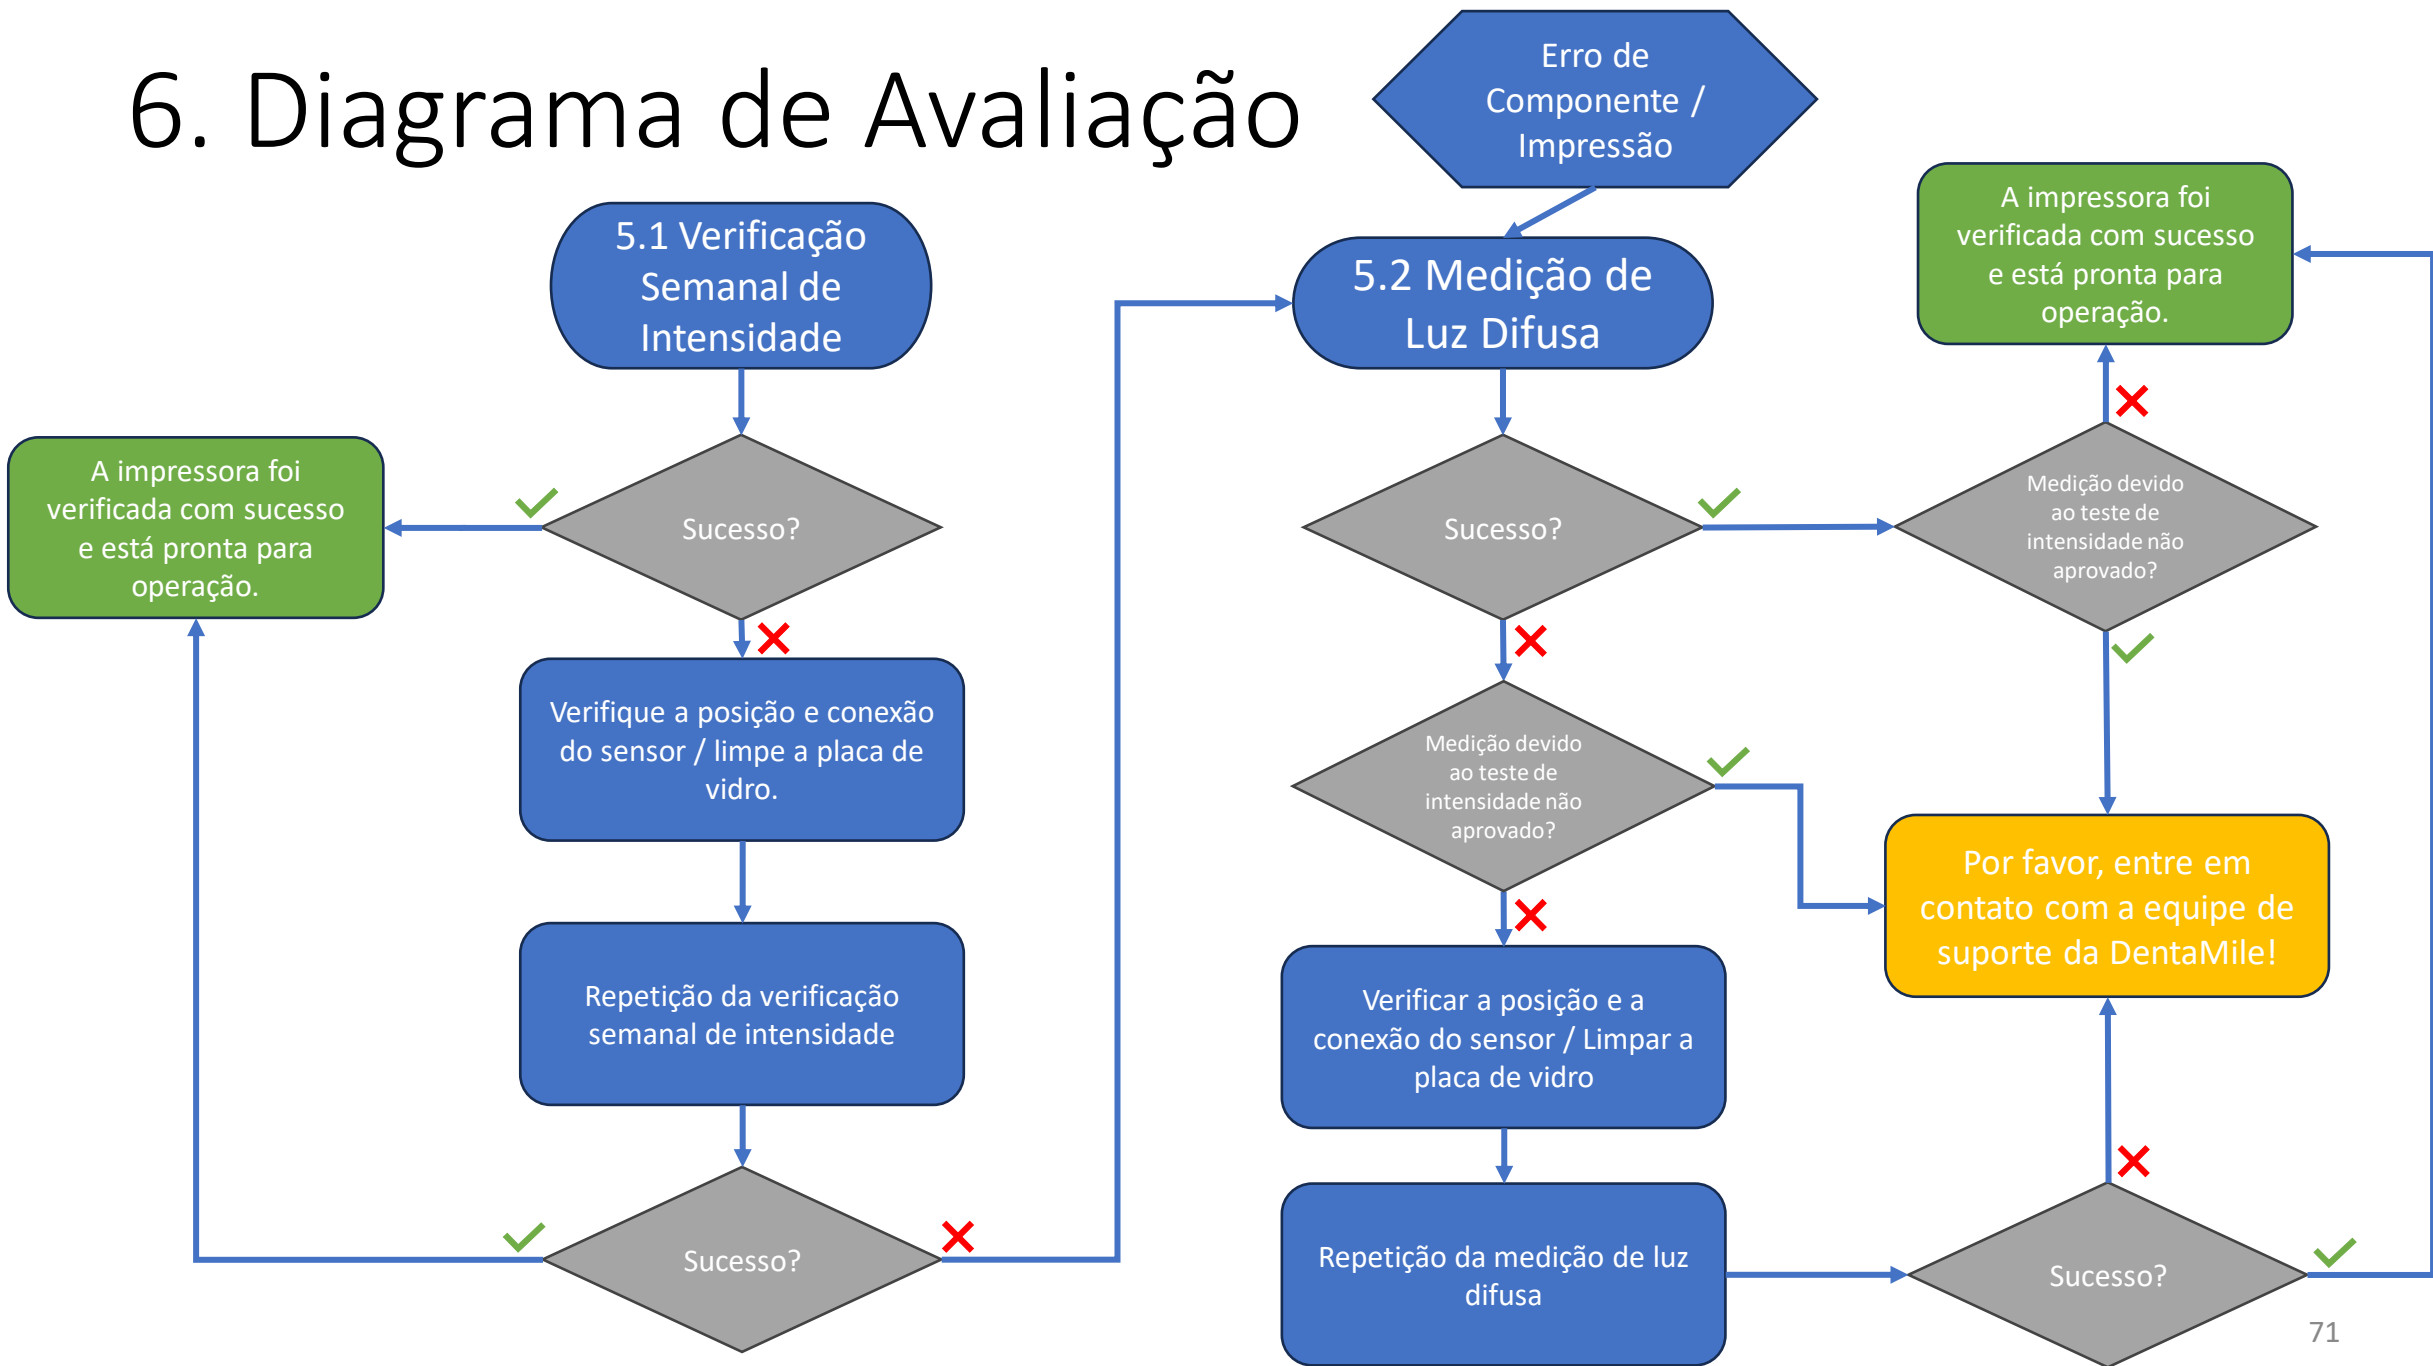

7. Recalibração do Sensor UV

Seguem informações importantes para o seu fluxo de trabalho validado!

- Seu sensor UV precisa ser recalibrado uma vez por ano. Isso garantirá que o sensor forneça medições confiáveis.
- Por favor, envie o seu sensor para o nosso parceiro BURMS para recalibração.
- Coloque o sensor em um envelope acolchoado e envie-o para:

BURMS 3D Druck GmbH und Co.KG.
Hermann-Löns-Str. 2
07745 Jena
Alemanha

- Se você tiver um contrato de manutenção opcional, a recalibração está incluída nas suas taxas anuais de manutenção. Certifique-se de enviar o sensor recalibrado para o nosso parceiro aproximadamente 4 semanas antes da sua manutenção anual, pois eles precisam do sensor recalibrado para a manutenção.
- Se você não tiver um contrato de manutenção, a recalibração custará 299 euros.

8. Procedimento com Contrato de Manutenção

Procedimento de Manutenção:

1. Por favor, agende um horário com a BURMS, indicando o número de série.
 - Agende pelo link: <https://calendly.com/burms3d/online-termin>
2. Você receberá uma data disponível ou poderá escolher uma data.
 - A recalibração requer a sua presença. Por favor, reserve cerca de 2 horas.
3. No horário agendado, um funcionário da BURMS fornecerá a você um link do MS TEAMS.
 - O TEAMS pode ser usado pelo navegador ou pela aplicação TEAMS.
4. Antes do horário agendado, realize as seguintes tarefas:
 - Remova a plataforma de construção.
 - Remova o tanque.
 - Limpe minuciosamente o vidro (com isopropanol ou limpador de vidro).
 - Ligue o equipamento.
 - Certifique-se de estar conectado à internet.
5. Tenha o seguinte equipamento à mão:
 - Máscara de calibração.
 - Sensor UV.

Seu contato na BURMS explicará todos os outros passos.

Por favor, note que o agendamento só pode ser feito em alemão ou inglês.

中文



在这里是每周强度测试和杂散光测量”的说明

一般说明/注意事项


- 请始终采取适当的安全措施。
 - 紫外线防护眼镜。
 - 手套。
- 避免阳光或其他可能影响结果的光源。
- 保持传感器清洁，避免触摸**传感器表面**。
- 结果可能提供以下指示：
 - 窗户的清洁度。
 - 窗户的磨损。
 - 投影仪的退化。
- 如有疑问，请联系您的DentaMile支持团队。




1. 移除油箱、构建平台并启动打印机

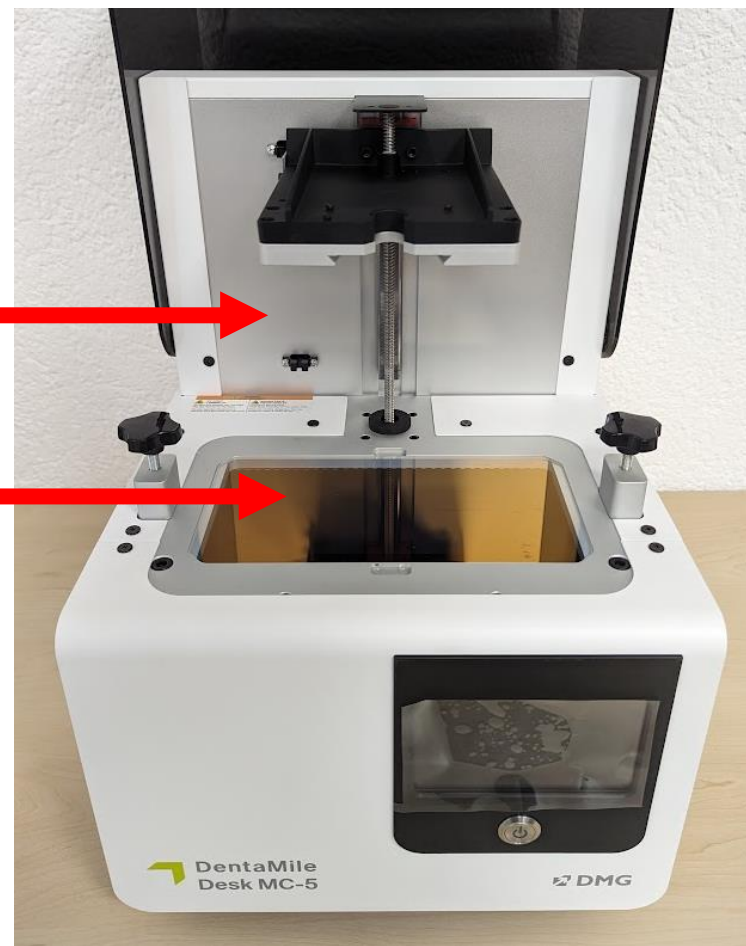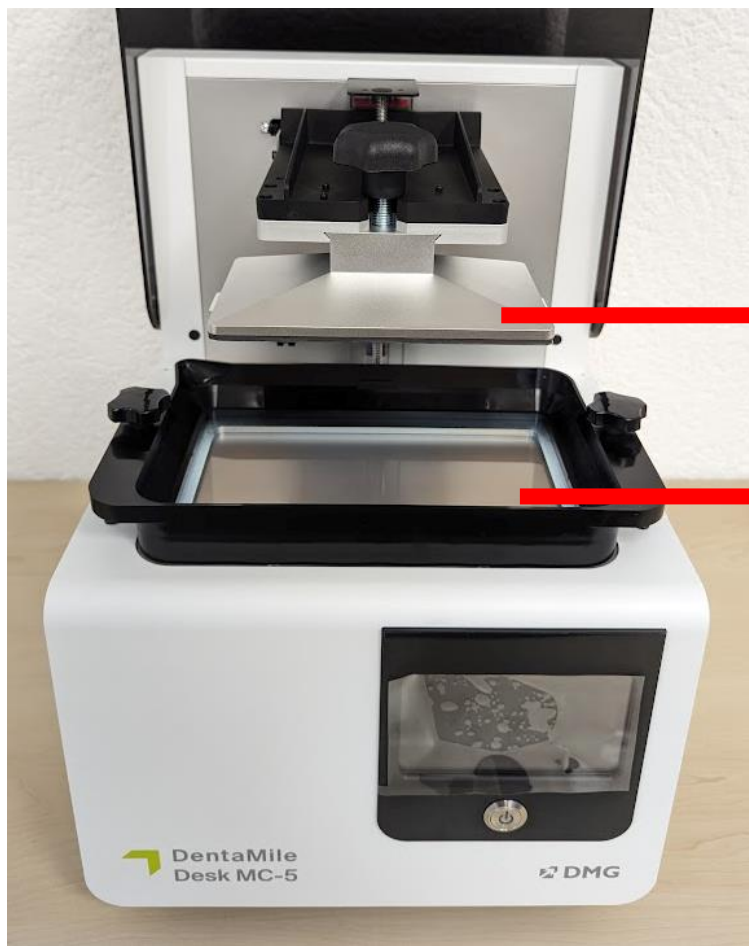


2. 插入传感器面罩。

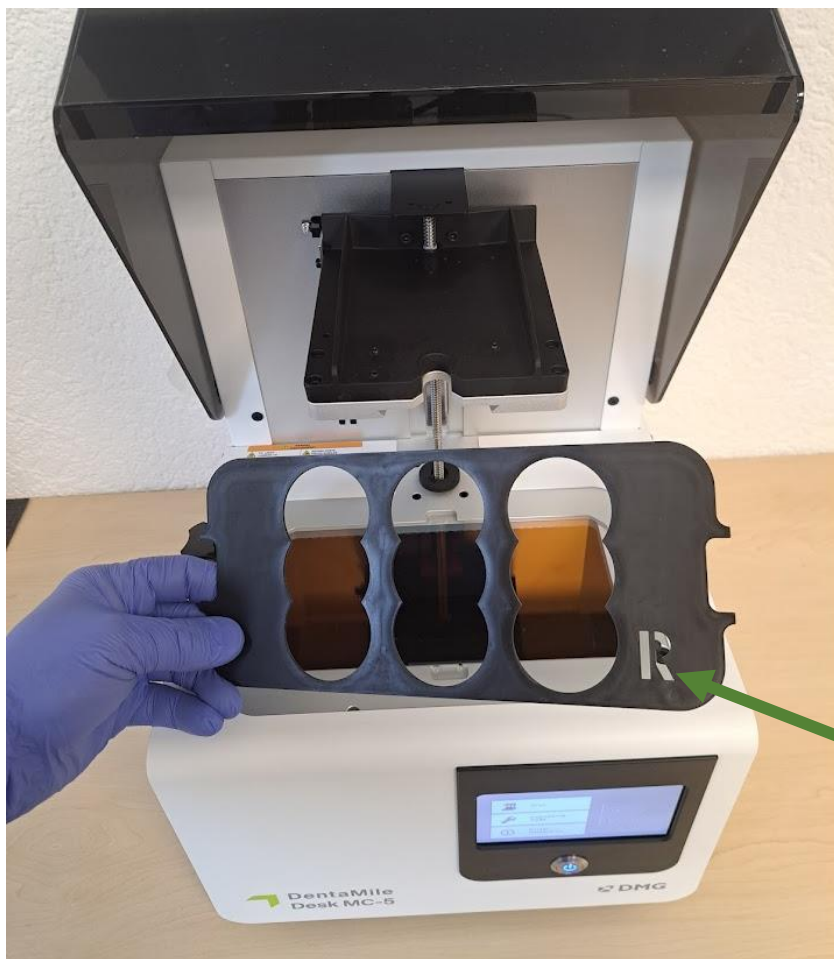



右侧。

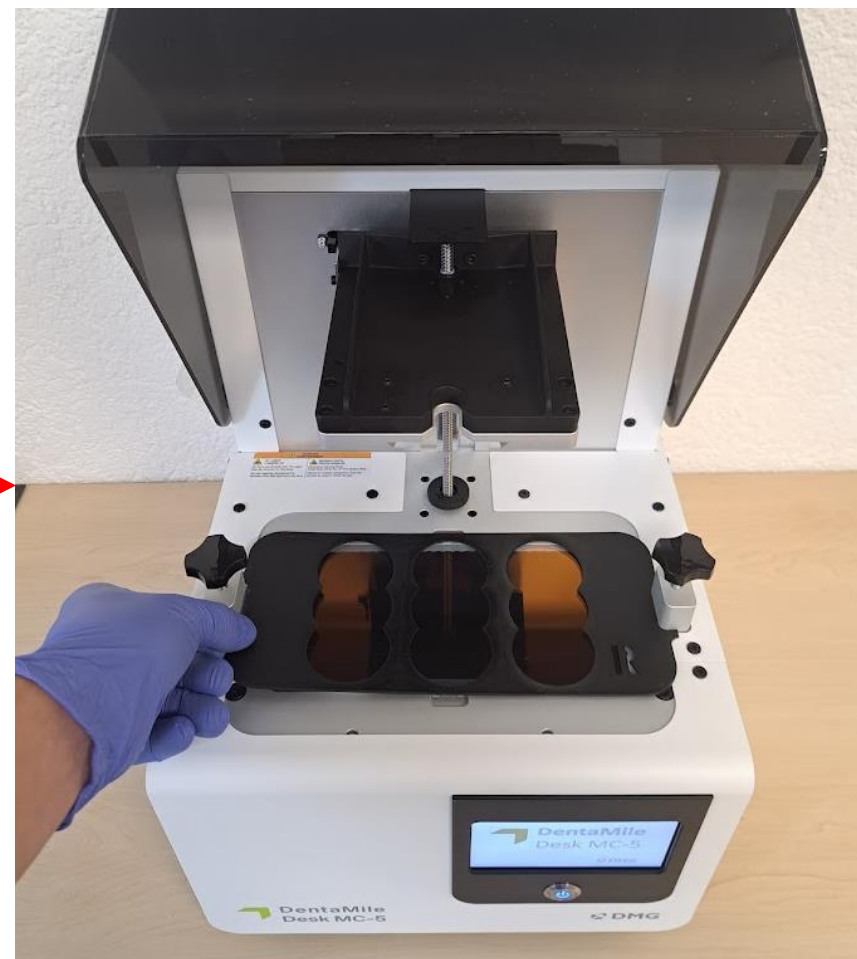




3. 连接紫外线传感器

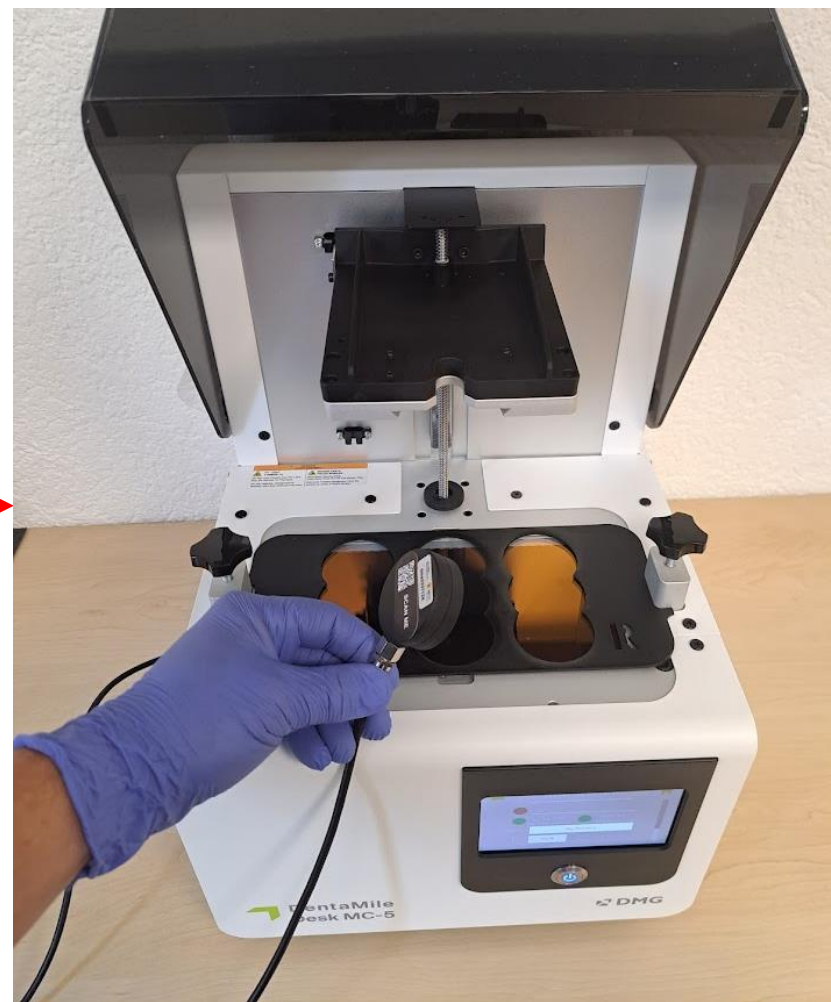




4. 将传感器置于中央位置。

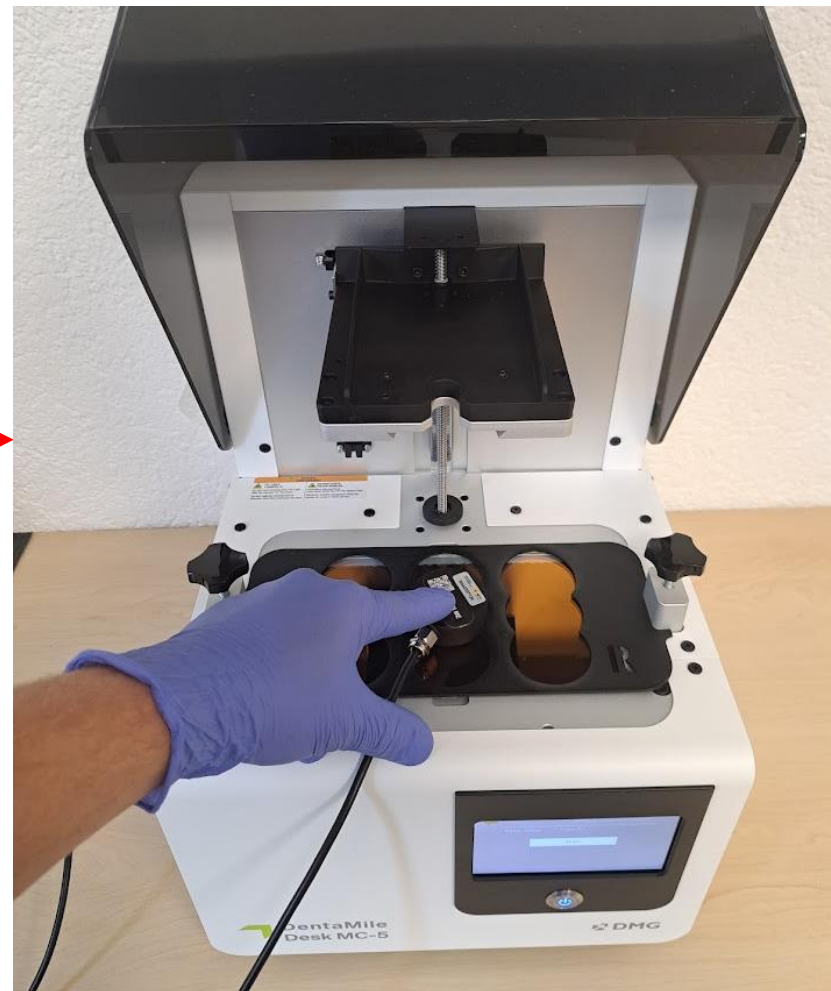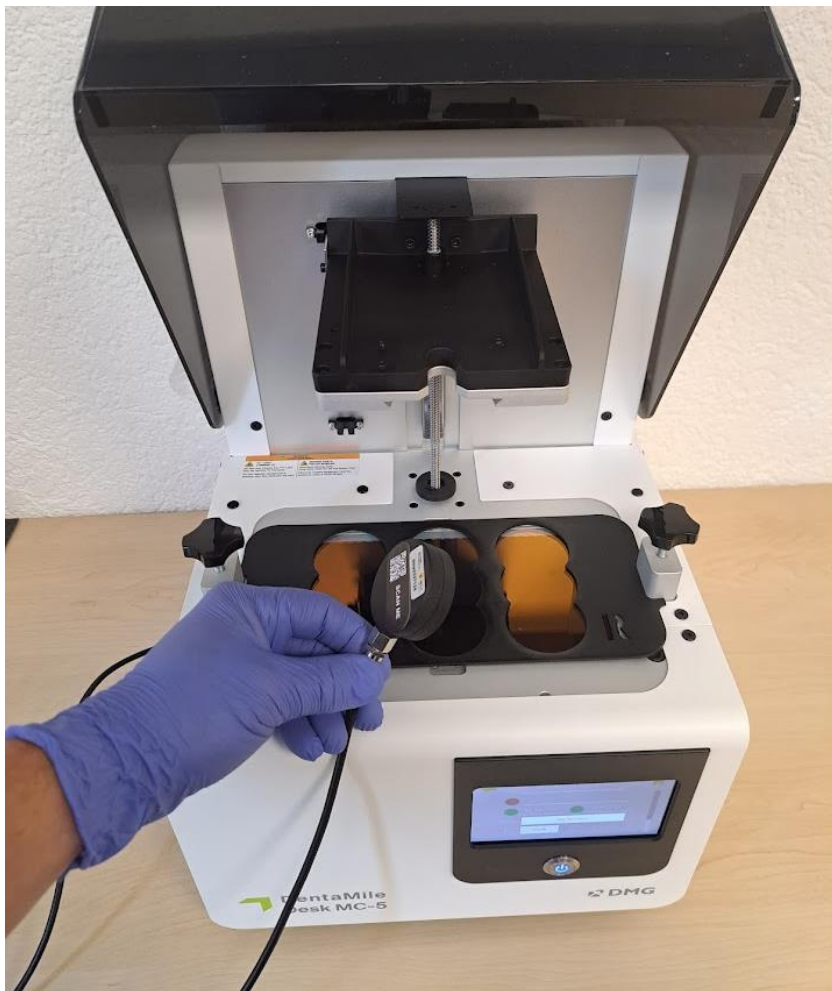

5. 进入投影仪菜单。

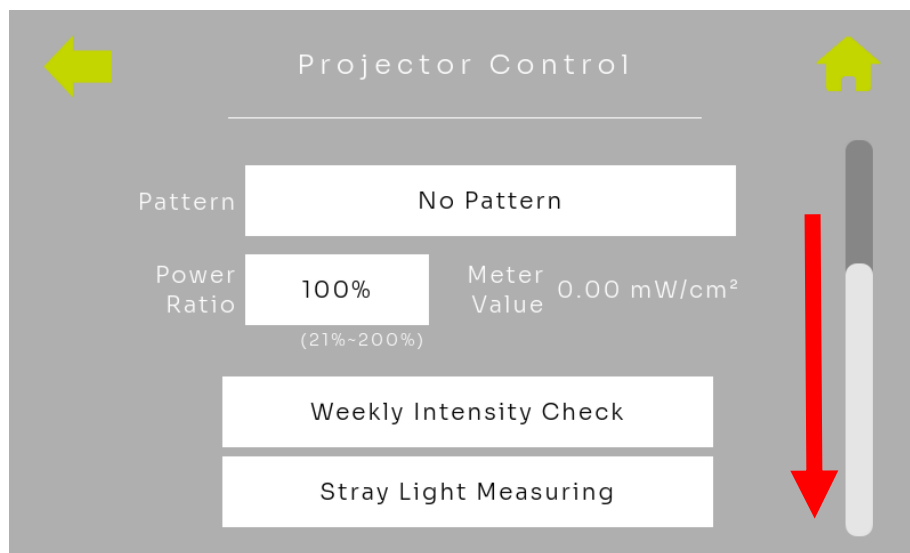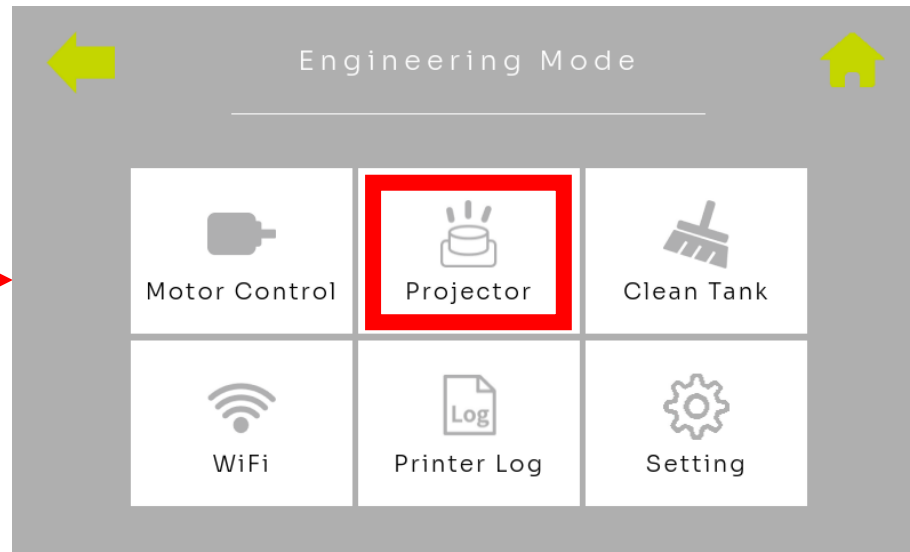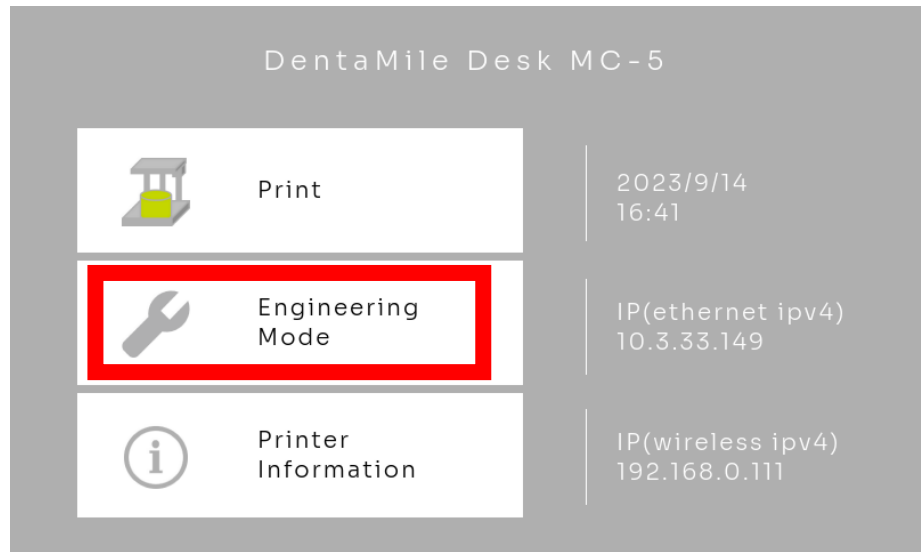

5.1 每周强度测试。

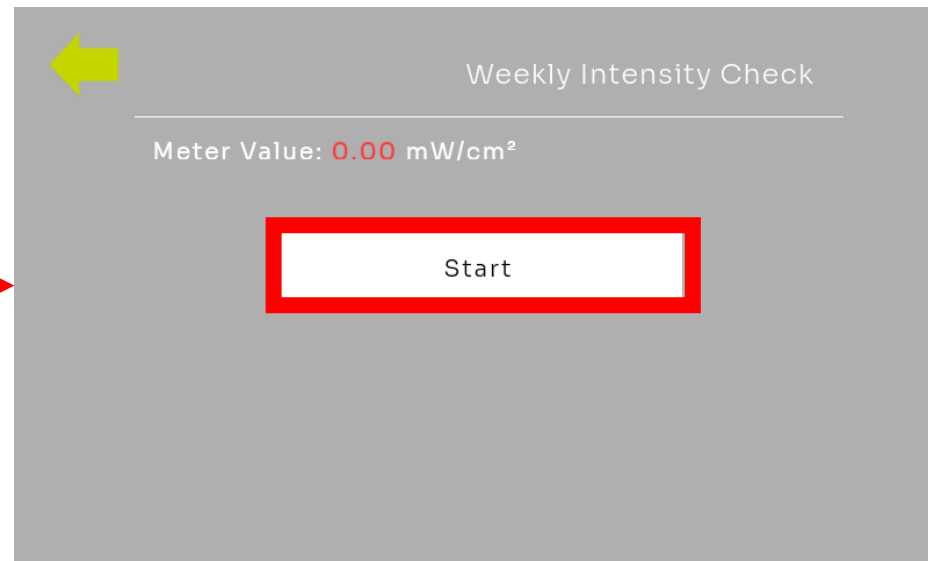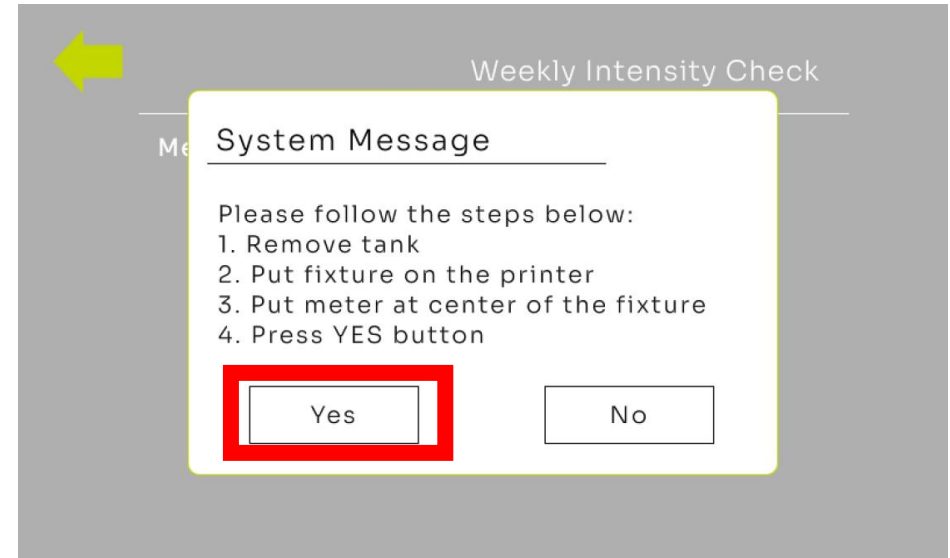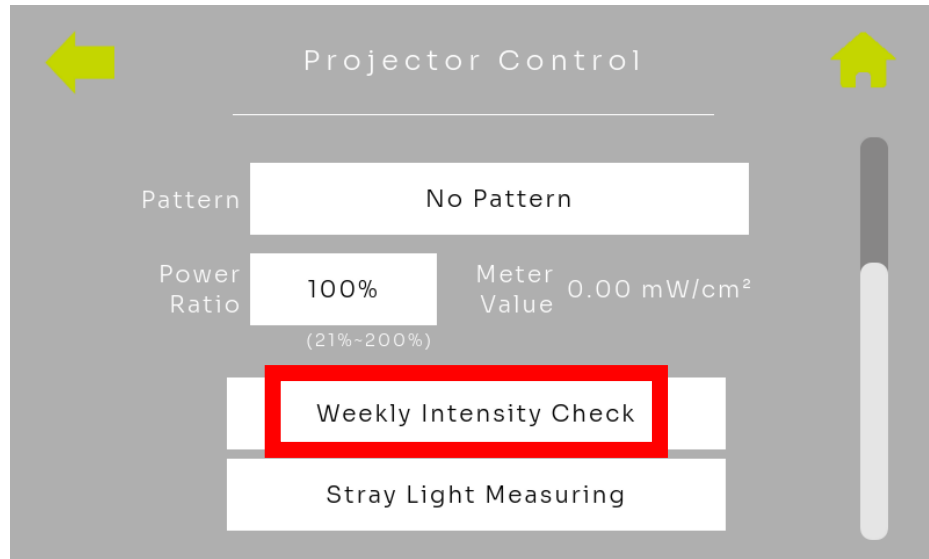




请检查：

- 没有存储罐和拾取器
- 传感器面罩已经安装
- UV传感器位于中央
- 按下“Yes”按钮。

5.1 每周强度测试结果评估

测试现在运行30秒。请在测试运行期间轻轻按压传感器到玻璃上，避免它滑动。测试完成后，将弹出消息通知您测试是否通过。

如果测试通过，您可以继续打印。

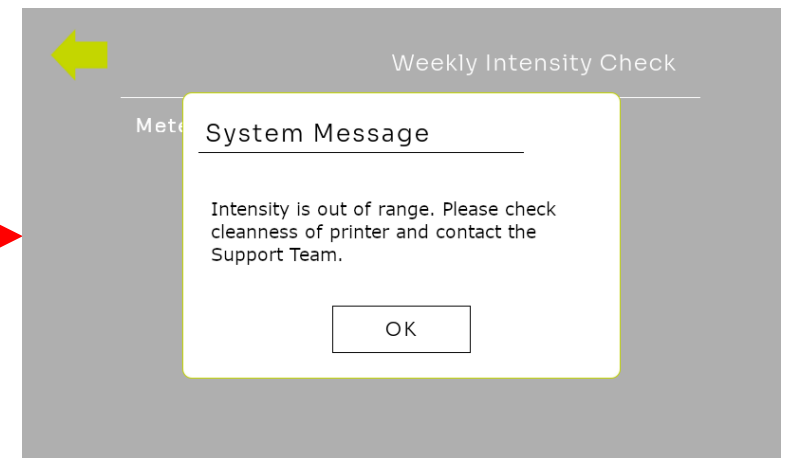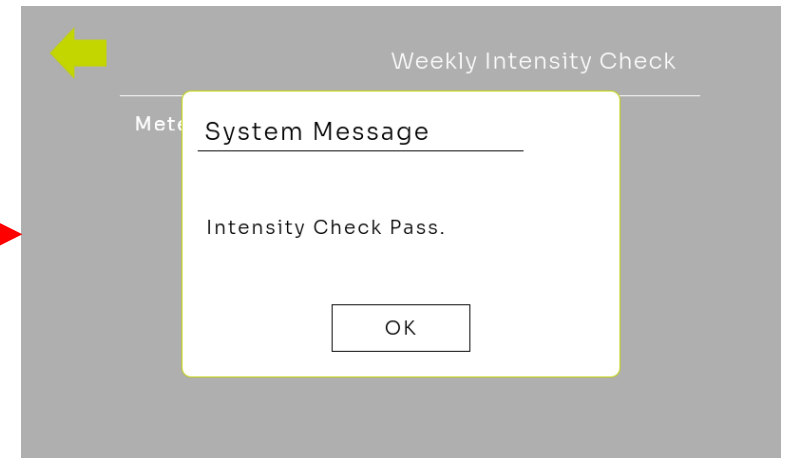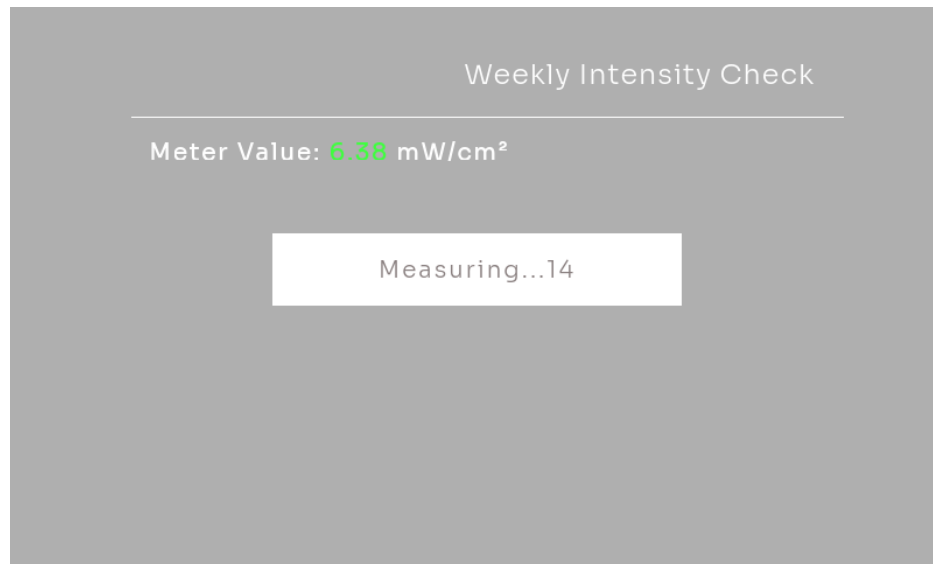


如果测试未通过，请首先检查传感器的连接、正确位置和设备的清洁情况。然后重新运行测试。如果测试仍然不通过，请进行散射光测量（参见5.2和6）。

5.2 散射光测量

如果每周强度测试未通过，或者出现零件或打印错误，请进行散射光测量。

操作步骤：

- 参见第3步。
- 将UV传感器放置在左前角的第一个位置。

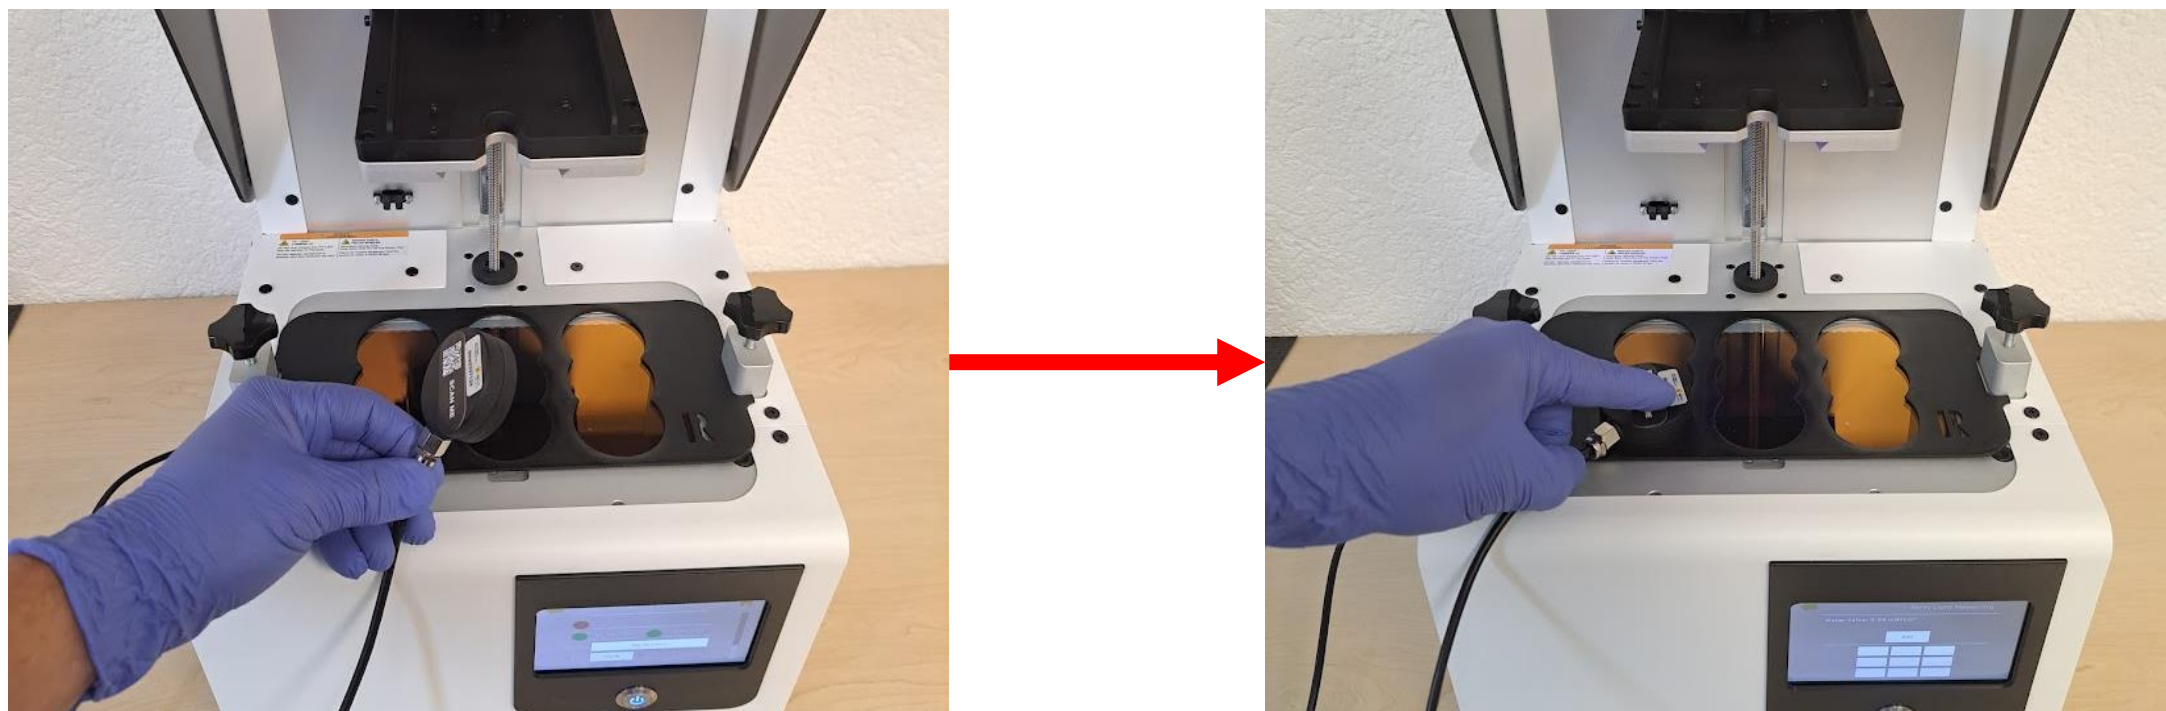


5.2 散射光测量

请导航至投影仪菜单（参见第5点）。

操作步骤：

- 选择"散射光测量"。


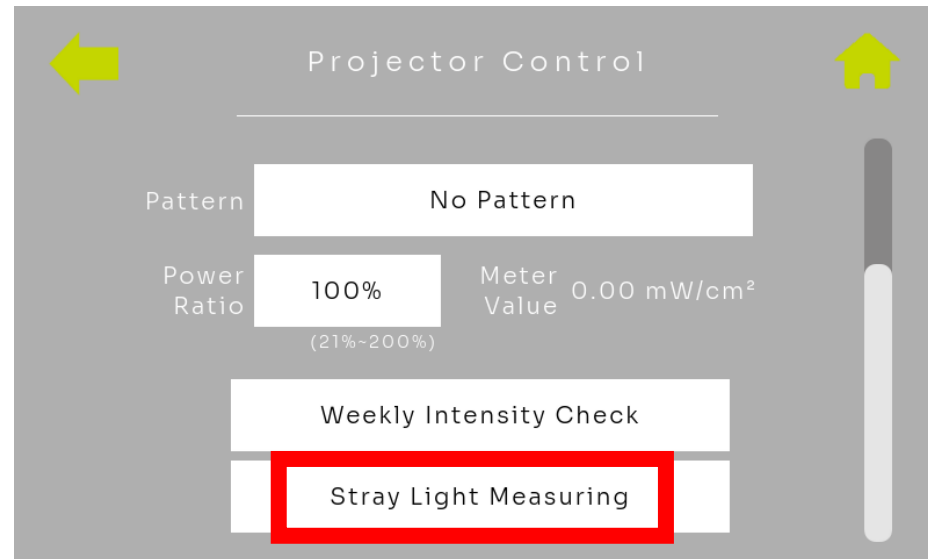


5.2 散射光测量

投影仪现在在第一个区域显示一个黑暗区域。

操作步骤：

- 等待大约10秒。
- 单击"Set"。

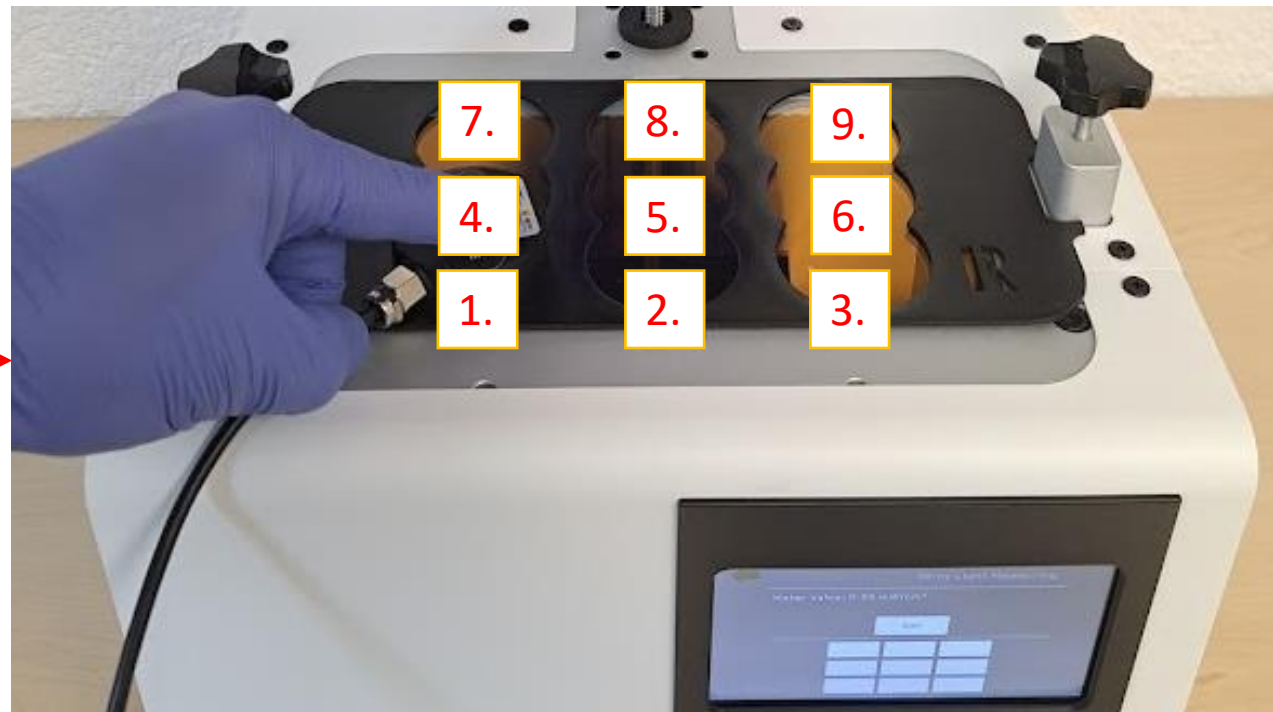
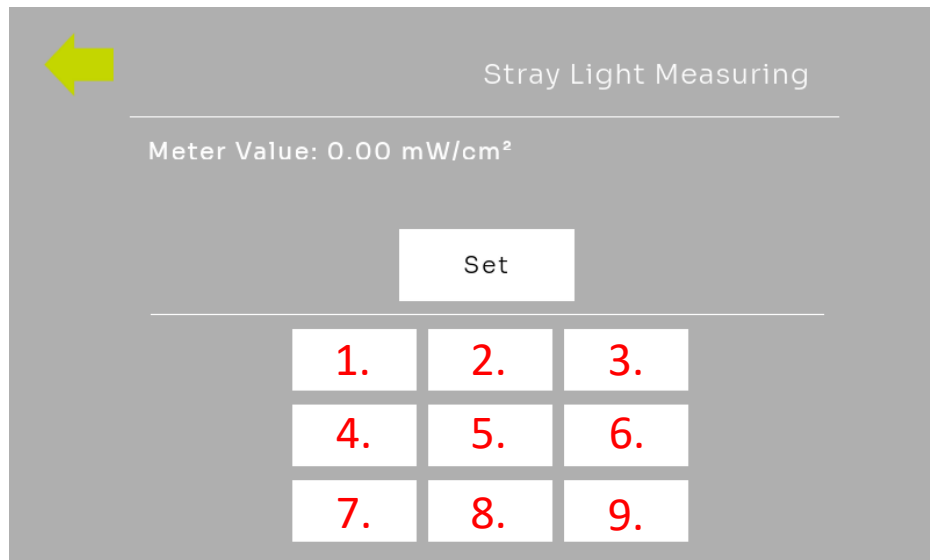


5.2 散射光测量

投影仪现在在第二个区域显示一个黑暗区域。

操作步骤：

- 将传感器移到第2个区域并等待大约10秒。
- 然后再次单击"Set"。

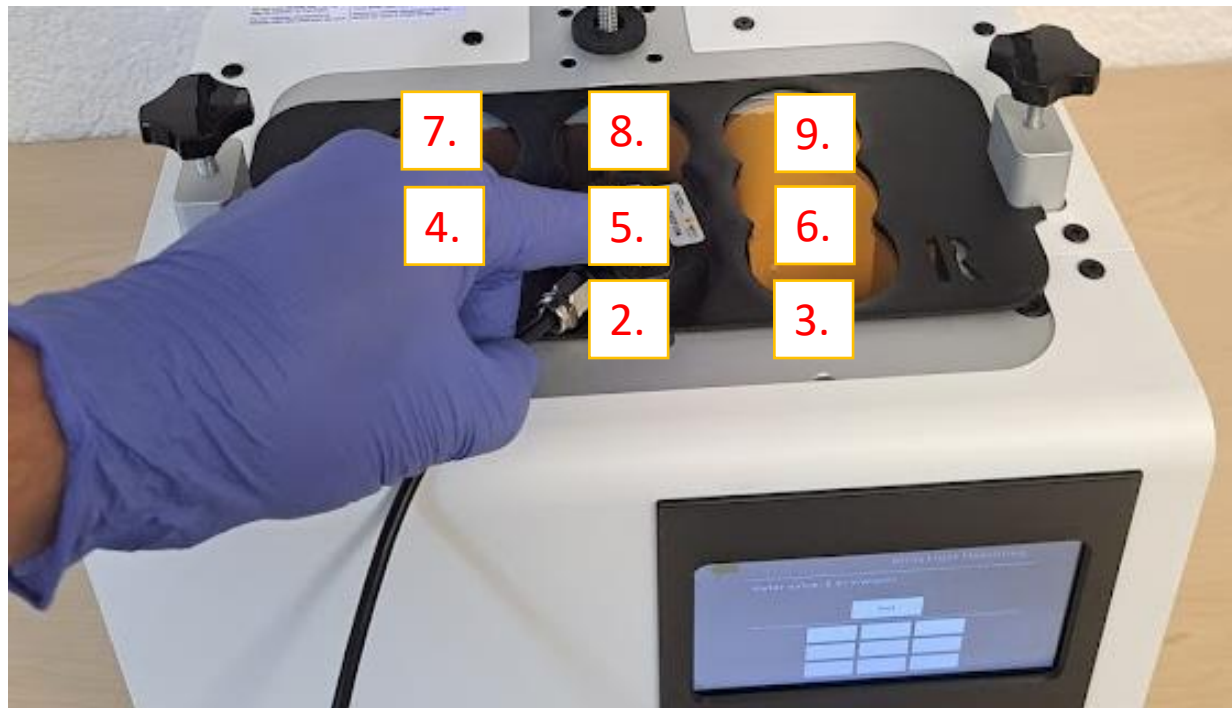
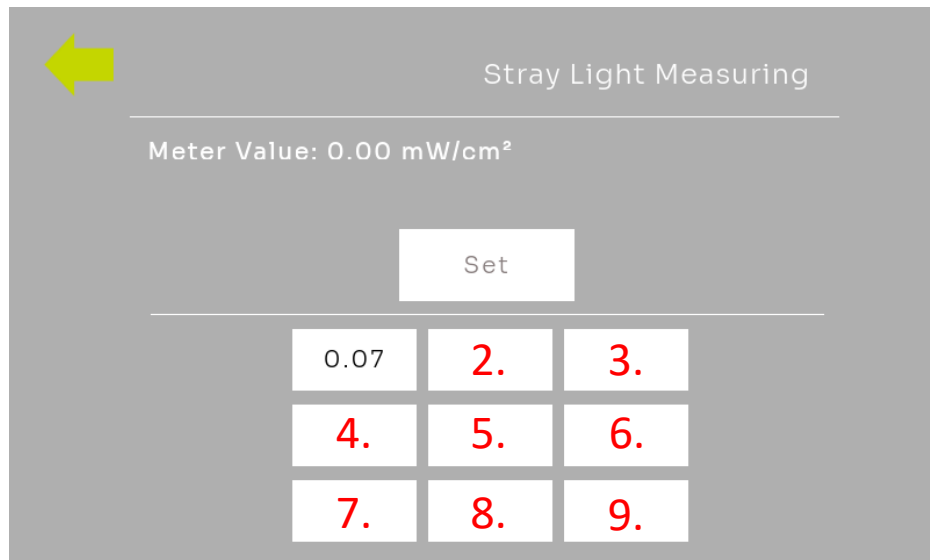


5.2 散射光测量

投影仪现在逐渐在所有领域中显示黑暗区域。

操作步骤：

- 依次测量所有9个区域，直到散射光测量完成。
- 然后单击"Set"确认第9步。

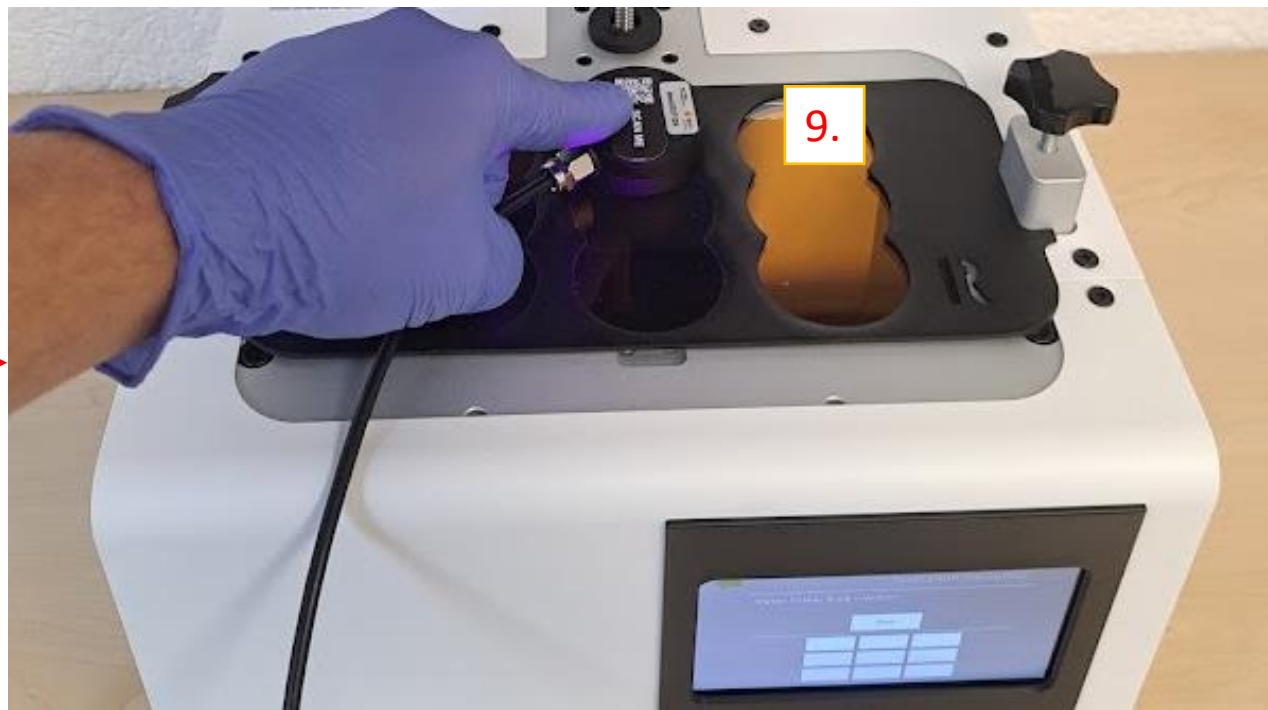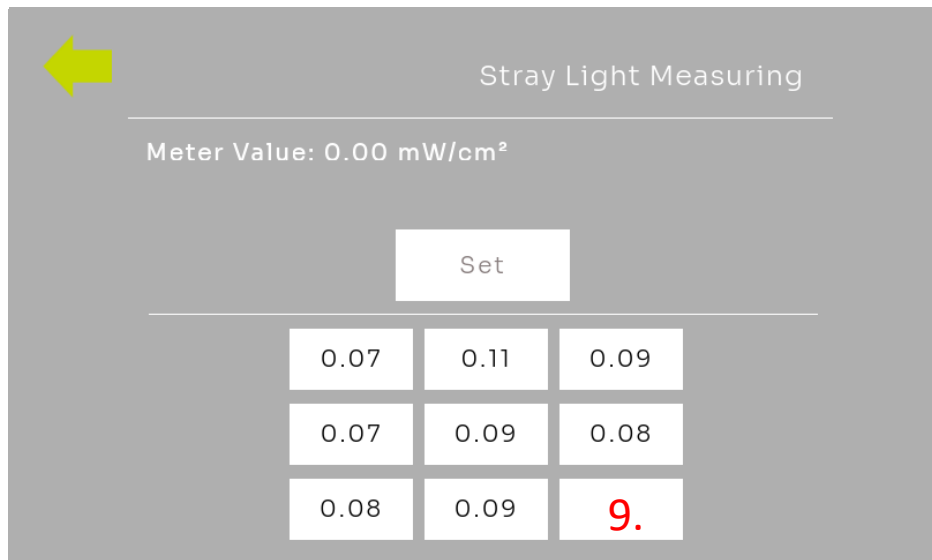

5.2 评估 - 散射光测量

- 理想情况下，散射光测量中的各个区域应该达到以下数值： $I \leq 0,1mW/cm^2$ 。
- 如果数值大于此数值，请检查系统的清洁度。
- 轻微的划痕或粗糙表面可能导致散射光数值升高。
- 如果数值达到或超过 $I \geq 0,15mW/cm^2$ ，请联系DentaMile支持团队。

请在完成散射光测量后关闭窗口，以停用投影仪。

如果您想重新测试某个区域，请单击所需的区域并重新放置传感器。


Stray Light Measuring

Meter Value: 0.00 mW/cm²

Set

0.07	0.11	0.09
0.07	0.09	0.08
0.08	0.09	0.08

6. 评估图表

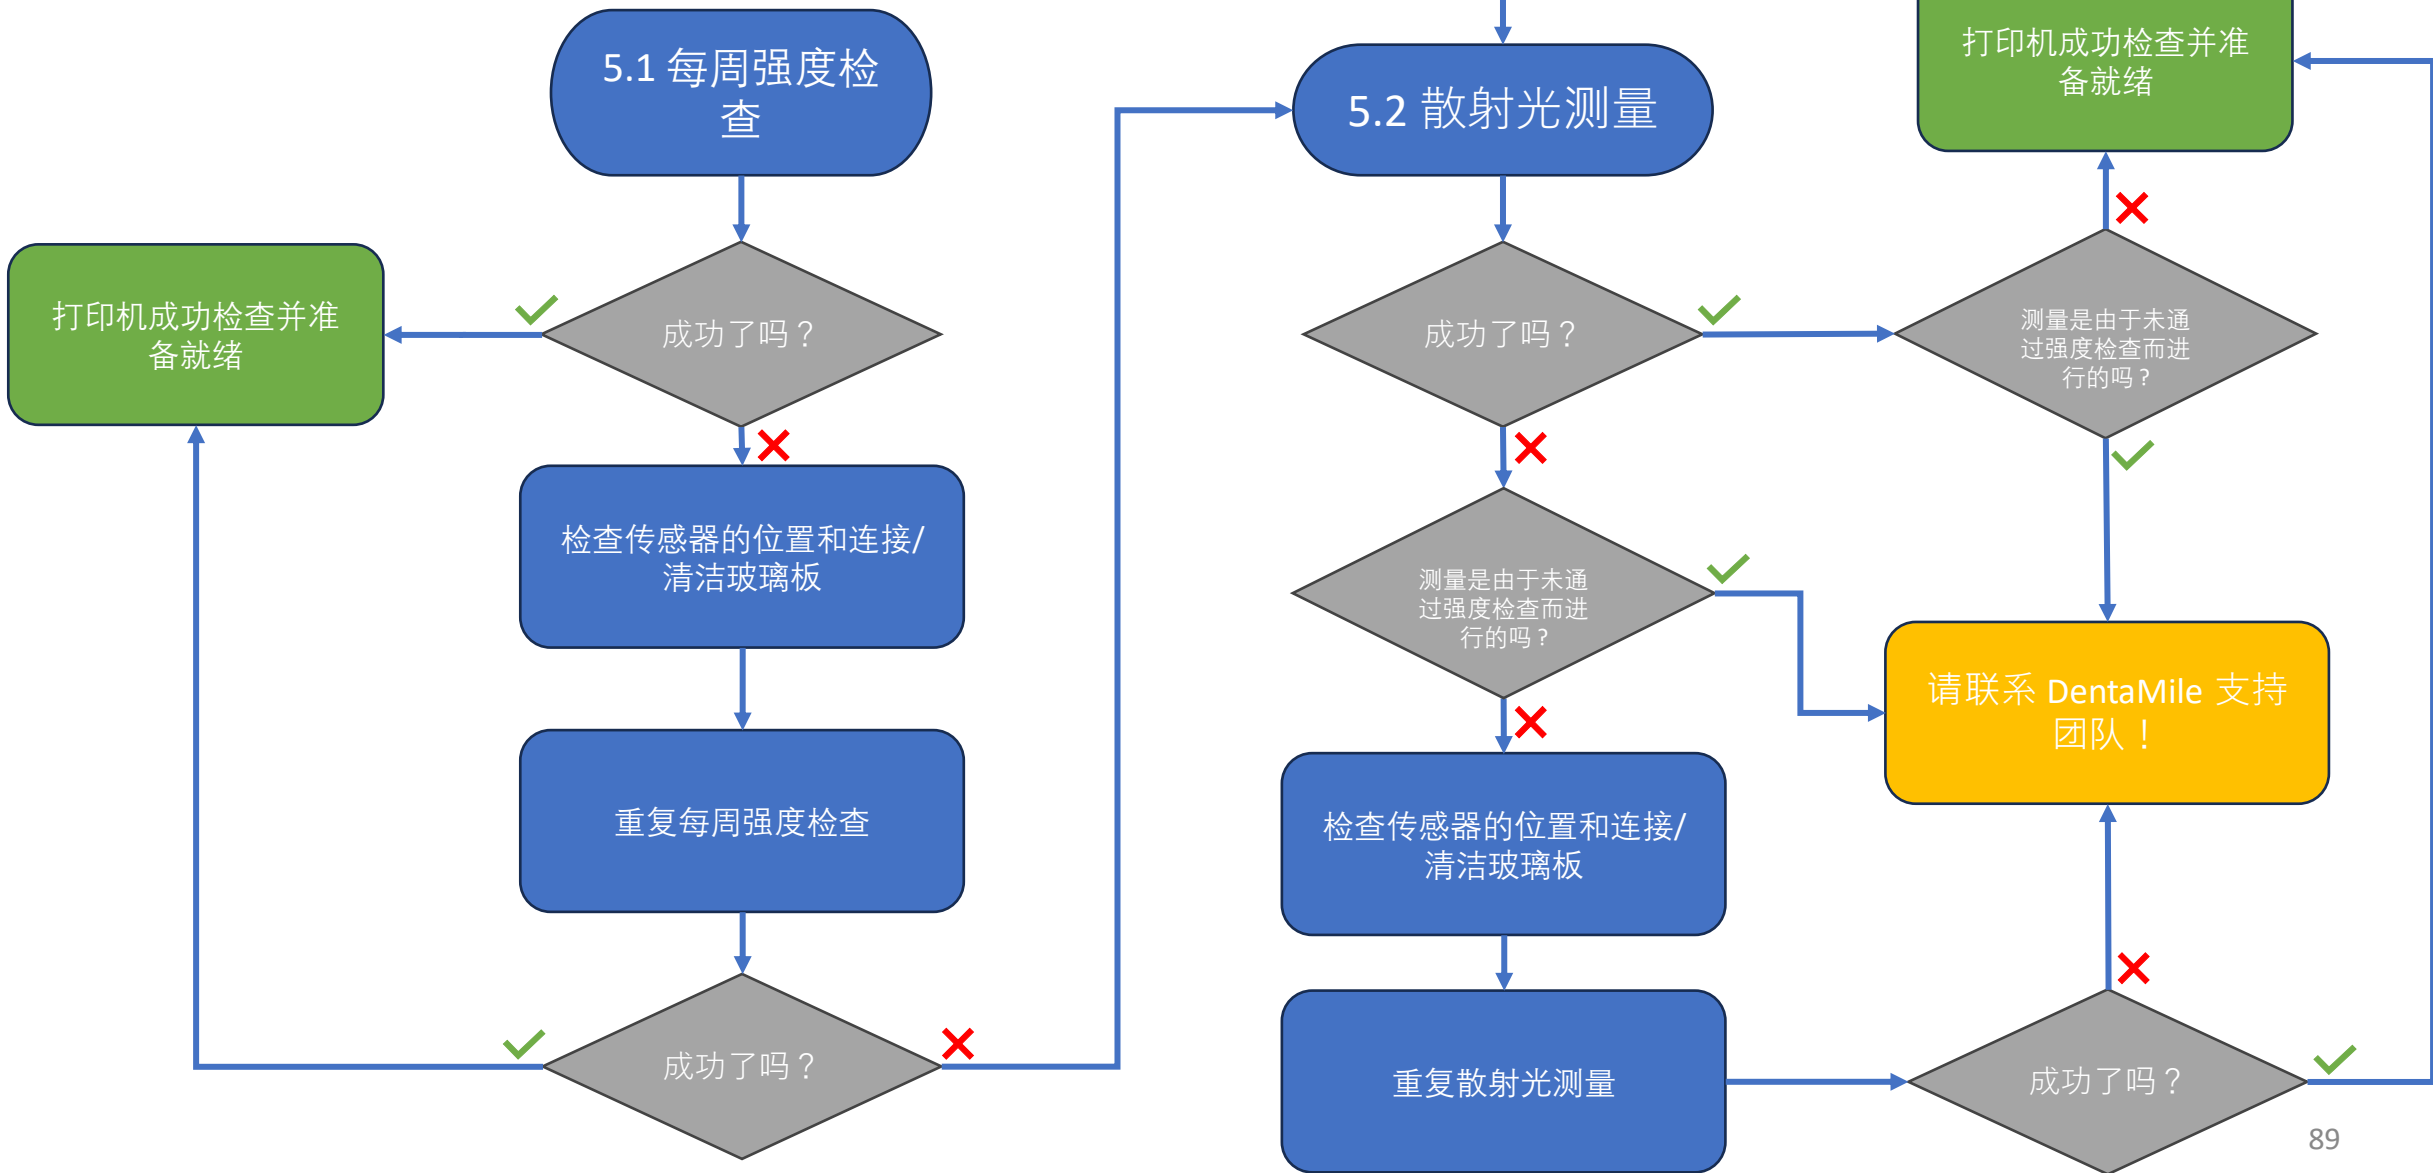

7. UV传感器重新校准

以下信息对于您的验证工作流程非常重要！

- 您的UV传感器每年需要重新校准一次，以确保传感器提供可靠的测量值。
- 请将您的传感器邮寄至我们的合作伙伴BURMS进行重新校准。
- 将传感器放入一个有缓冲的信封中，然后邮寄到以下地址：

BURMS 3D Druck GmbH und Co.KG.
Hermann-Löns-Str. 2 07745 Jena
德国

- 如果您有选择性的维护合同，重新校准费用已包含在您的年度维护费用中。请确保在年度维护前大约提前4周将传感器邮寄给我们的合作伙伴，因为他们需要在维护过程中使用重新校准后的传感器。
- 如果您没有签署维护合同，重新校准将会收取299欧元的费用。

8. 维护合同流程

维护流程如下：

1. 请与BURMS公司预约，提供序列号
 - 预约链接：<https://calendly.com/burms3d/online-termin>
2. 您将收到一个可用的日期或可以选择日期
 - 重新校准需要您的亲临。请安排大约2小时的时间
3. 在约定时间，BURMS的一名员工将向您提供MS TEAMS的链接
 - 可以通过浏览器或TEAMS应用程序使用TEAMS
 - 在约会之前，请执行以下操作：
 - 移除构建平台。
 - 移除储罐。
 - 彻底清洁玻璃（使用异丙醇或玻璃清洁剂）。
 - 打开设备。
 - 确保您连接到互联网。
4. 准备好以下设备：
 - 校准面罩。
 - 紫外线传感器。

您在BURMS公司的联系人将为您解释所有其他步骤。

请注意：该预约只能用德语或英语进行。

Nederlands

**Instructies voor wekelijkse intensiteitstests en
strooilichtmetingen**

Algemene richtlijnen

- Zorg altijd voor geschikte veiligheidsmaatregelen:

- UV-beschermingsbril
- Handschoenen

Vermijd zonlicht of andere lichtbronnen die de resultaten kunnen beïnvloeden.

Houd de sensor schoon en vermijd contact met het sensoroppervlak.



De resultaten kunnen de volgende informatie bevatten:

- Reinheid van het glas
- Slijtage van het glas
- Degeneratie van de projector


Als u twijfelt, neem dan contact op met uw DentaMile-ondersteuningsteam.




1. Verwijder de tank en de bouwplaat en start de printer

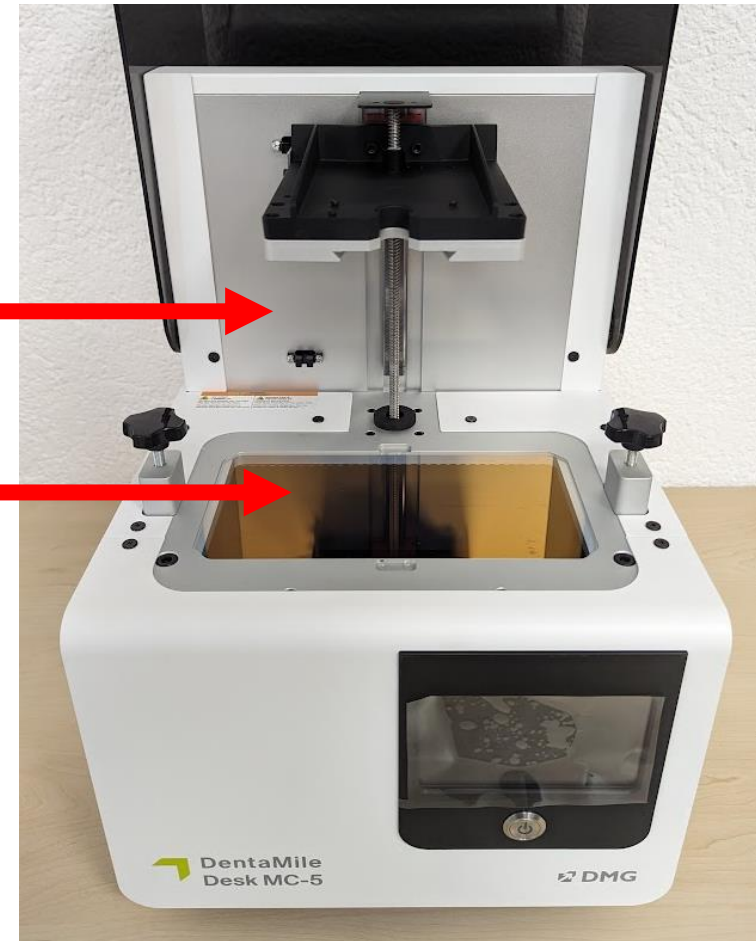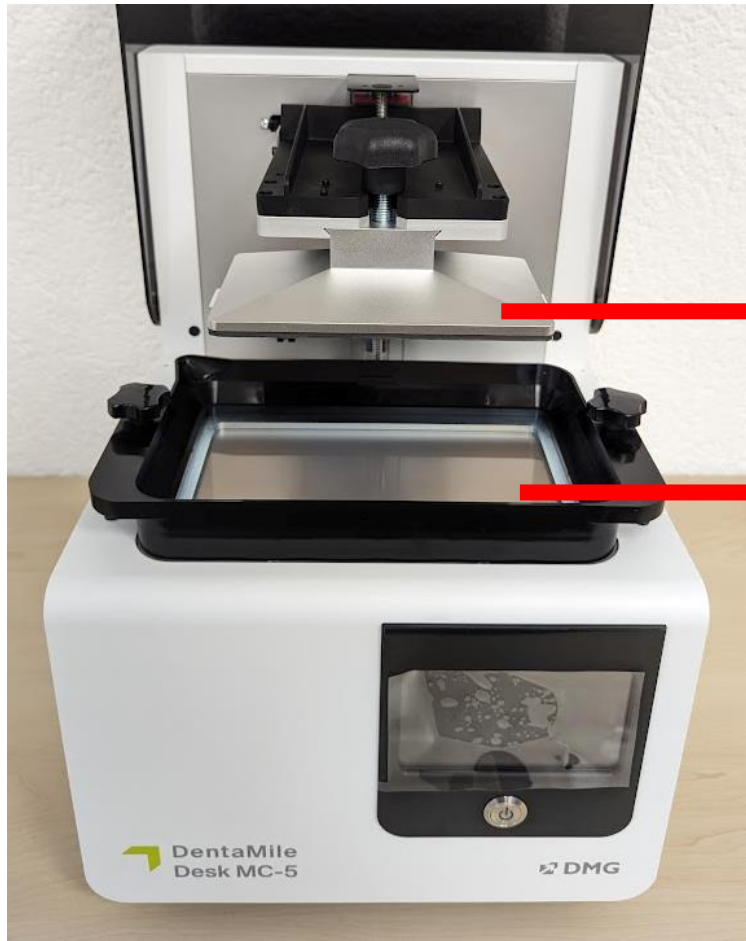

2. Plaats het sensorscherm

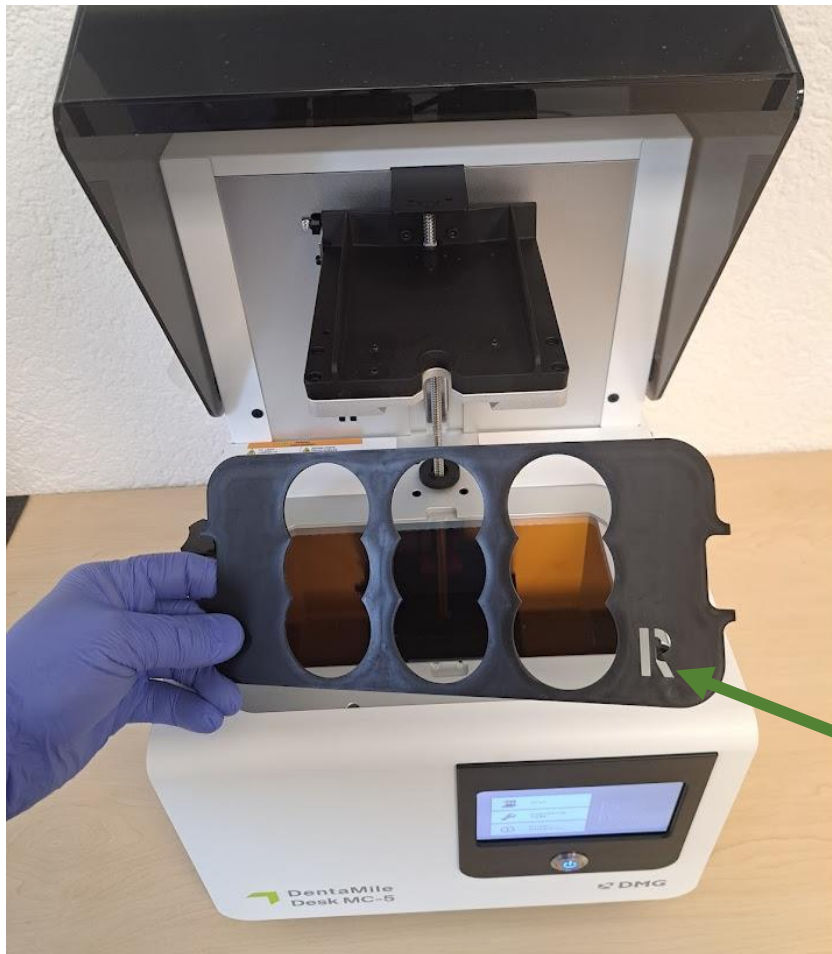



rechts

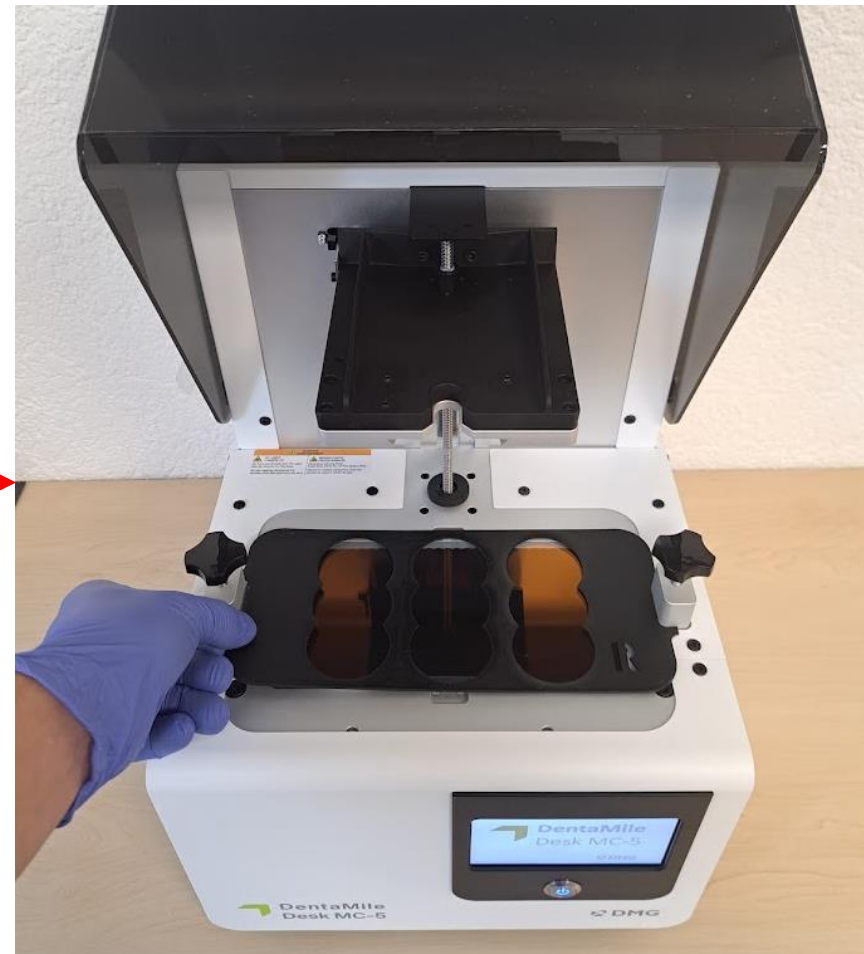


3. Sluit de UV-sensor aan






4. Plaats de sensor in het midden

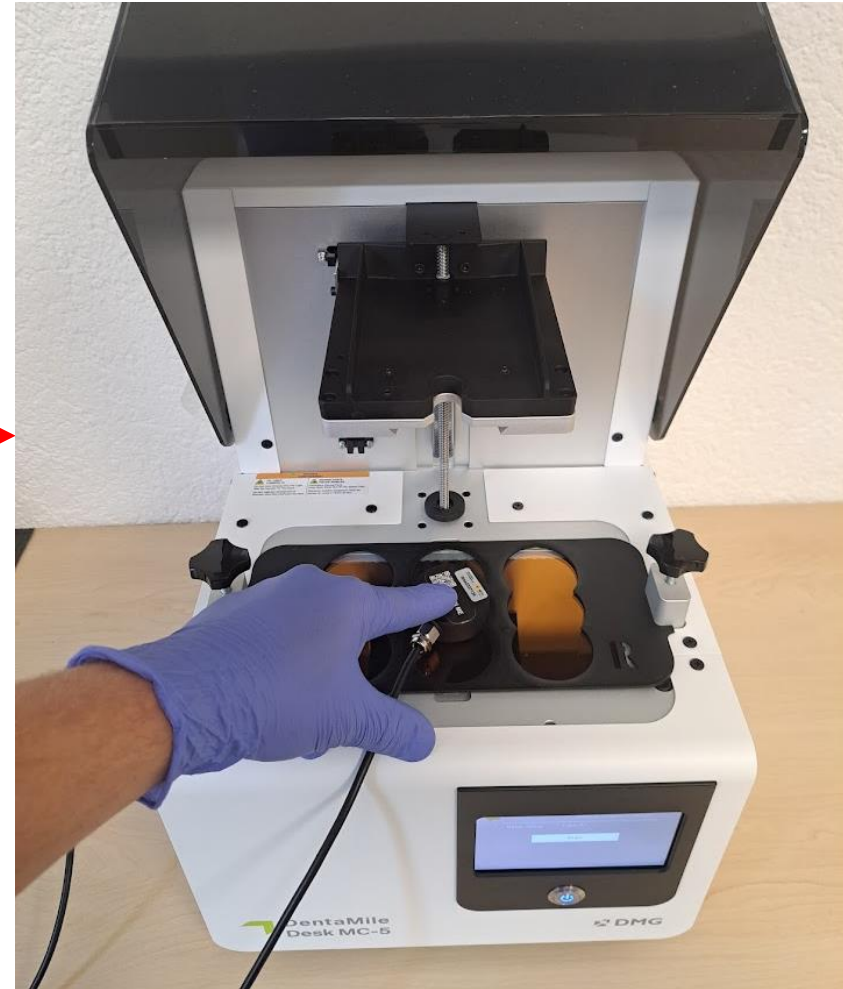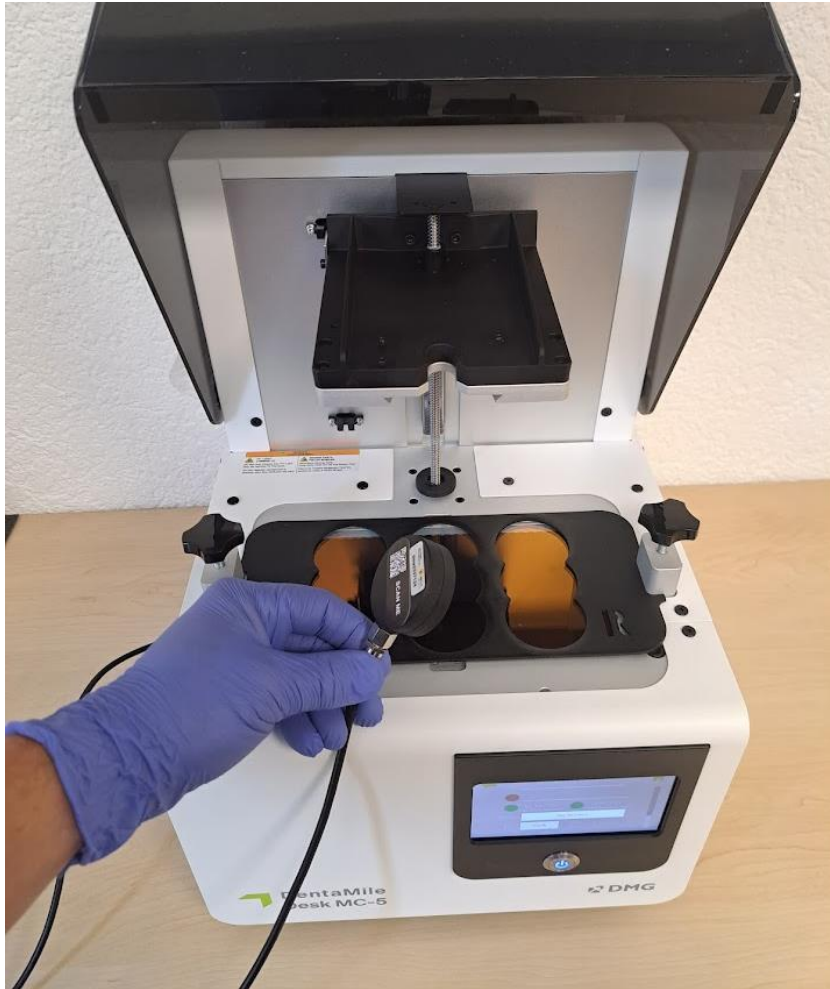

5. Navigeer naar het projectormenu

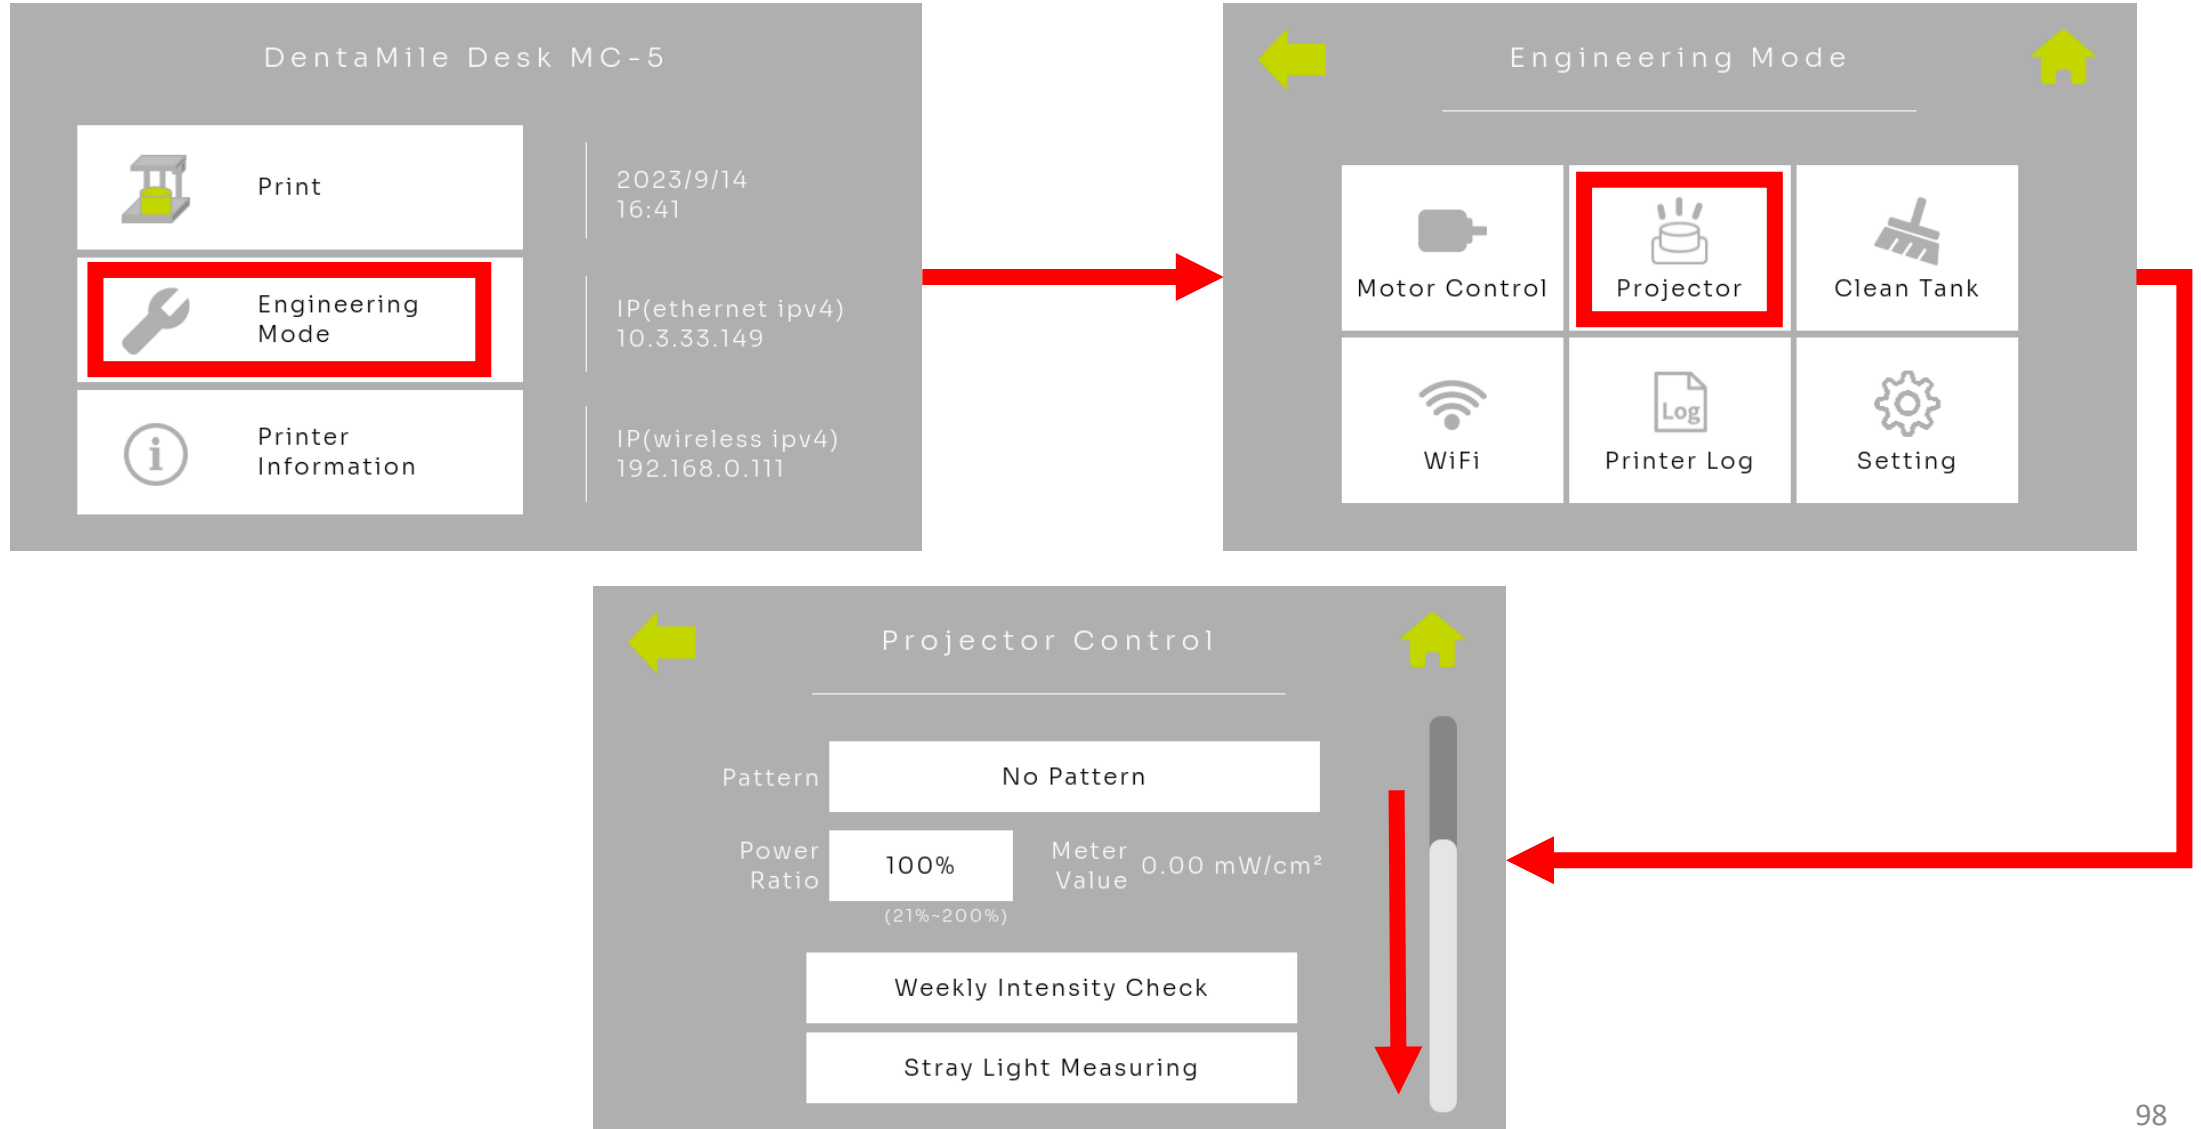

5.1 Wekelijkse intensiteitstest

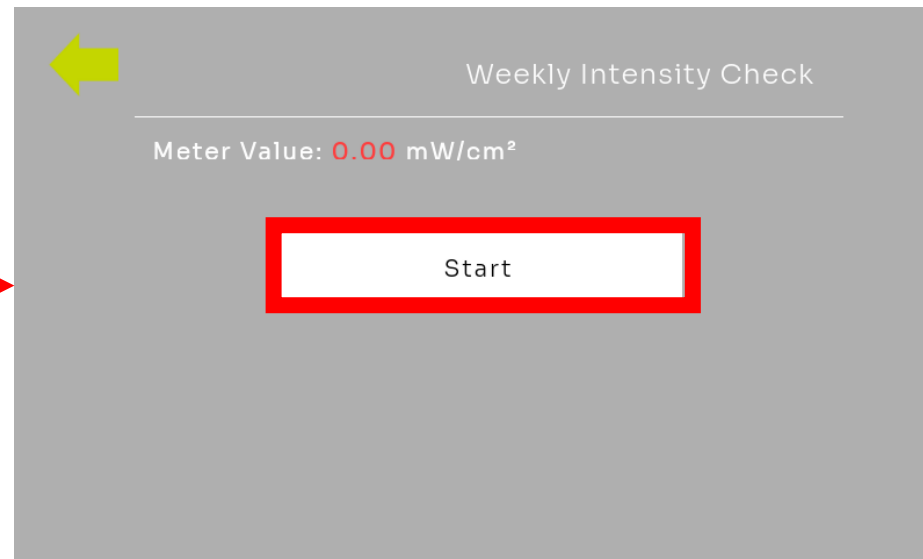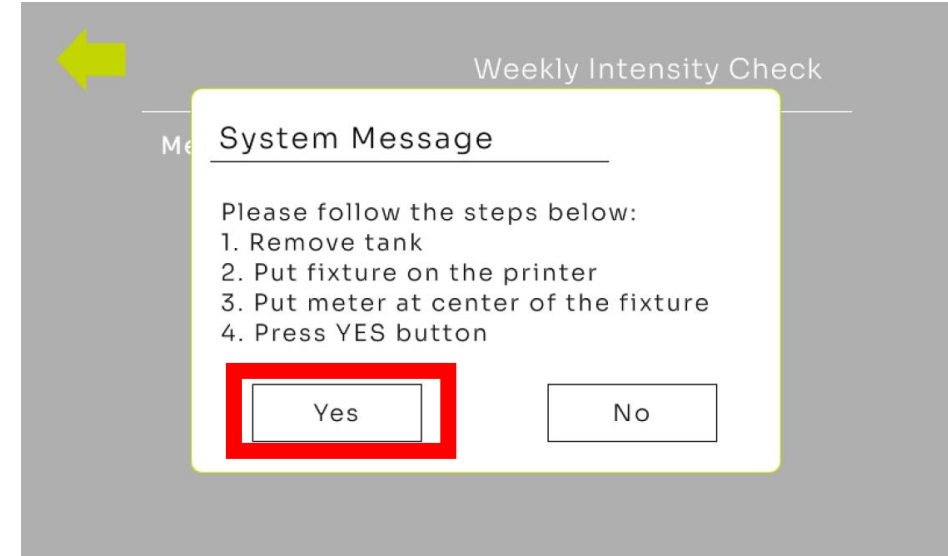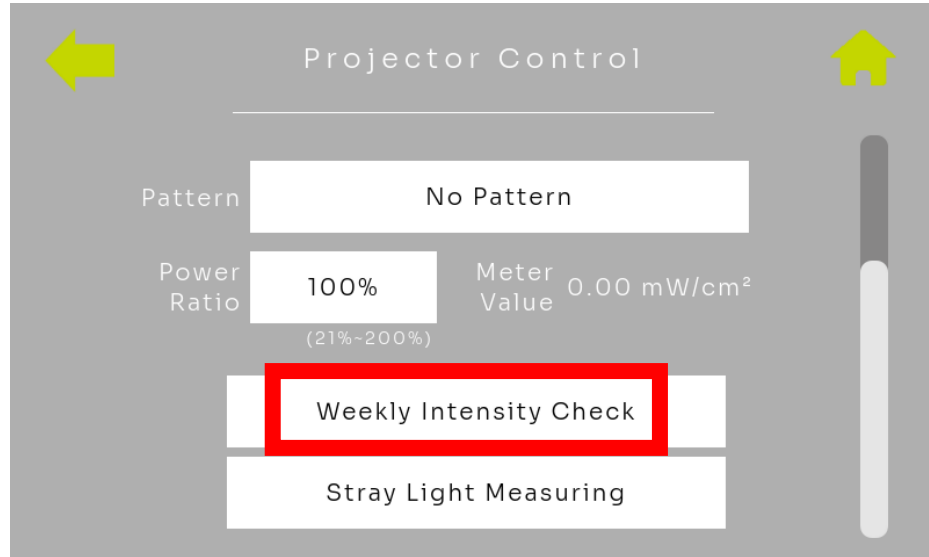




Controleer het volgende:

- Tank en Picker zijn verwijderd
- De sensormasker is geplaatst
- De UV-sensor bevindt zich in het midden
- Druk op YES

5.1 Beoordeling - Wekelijkse intensiteitstest

De test duurt nu 30 seconden. Druk tijdens de test lichtjes op de glasplaat met de sensor en voorkom dat deze verschuift. Na voltooiing van de test wordt er een pop-upbericht weergegeven om aan te geven of de test is geslaagd.

Als de test is geslaagd, kunt u doorgaan met afdrukken.

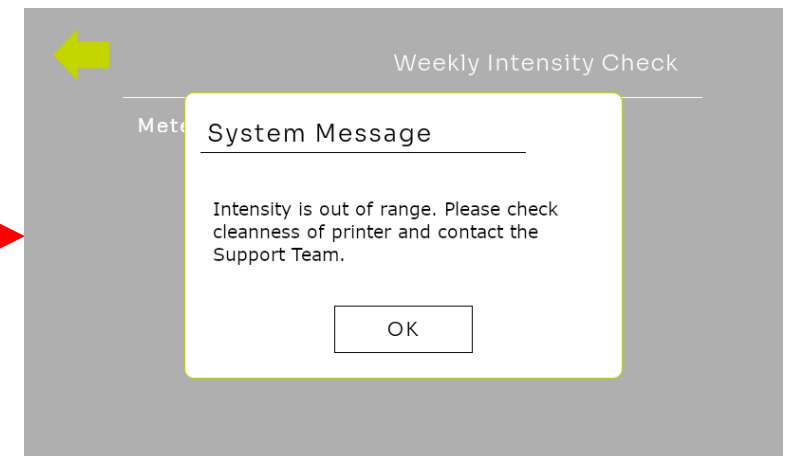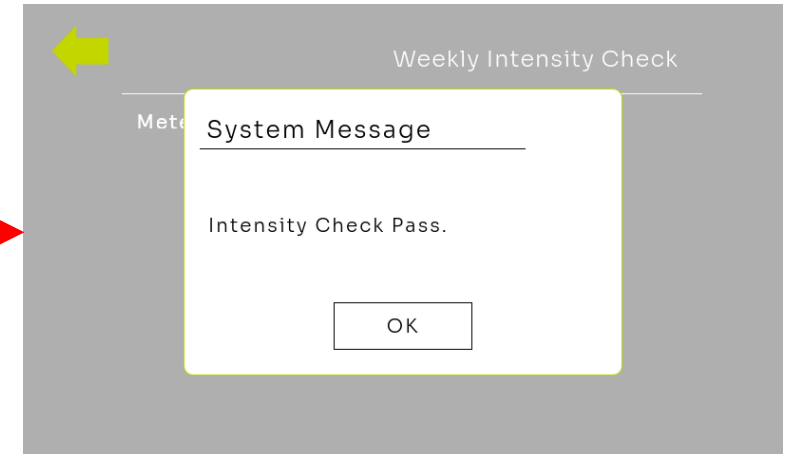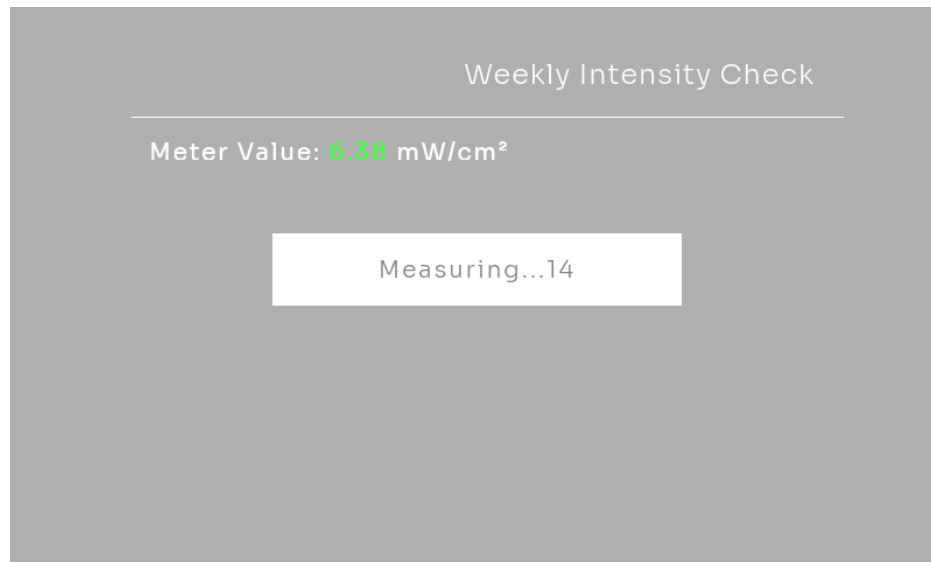



Als de test niet is geslaagd, controleer dan eerst de verbinding met de sensor, de juiste positie en de reinheid van de installatie. Herhaal de test vervolgens. Als de test nog steeds niet slaagt, voer dan een strooilightmeting uit (zie punt 5.2 en 6).

5.2 Strooilichtmeting

Als de wekelijkse intensiteitstest niet is geslaagd of als er fouten zijn opgetreden met betrekking tot componenten of afdrukken, voer dan de strooilichtmeting uit.

Procedure:

- Zie stap 3.
- Positioneer de UV-sensor op de eerste positie links voorin.

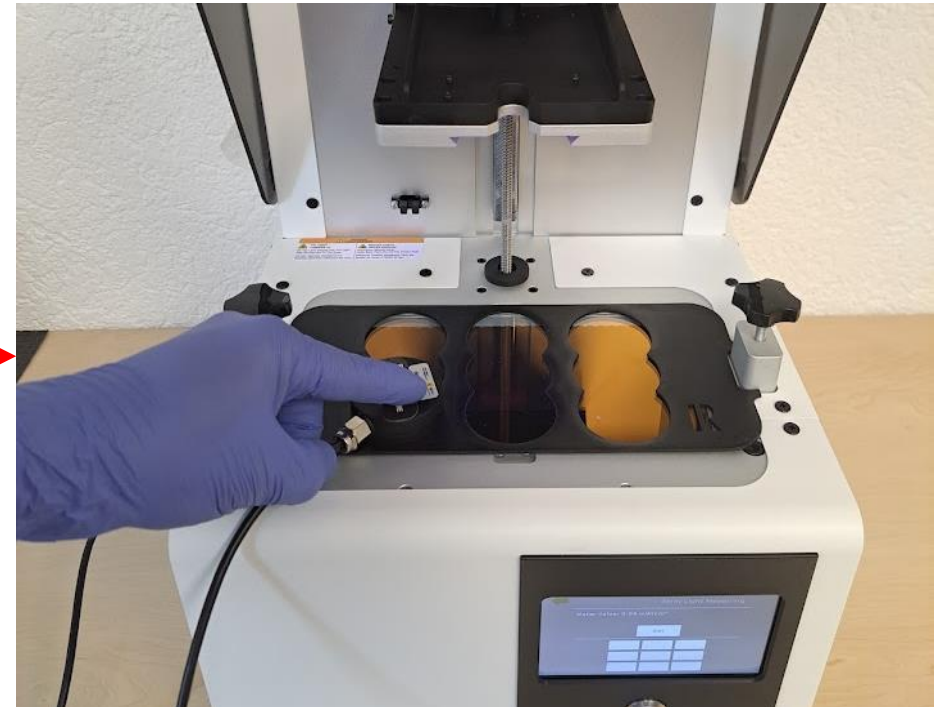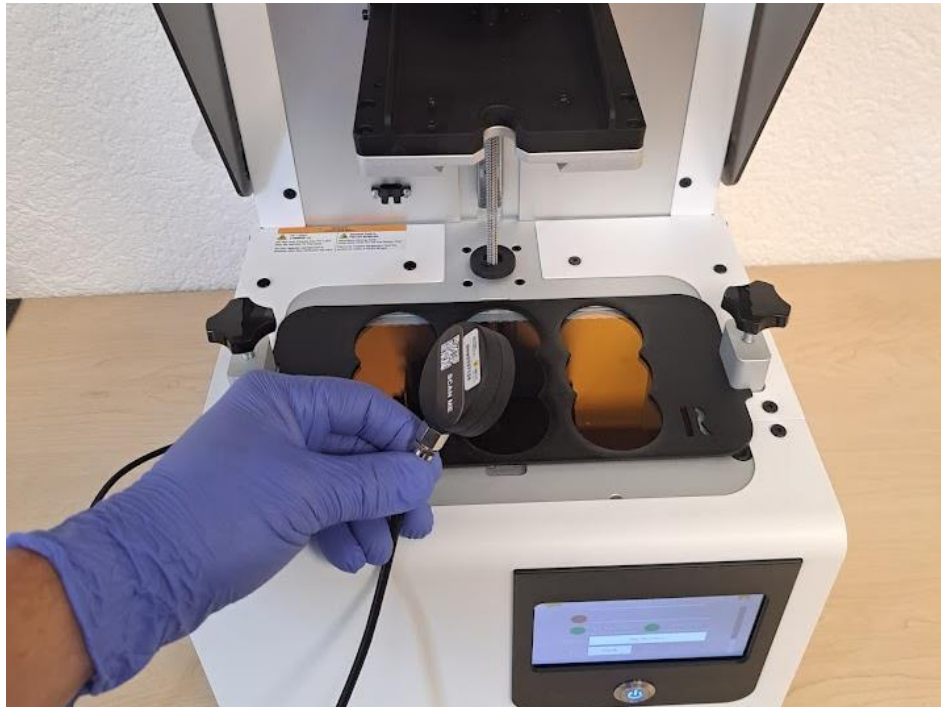


5.2 Strooilichtmeting

Ga naar het projectormenu (zie Punt 5).

Procedure:

- Selecteer "Strooilichtmeting"


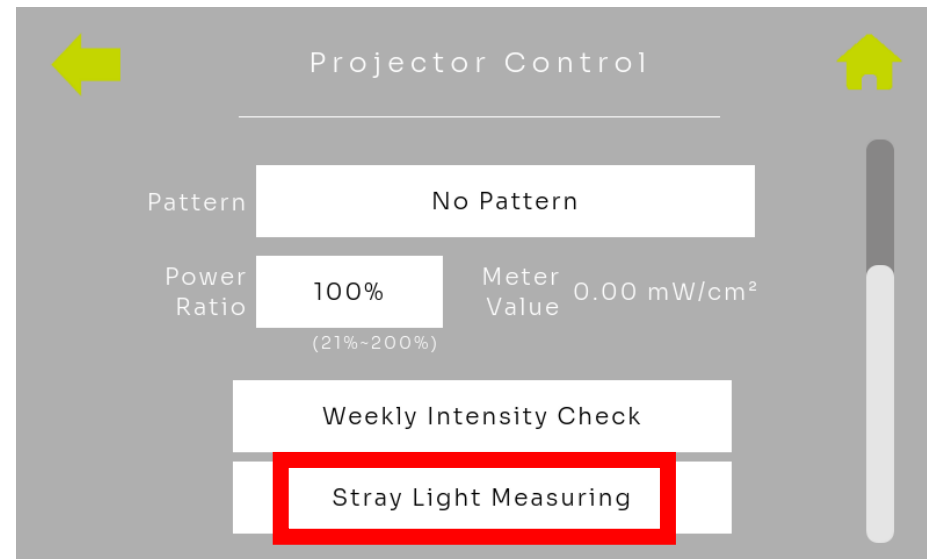


5.2 Strooilichtmeting

De projector projecteert nu een donker gebied in het eerste veld.

Procedure:

- Wacht ongeveer 10 seconden
- Klik op "Instellen" (Set)

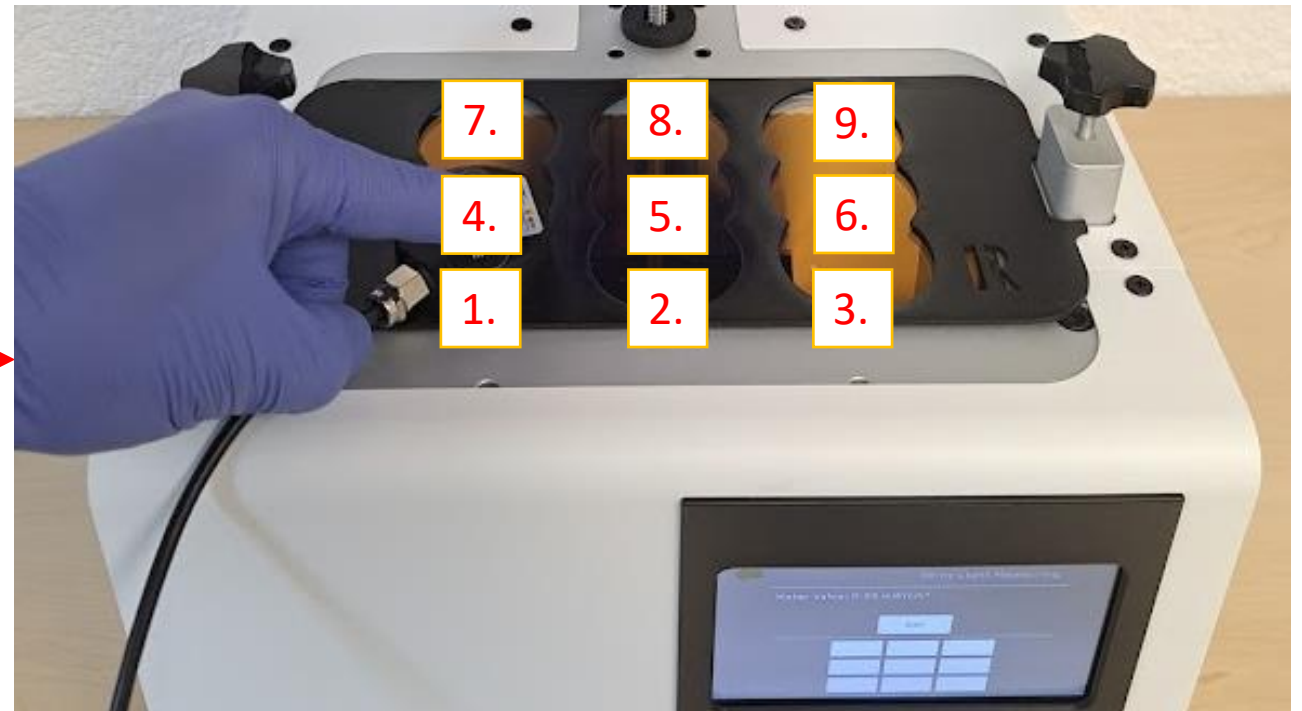
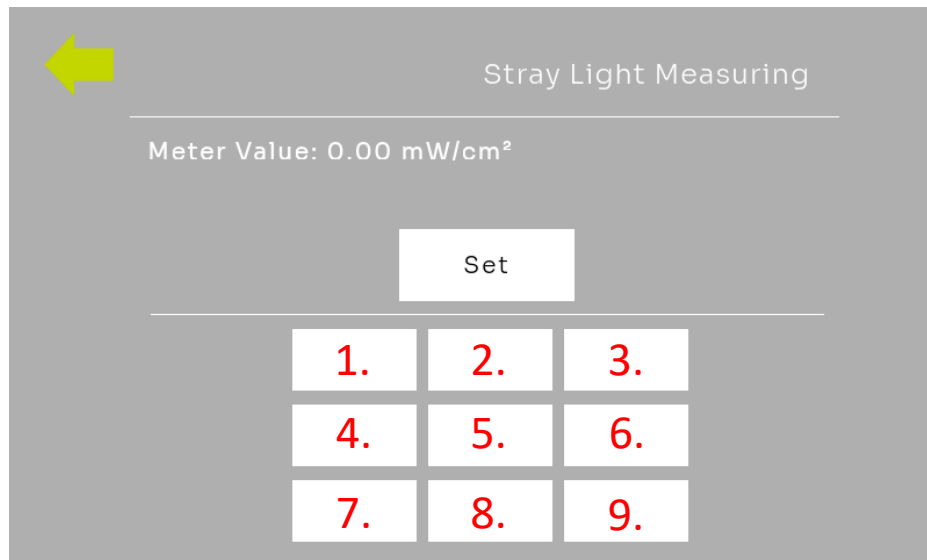


5.2 Strooilichtmeting

De projector projecteert nu een donker gebied in het tweede veld.

Procedure:

- Wissel de sensor naar veld 2 en wacht ongeveer 10 seconden
- Klik op "Instellen" (Set) opnieuw

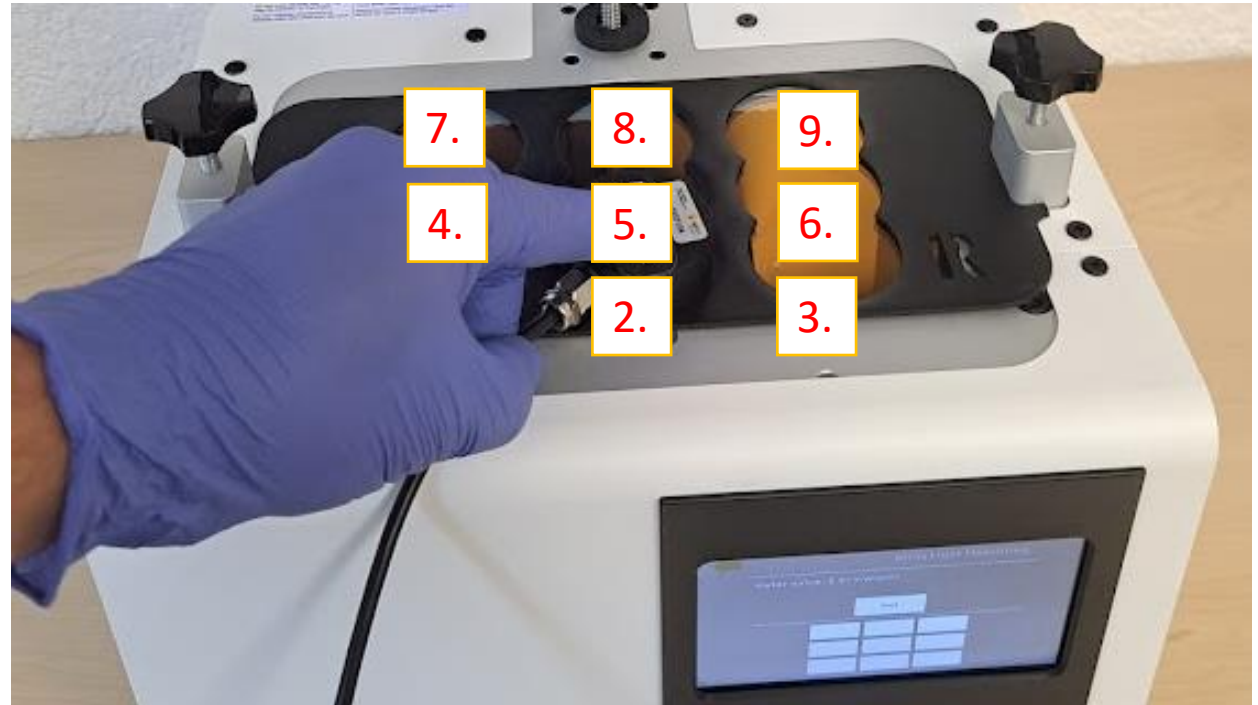
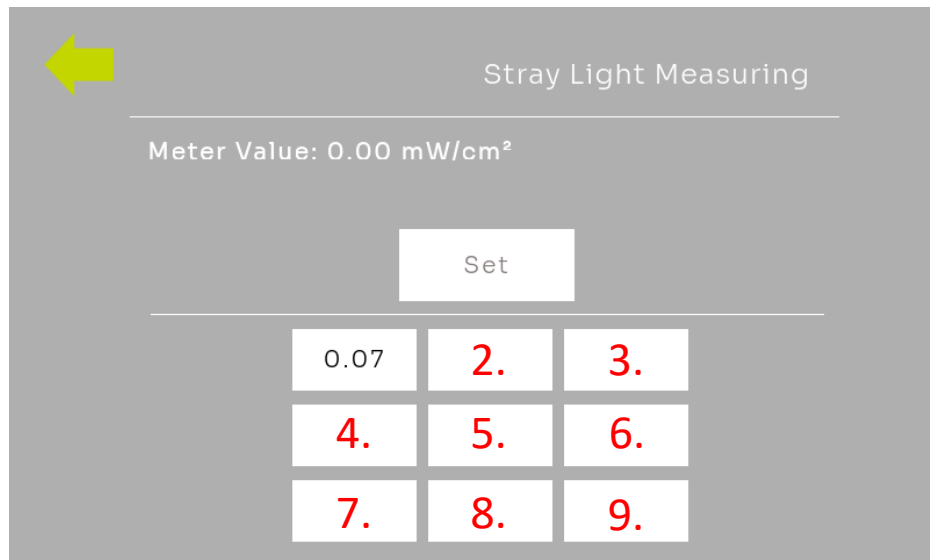


5.2 Strooilichtmeting

De projector vormt geleidelijk een donker gebied af in alle velden.

Procedure:

- Meet achtereenvolgens alle 9 velden totdat de strooilichtmeting voltooid is.
- Bevestig stap 9 met "Set".

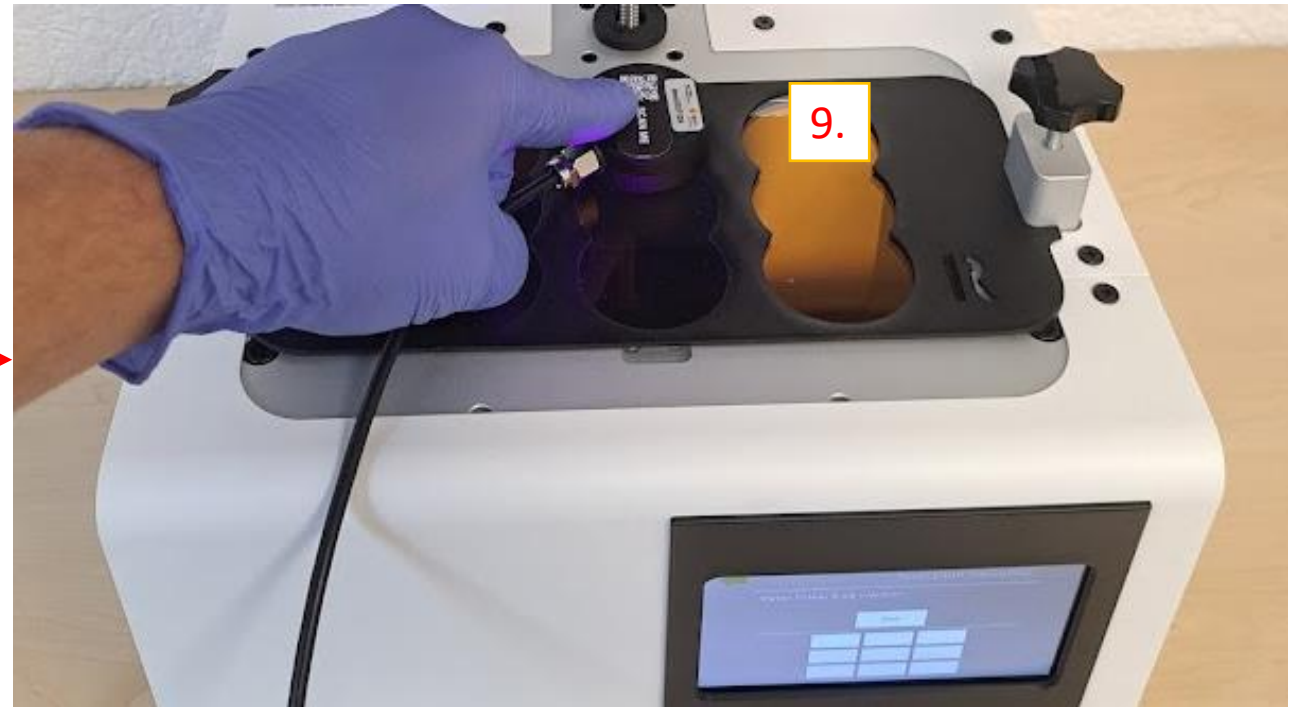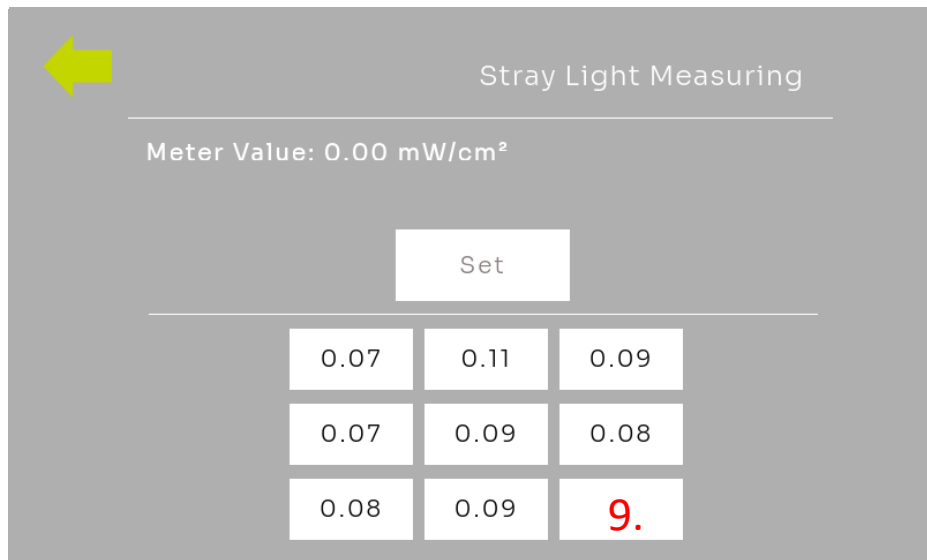

5.2 Evaluatie - strooilichtmeting

- Optimaal bereiken de velden in de strooilichtmeting waarden van: $I \leq 0,1mW/cm^2$.
- Als de waarde hoger is, controleer dan of het systeem schoon is.
- Lichte krassen of opruwing kunnen ook leiden tot hogere waarden voor het controlelampje.
- Neem vanaf $I \geq 0,15mW/cm^2$ contact op met uw DentaMile-ondersteuningsteam.

Sluit het venster na afloop van de strooilichtmeting om de projector uit te schakelen.

Als je een veld opnieuw wilt testen, klik je op het gewenste veld en zet je de sensor weer aan.


Stray Light Measuring

Meter Value: 0.00 mW/cm²

Set

0.07	0.11	0.09
0.07	0.09	0.08
0.08	0.09	0.08

6. Auswertungsdiagramm

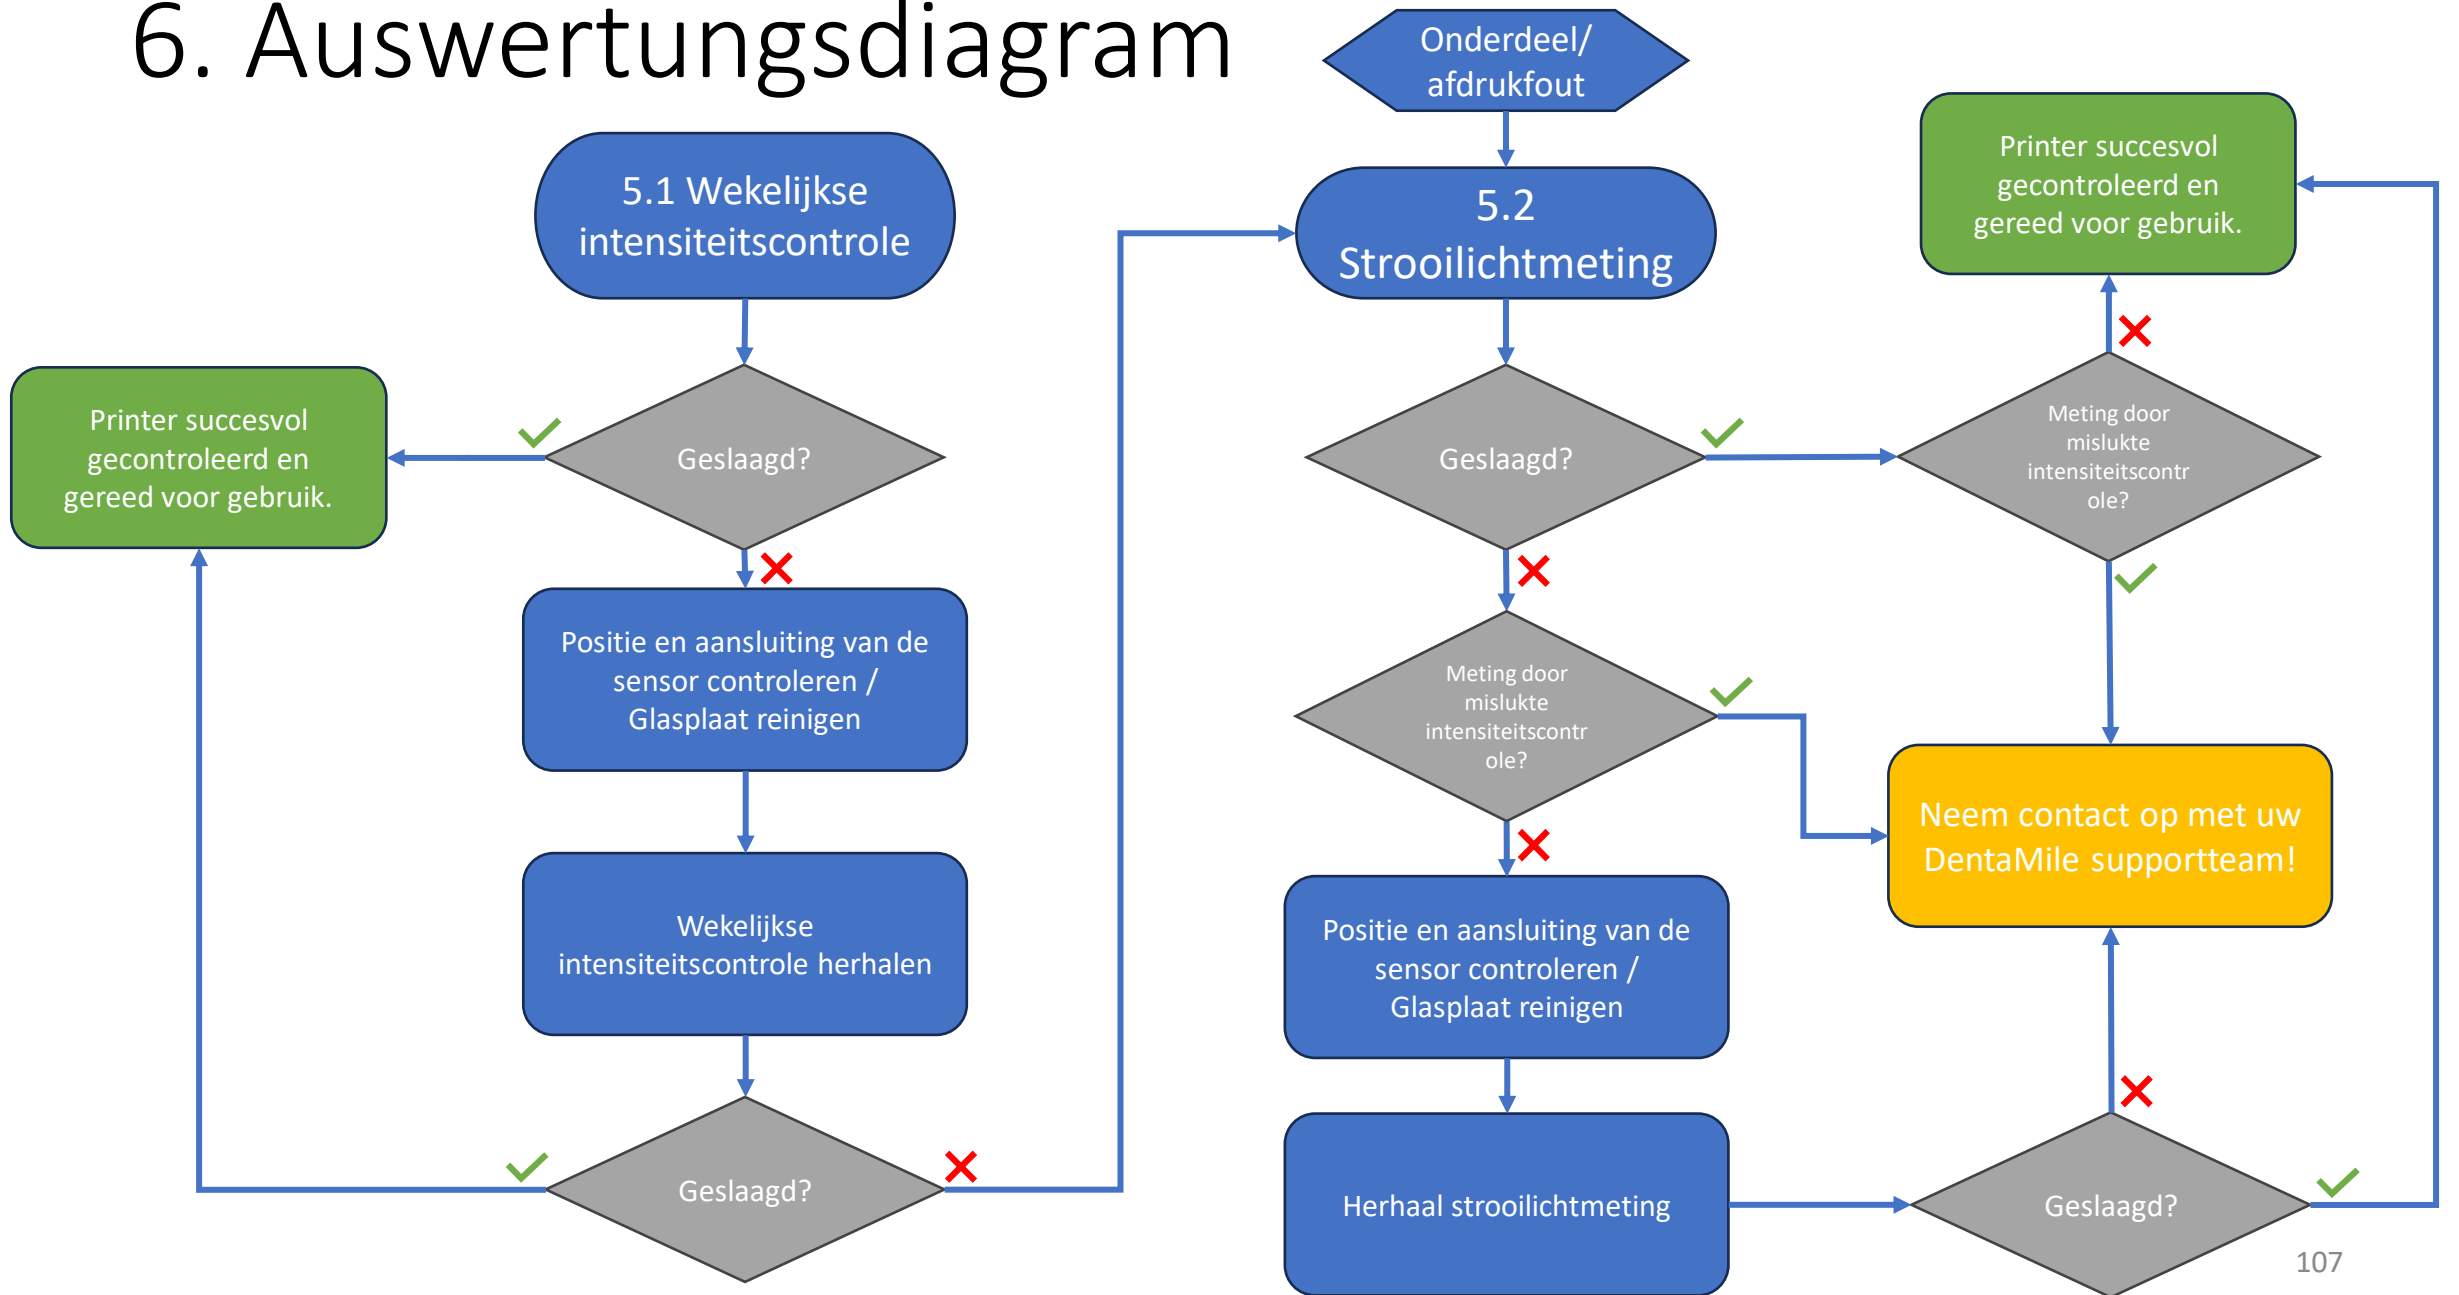

7. UV-Sensor Rekalibrierung

De volgende informatie is belangrijk voor uw gevalideerde workflow!

- Uw UV-sensor moet elk jaar opnieuw worden gekalibreerd om ervoor te zorgen dat de sensor betrouwbare metingen levert.
- Stuur uw sensor voor herkalibratie naar onze partner BURMS.
- Plaats uw sensor in een gevoerde envelop en stuur deze naar het volgende adres:

BURMS 3D Druck GmbH und Co.KG.
Hermann-Löns-Str. 2
07745 Jena
Duitsland

- Als u een optioneel onderhoudscontract heeft, is de herkalibratie inbegrepen in uw jaarlijkse onderhoudskosten. Zorg ervoor dat u de herkalibratie ongeveer 4 weken voor uw jaarlijkse onderhoud naar onze partner stuurt, omdat ze een opnieuw gekalibreerde sensor nodig hebben voor het onderhoud.
- Als u geen onderhoudscontract heeft afgesloten, worden er kosten van **299** euro in rekening gebracht voor herkalibratie.

8. Procedure bij onderhoudscontract

Procedure voor onderhoud:

1. Maak alstublieft een afspraak met BURMS en vermeld daarbij het serienummer.
 - Maak een afspraak via: <https://calendly.com/burms3d/online-termin>
2. U krijgt nu een mogelijke afspraak of u kunt een afspraak kiezen.
 - De herkalibratie vereist uw aanwezigheid. Plan ongeveer 2 uur in.
3. Tijdens de afspraak zal een medewerker van BURMS u een MS TEAMS-link verstrekken.
 - TEAMS kan zowel via de browser als via de TEAMS-applicatie worden gebruikt.
4. Voer vóór de afspraak de volgende handelingen uit:
 - Verwijder het bouwplatform
 - Verwijder de tank
 - Reinig het glas grondig (met isopropanol of glasreiniger)
 - Zet het apparaat aan
 - Zorg ervoor dat u een internetverbinding heeft.
5. Houd het volgende meegeleverde accessoire bij de hand:
 - Kalibratiemasker
 - UV-sensor

Uw contactpersoon bij BURMS zal u alle verdere stappen uitleggen.

Let op: De afspraak kan alleen in het Duits of Engels worden gehouden.